


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	関東	年式	1994年製	管理番号	P007059
型式	KT-10	測定者	山口	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

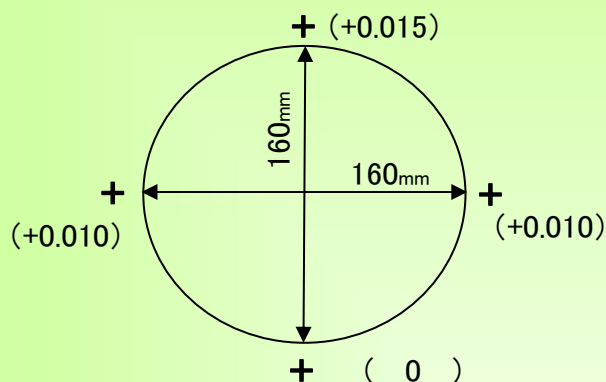

主軸振れ



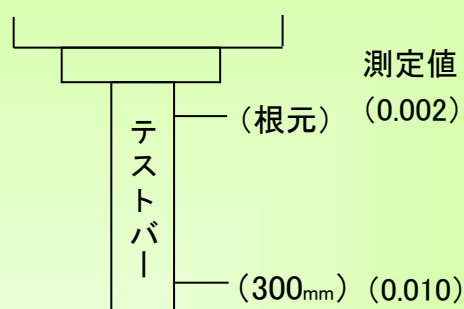


直角度

【YZ】測定値 (0.005)


【XZ】測定値 (0.007)

【X Y】測定値 (0.005)

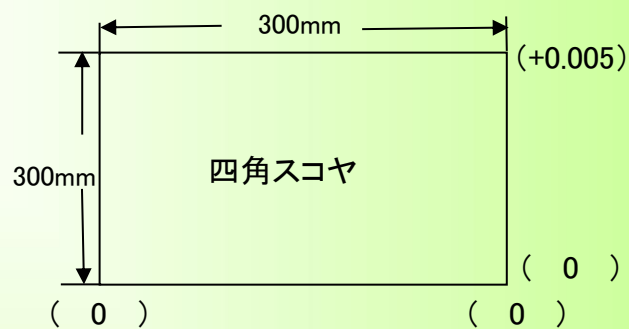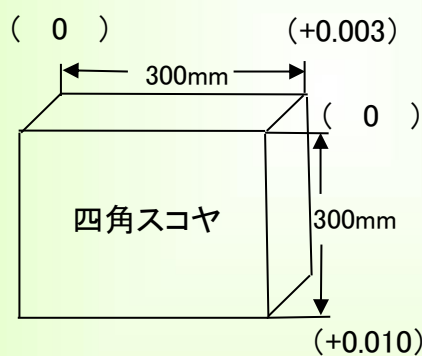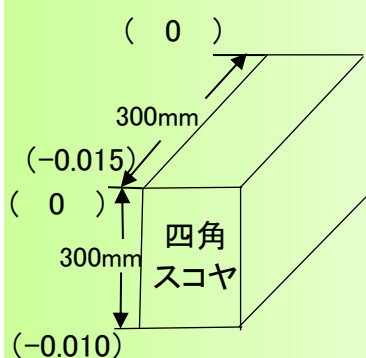

上面精度

※テーブルサイズ 865×250

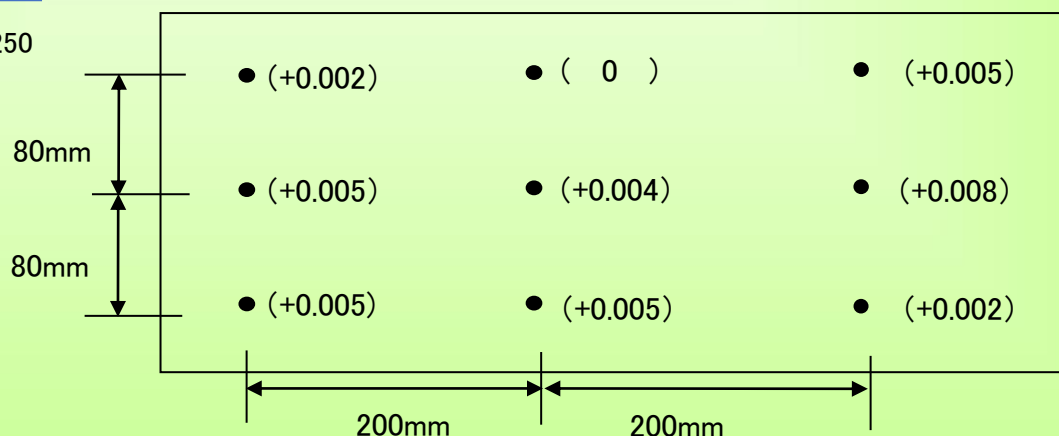

2021/4/6