精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2004年製	管理番号	P006972
型式	α-T14iD	測定者	野辺沼	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

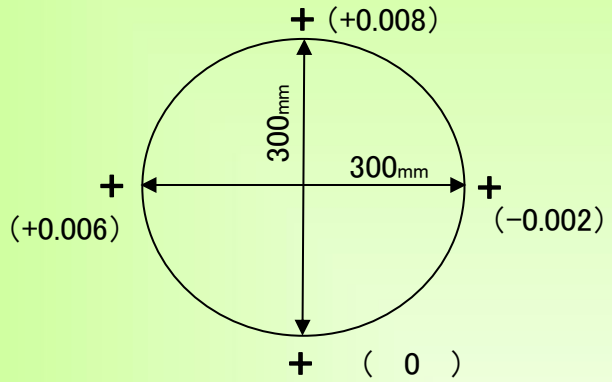

主軸振れ

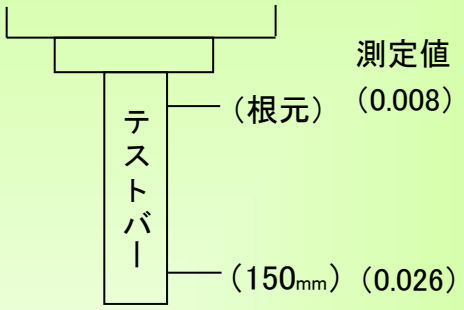

直角度

【YZ】測定値 (0.006)　【XZ】測定値 (0.014)　【X Y】測定値 (0.014)

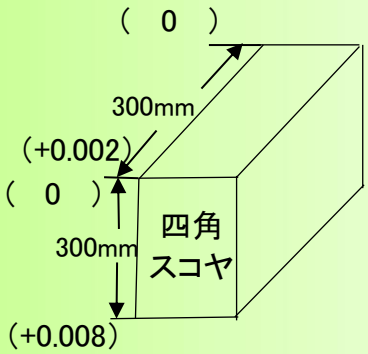

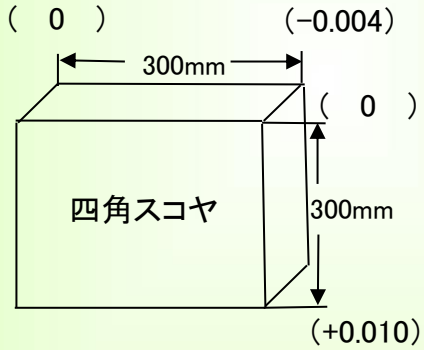

上面精度

※テーブルサイズ　650×400

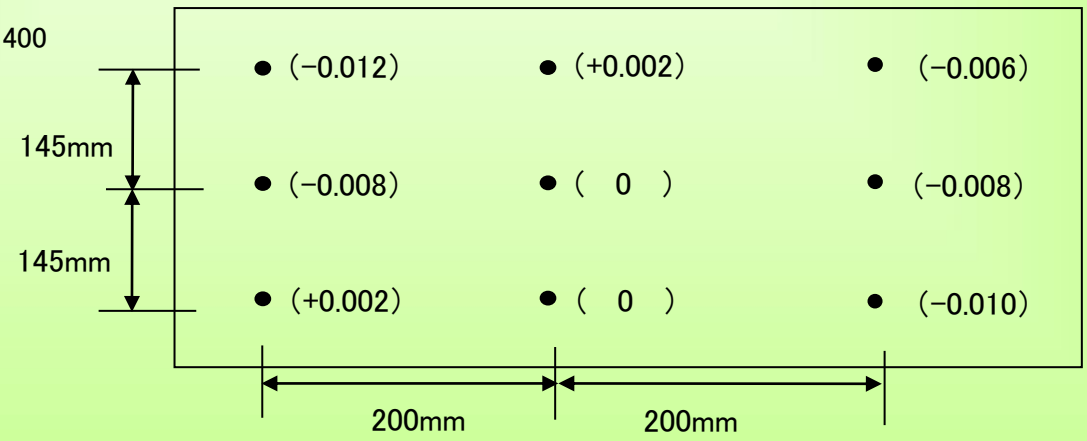

2021/4/16