

精度測定検査表



Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	1997年製	管理番号	H015576
型式	MCV-20A II 20×30	測定者	平野	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ

(マガジン側)

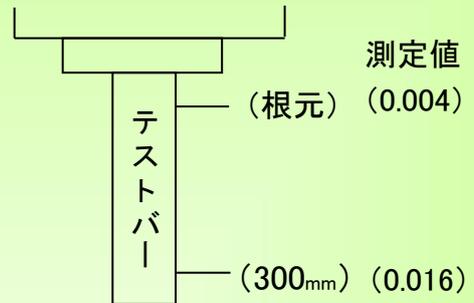
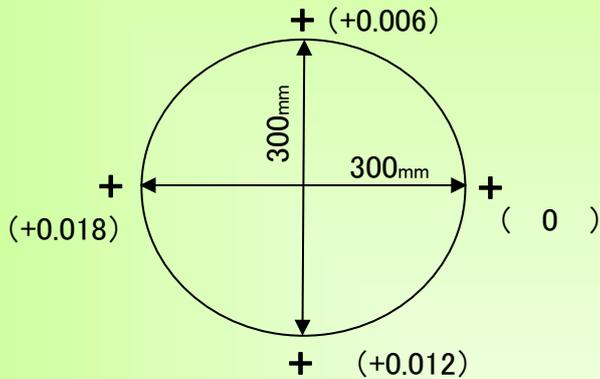


直角度

【YZ】測定値 (0.020)


【XZ】測定値 (0.030)

【XY】測定値 (0.018)

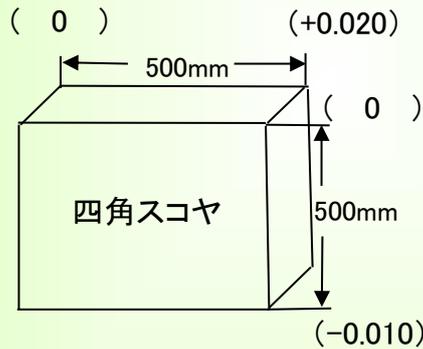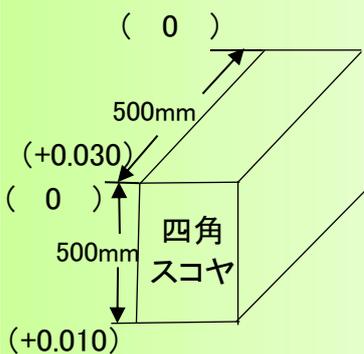

上面精度

※テーブルサイズ 2800×1500

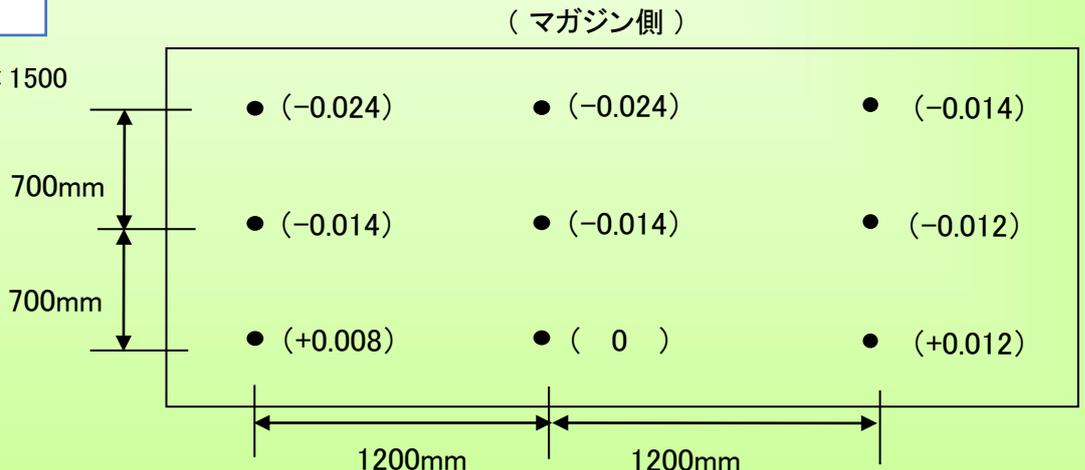

2021/5/10