


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	2007年製	管理番号	P007368
型式	VM5III	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

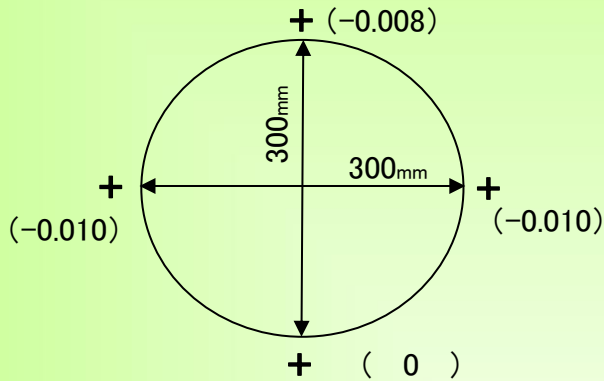

主軸振れ



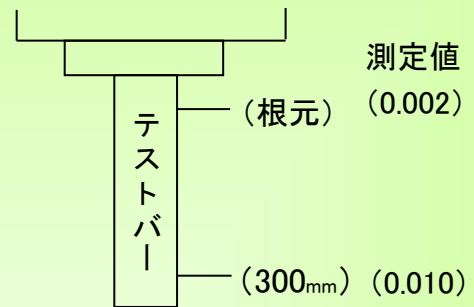


直角度

【YZ】測定値 (0.014)

【XZ】測定値 (0.012)

【XY】測定値 (0.006)

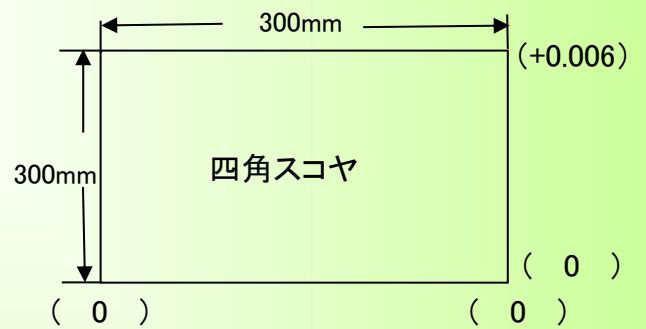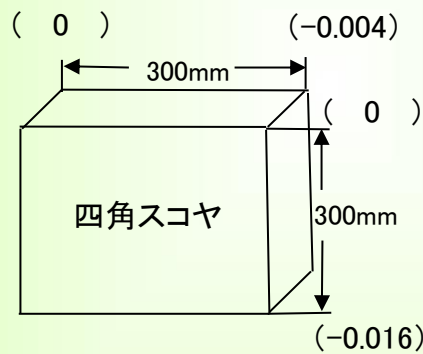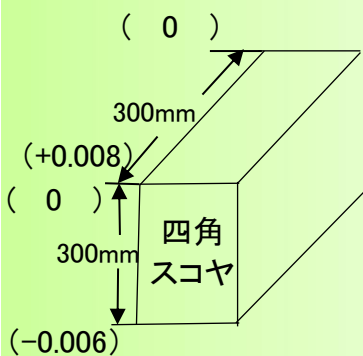

上面精度


※テーブルサイズ 1050×560

【バックラッシュ測定】

X軸 - 0.004

Y軸 - 0.005

Z軸 - 0.003

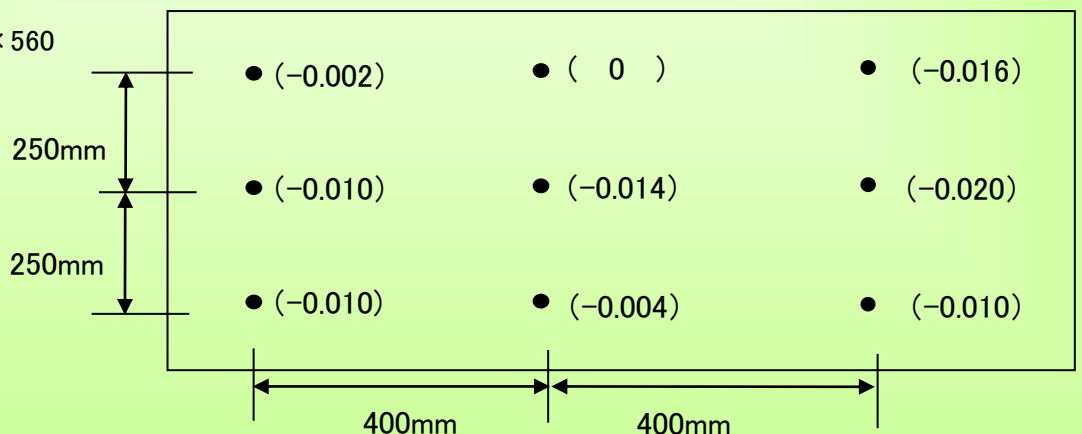

2021/3/27