


精度測定検査表


Examination for precision list

| | | | | | |
|------|---------|-----|--------|--------|---------|
| メーカー | ファナック | 年式 | 2003年製 | 管理番号 | P007435 |
| 型式 | α-T14iD | 測定者 | 武藤 | アシスタント | |

振り回し(200ピッチ)

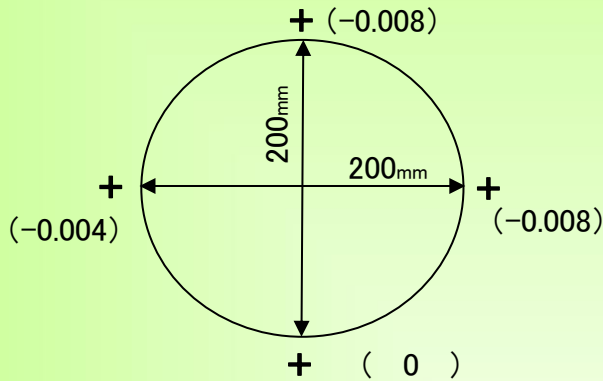

主軸振れ



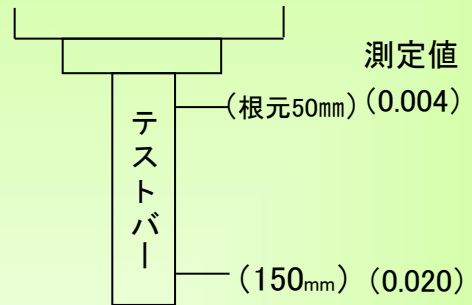


直角度

【YZ】 測定値 (0.006)


【XZ】 測定値 (0.018)

【XY】 測定値 (0.010)

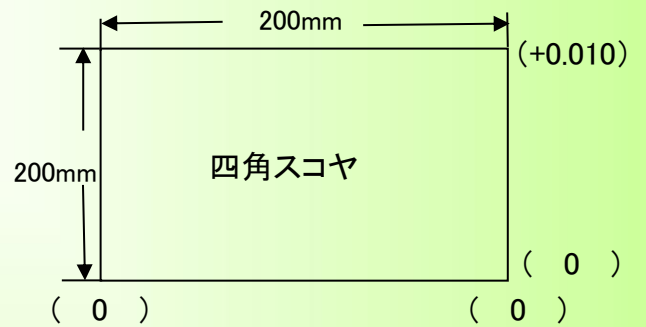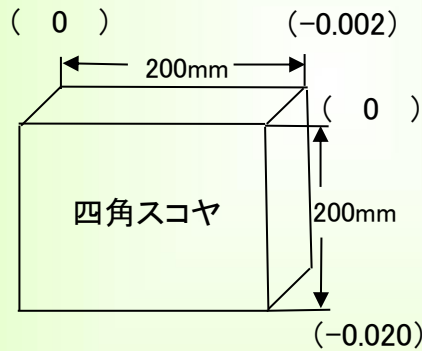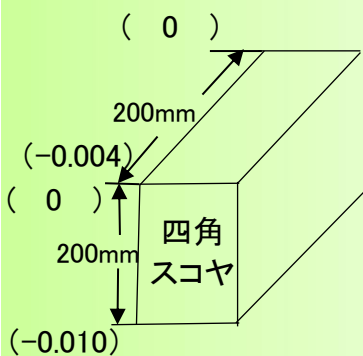

上面精度

※テーブルサイズ 650×400

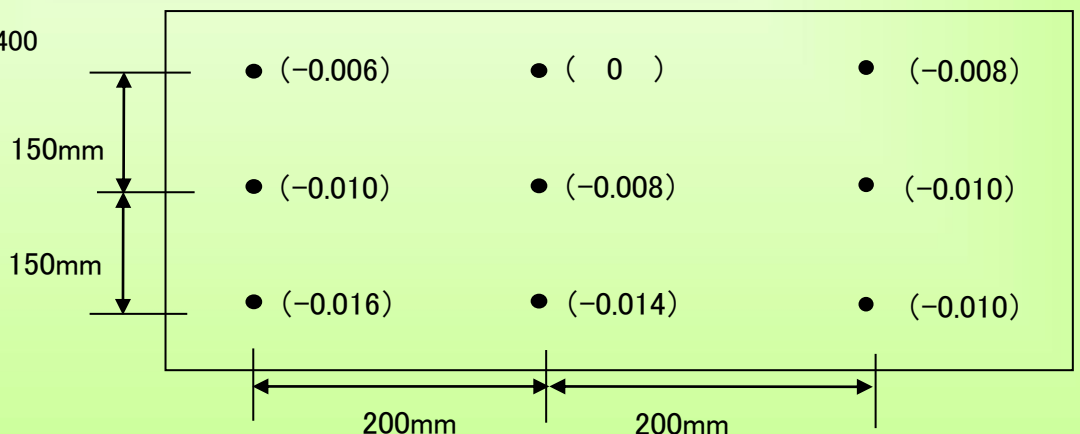

2021/5/22