


精度測定検査表

Examination for precision list


精度評価		コメント
A	0 ~ 0.02mm	全ての項目で 精度良好です
B	0 ~ 0.03mm	
C	0 ~ 0.04mm	
D	0 ~ 0.05mm	

メーカー	大隈豊和	バーコード	P1740
型式	MILLAC-511V		

振り回し(300ピッチ)

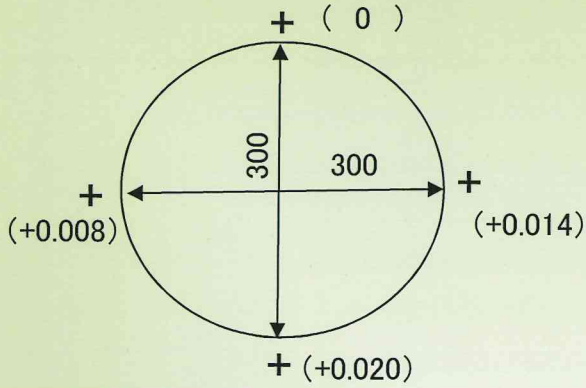


主軸振れ

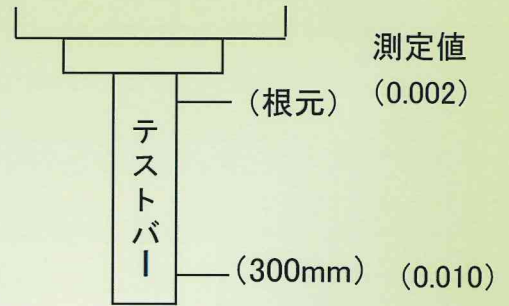


直角度


【YZ】

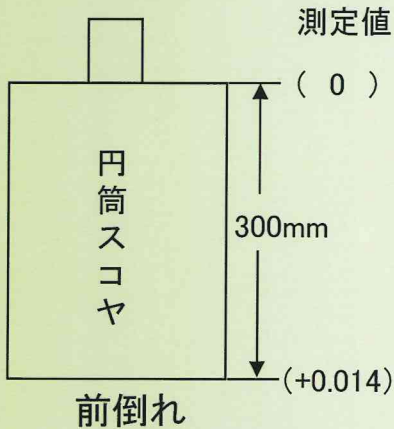

【XZ】

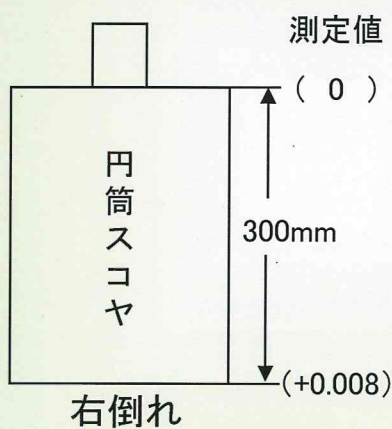

【XY】

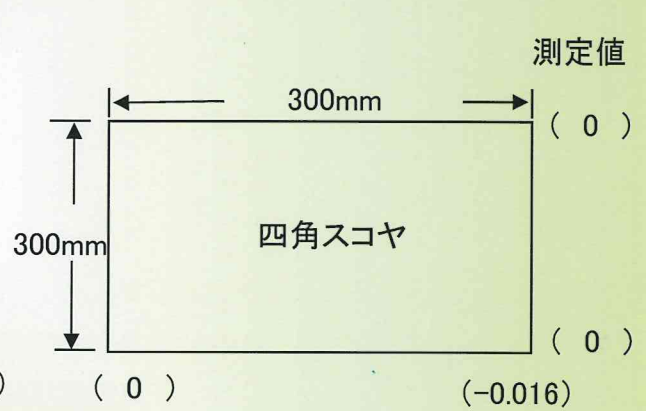

上面精度

