精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	1998年製	管理番号	P007459
型式	MILLAC-852V	測定者	金子・野辺沼	アシスタント	

気温26℃

振り回し(300ピッチ)

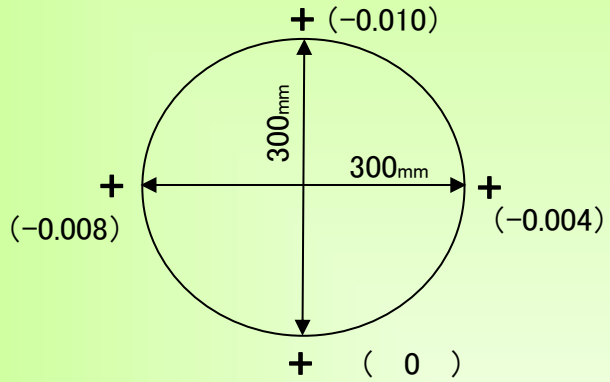

主軸振れ

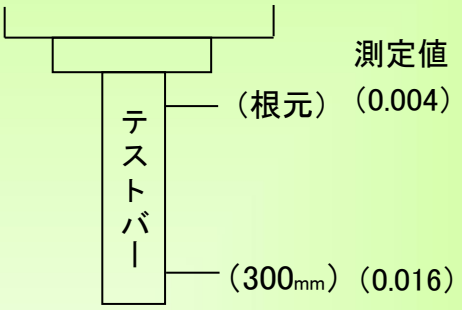

直角度

【YZ】 測定値 （0.008）　【XZ】 測定値 （0.008）　【X Y】測定値（0.008）

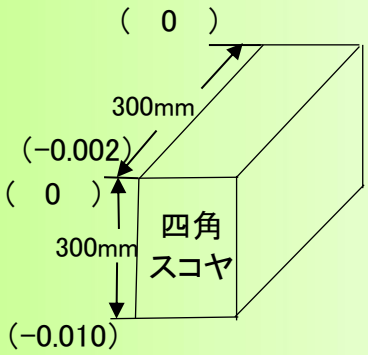

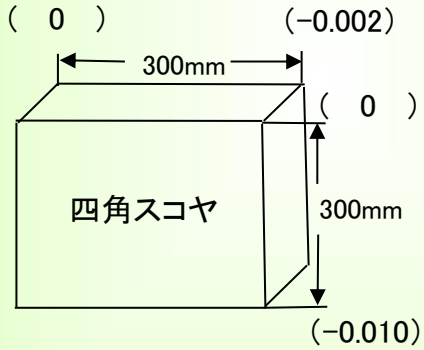

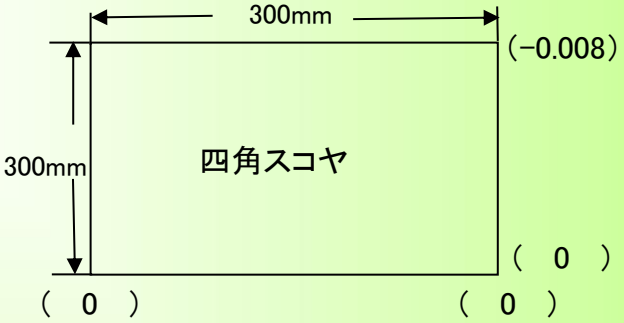

上面精度

※テーブルサイズ　2200×850

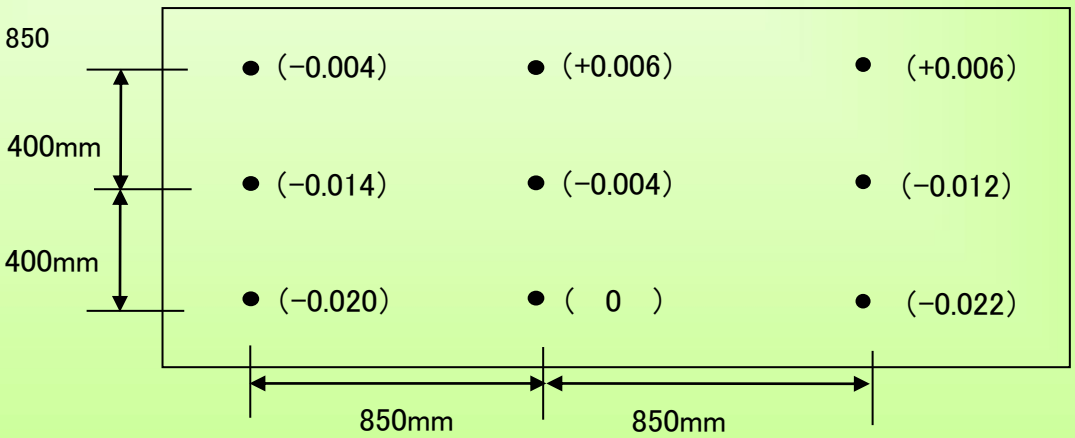

2021/5/24