


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2017年製	管理番号	P007376
型式	MB-5000H	測定者	金子・野辺沼	アシスタント	

## Z軸方向の平行度

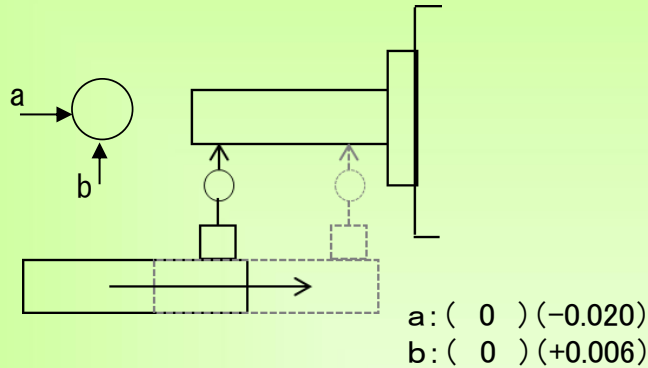

## 主軸振れ



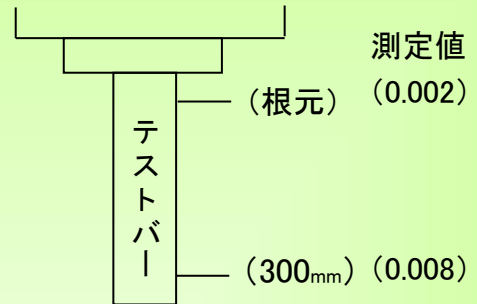


## 直角度

【XY】測定値 (0.008)

【ZY】測定値 (0.006)

【ZX】測定値 (0.016)

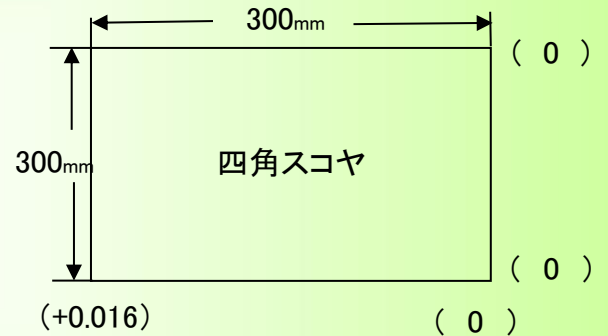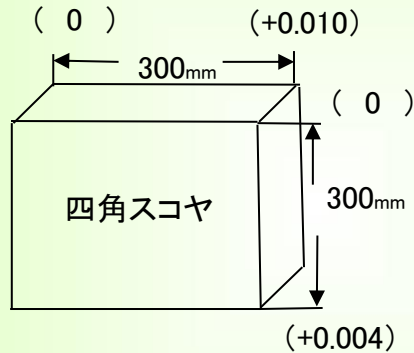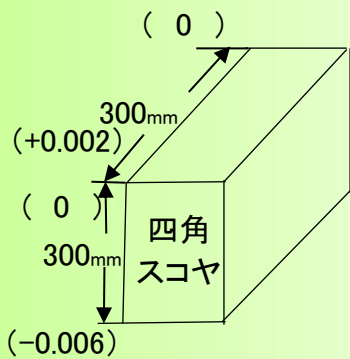


## 上面精度

テーブルサイズ : 500角

( )パレット1

[ ]パレット2

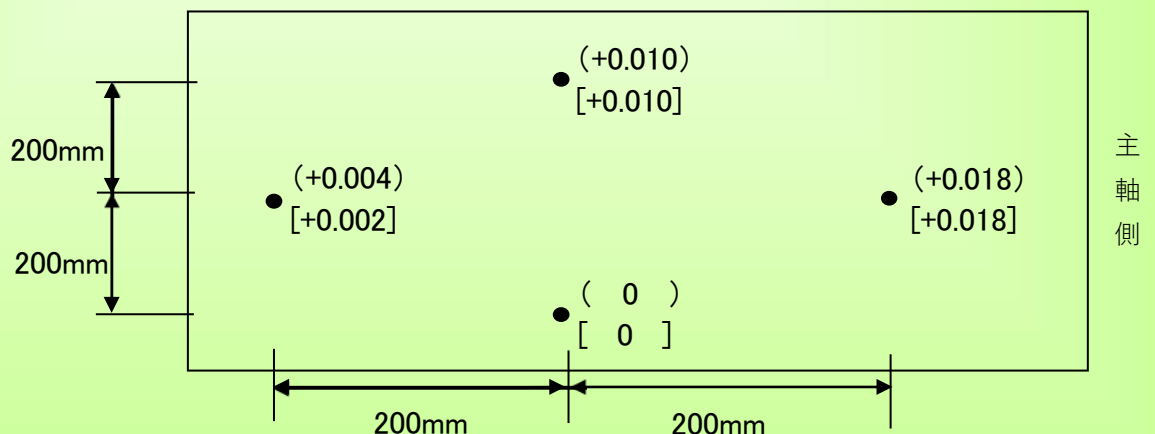

2021/5/29