精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	2000年製	管理番号	P007413
型式	MILLAC-438V	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

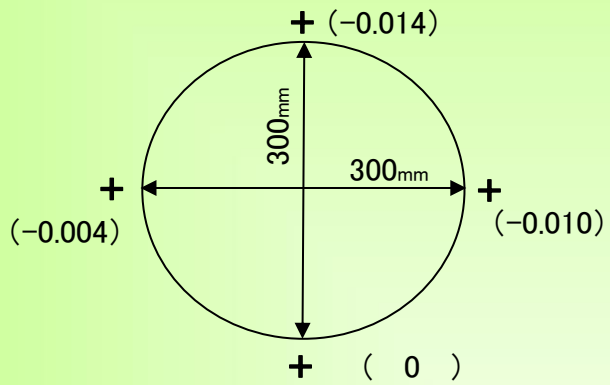

主軸振れ

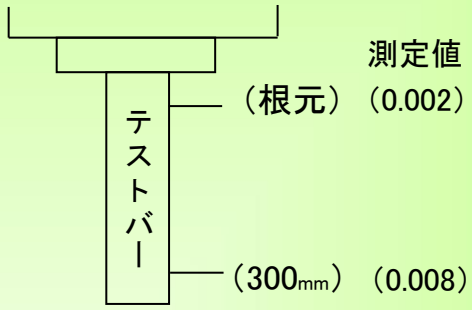

直角度

【YZ】測定値 (0.014)　【XZ】測定値 (0.012)　【X Y】測定値 (0.006)

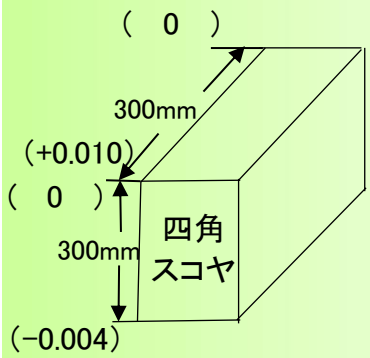

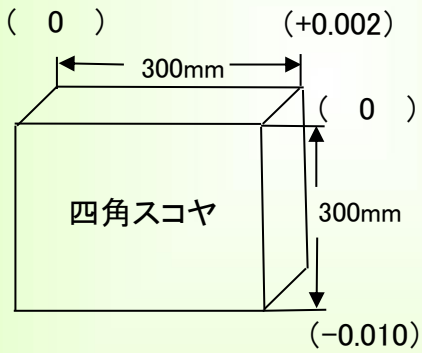

上面精度

※テーブルサイズ 1050×410

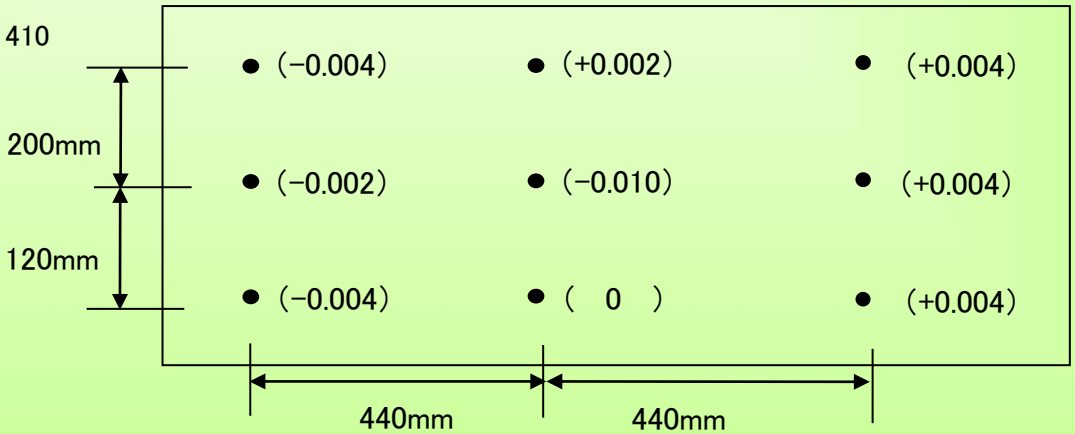

2021/5/31