


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2002年製	管理番号	P007400
型式	$\alpha$ -T14iCL	測定者	武藤	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

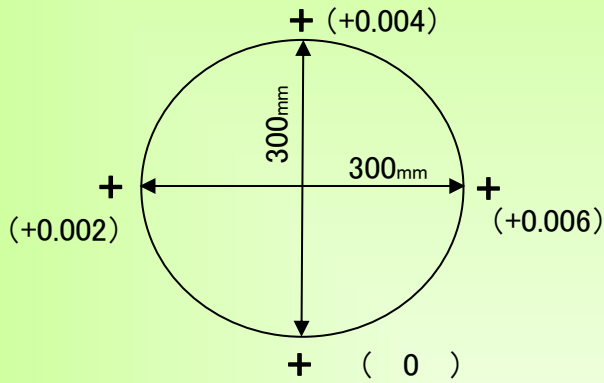

## 主軸振れ



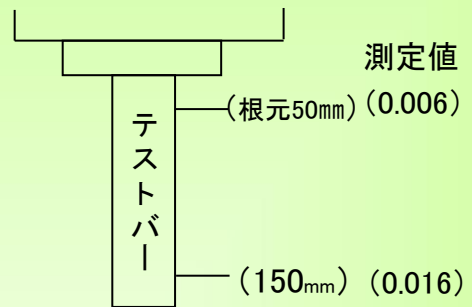


## 直角度

【YZ】 測定値 (0.002)


【XZ】 測定値 (0.002)

【XY】 測定値 (0.018)

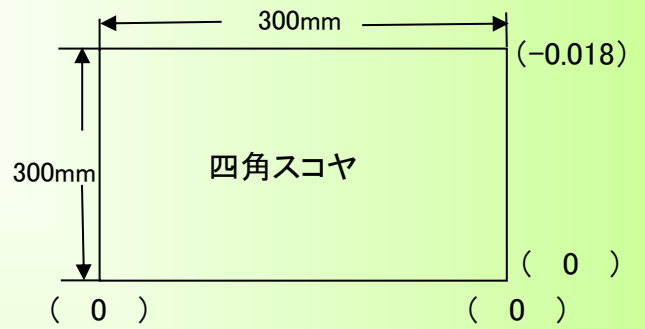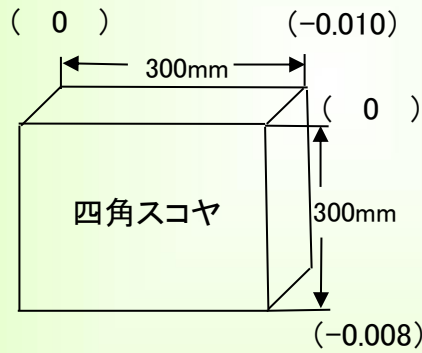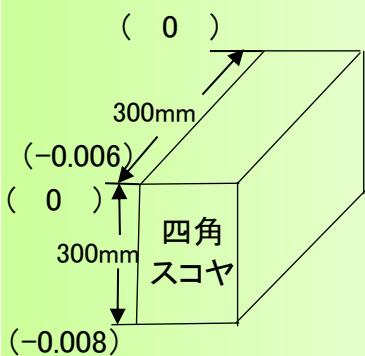

## 上面精度

※テーブルサイズ 850×410

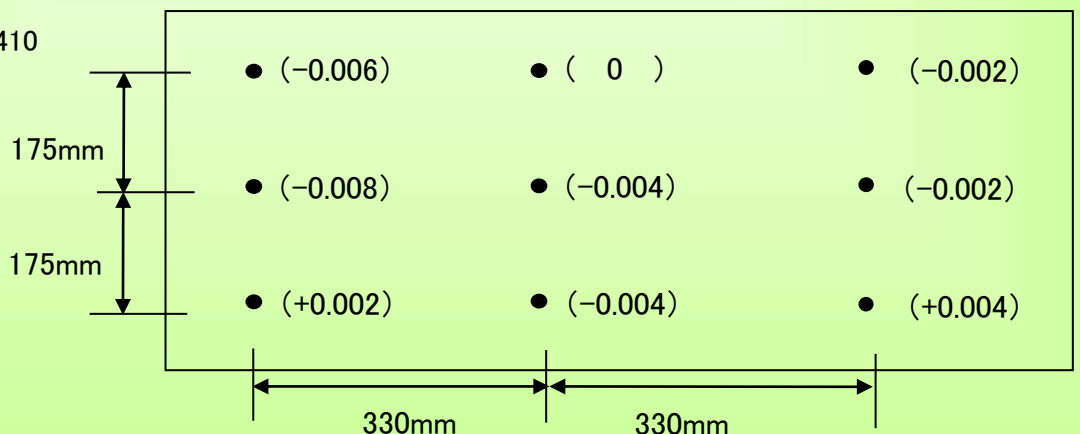

2021/6/1