


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	2001年製	管理番号	P007526
型式	MILLAC-611V	測定者	前田	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

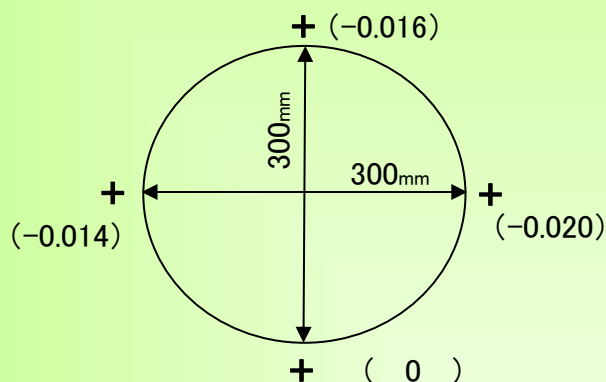

主軸振れ



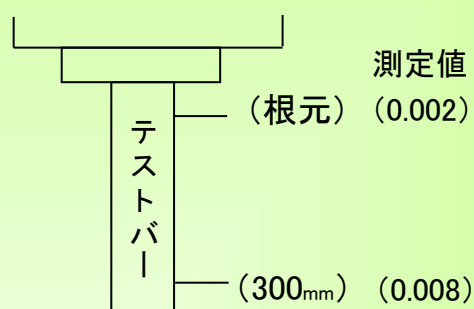


直角度

【YZ】測定値 (0.010)


【XZ】測定値 (0.014)

【X Y】測定値 (0.012)

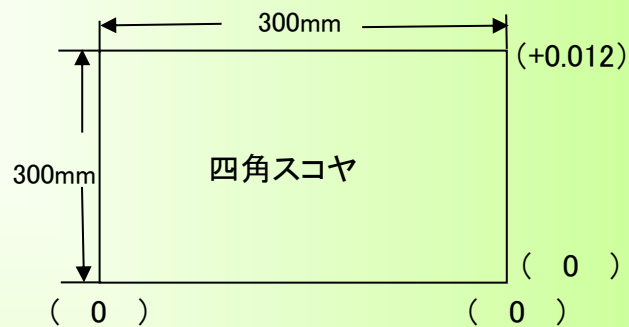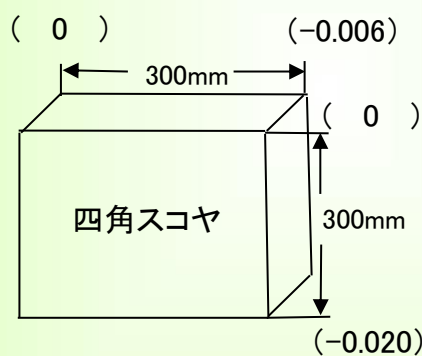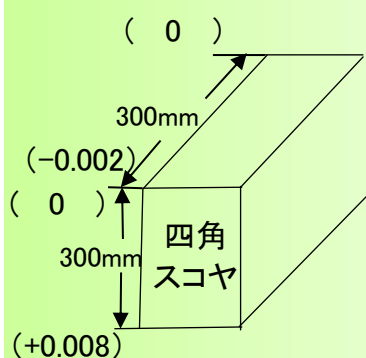

上面精度

※テーブルサイズ 1400×610

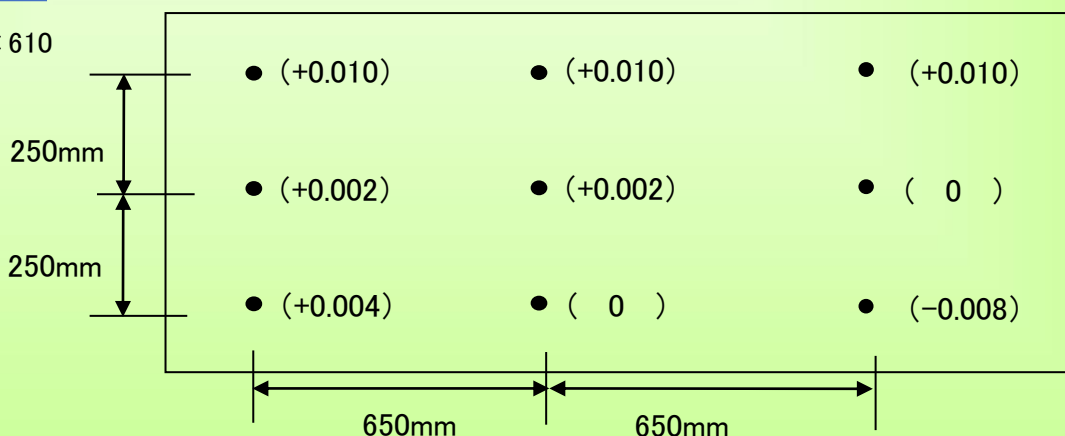

2021/6/11