精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	三菱電機	年式	2007年製	管理番号	P007449
型式	FA10PS-A	測定者	松山	アシスタント	

真直度

【X Y】 測定値(0.004)

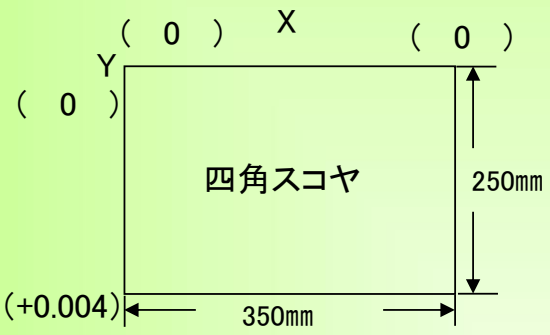

【Y Z】測定値(0.016)

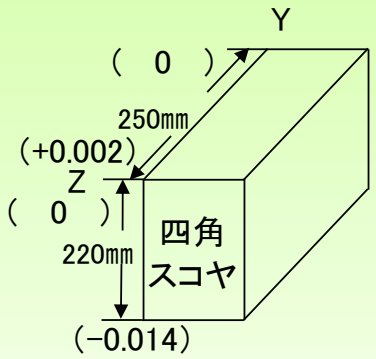

【X Z】測定値(0.009)

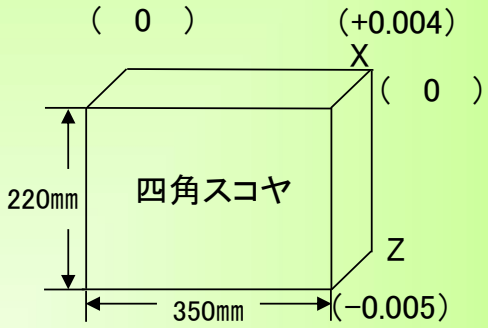

工作物取付台上面の平行度

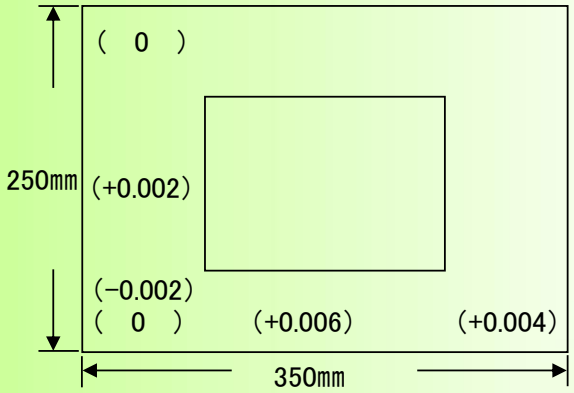

各軸の位置決め精度(バックラッシュ)

X軸 (±0)
Y軸 (0.001)
Z軸 (±0)

真円度

30φ

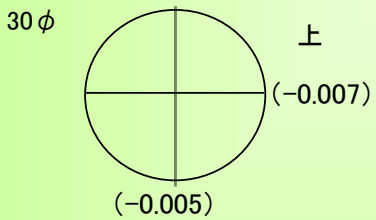

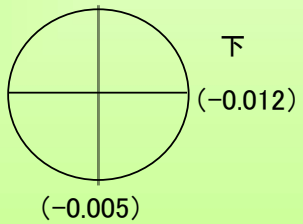

上下円筒度

上(0.002)
下(0.007)

真円度上下誤差率

(0.0045)

2021/6/17