


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	牧野フライス製作所	年式	1988年製	管理番号	H015159
型式	KSJP-55	測定者	山口	アシスタント	

振り回し(150ピッチ)

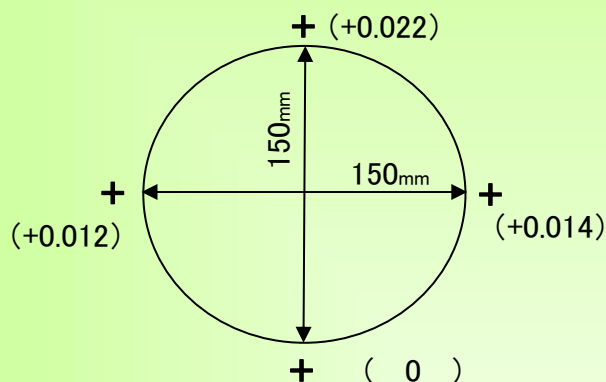

主軸振れ



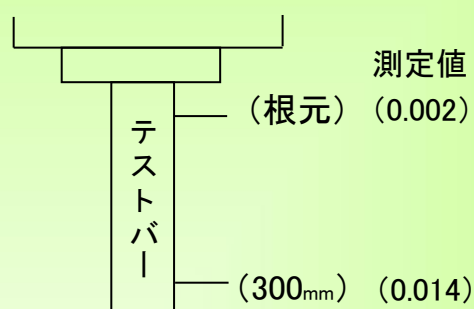


直角度

【YZ】 測定値 (0.012)


【XZ】 測定値 (0.032)

【X Y】 測定値 (0.010)

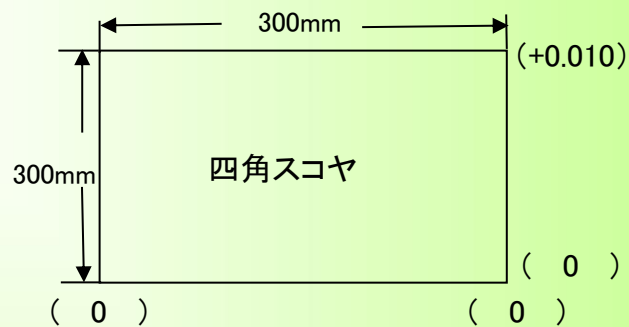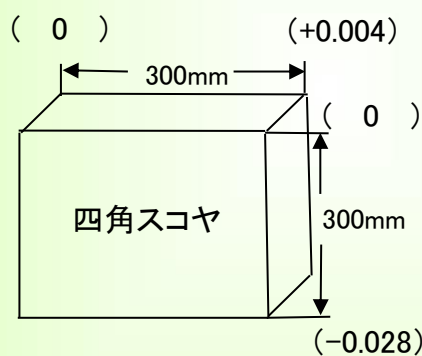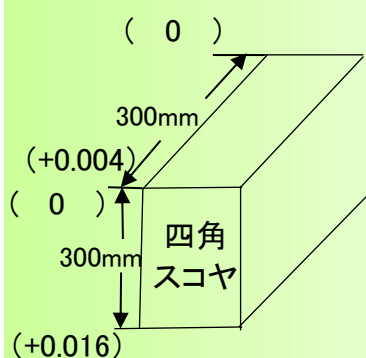

上面精度

※テーブルサイズ 1100×250

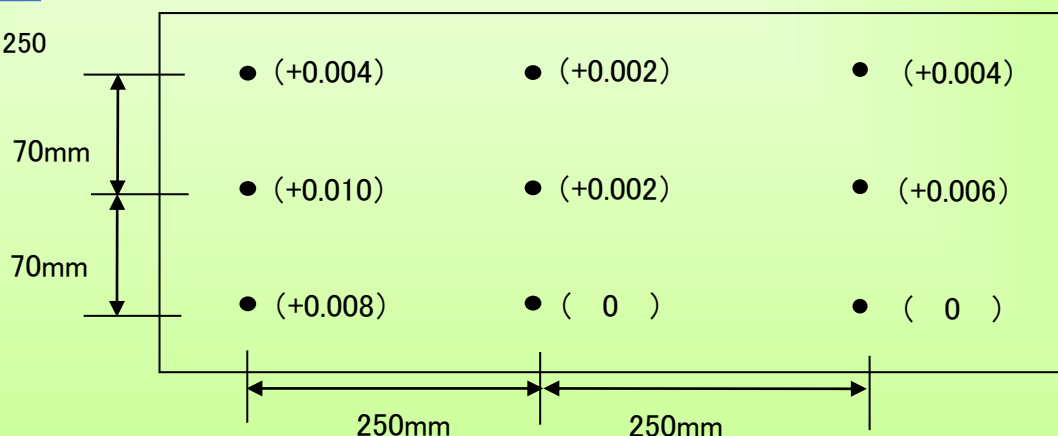

2021/6/30