


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2006年製	管理番号	P007520
型式	$\alpha$ -T21iE	測定者	武藤	アシスタント	

## 振り回し(200ピッチ)

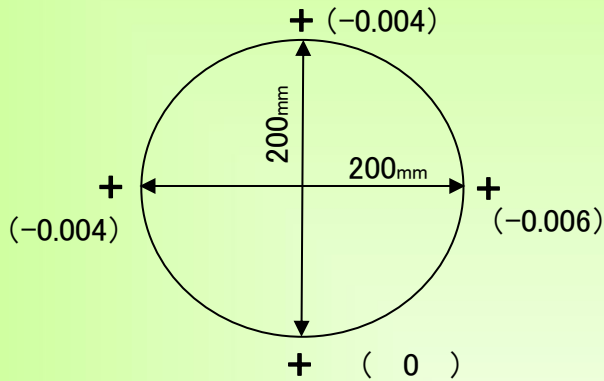

## 主軸振れ



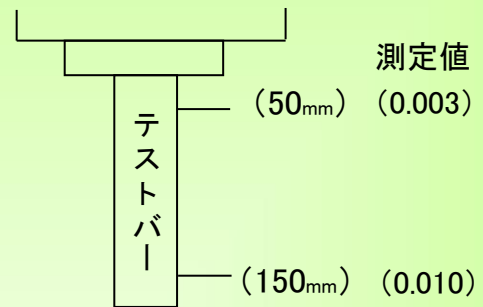


## 直角度

【YZ】 測定値 (0.004)

【XZ】 測定値 (0.006)

【XY】 測定値 (0.006)

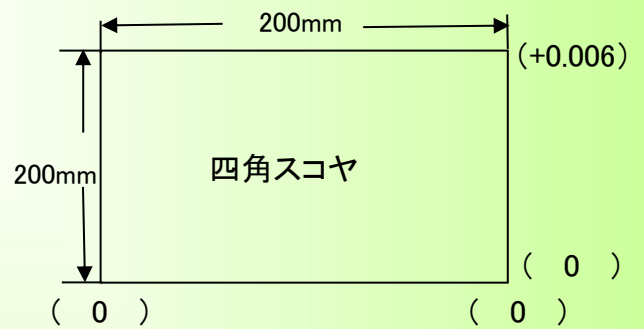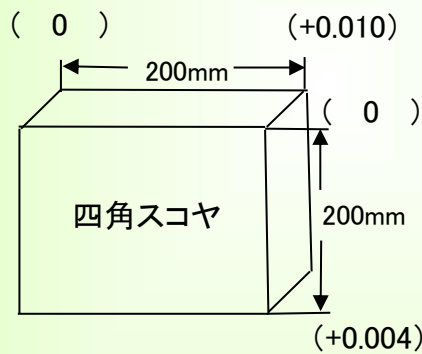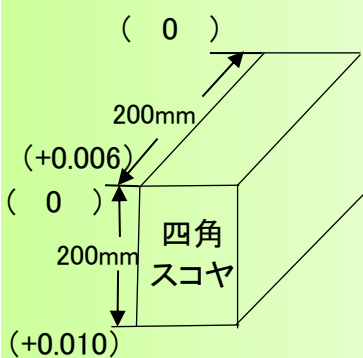

## 上面精度


※テーブルサイズ 650×400

【バックラッシュ】

X軸 0.002

Y軸 0.002

Z軸 0.002

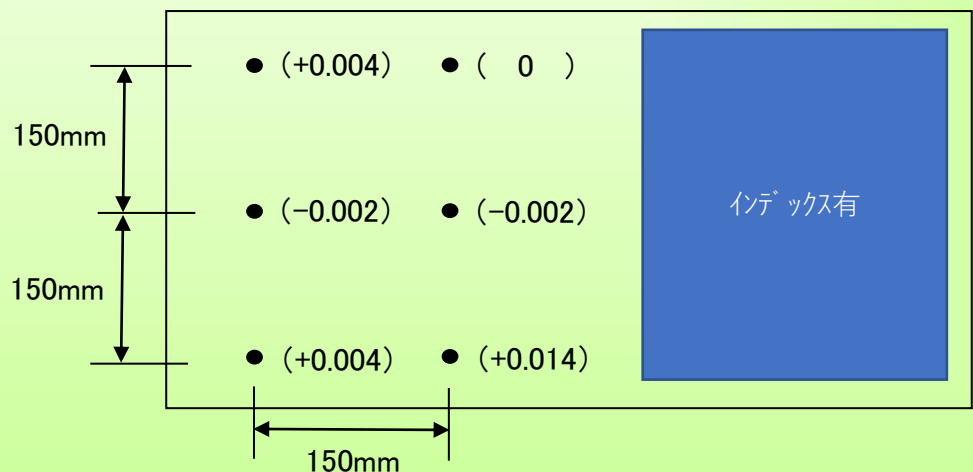

2021/6/30