精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2006年製	管理番号	P007519
型式	α-T21iE	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(200ピッチ)

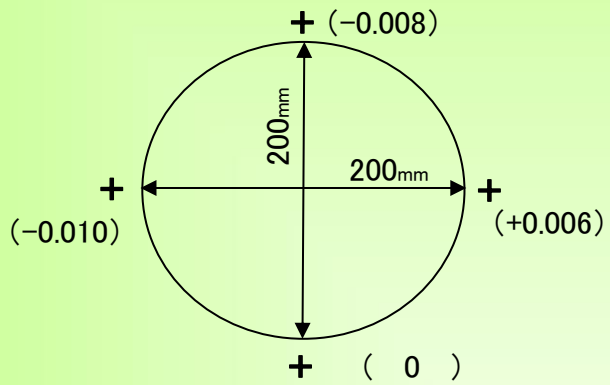

主軸振れ

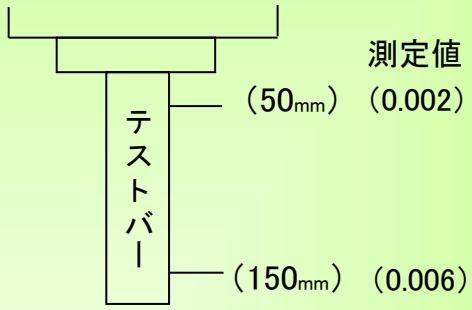

直角度

【YZ】測定値 (0.014)　【XZ】測定値 (0.016)　【X Y】測定値 (0.004)

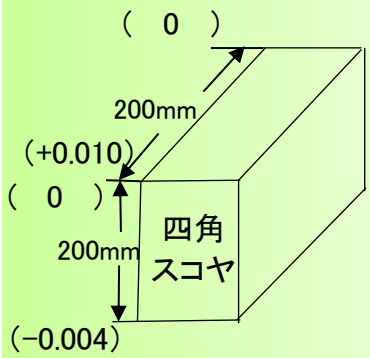

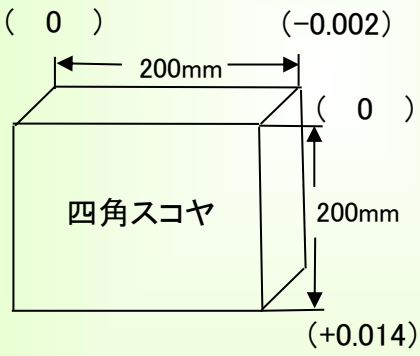

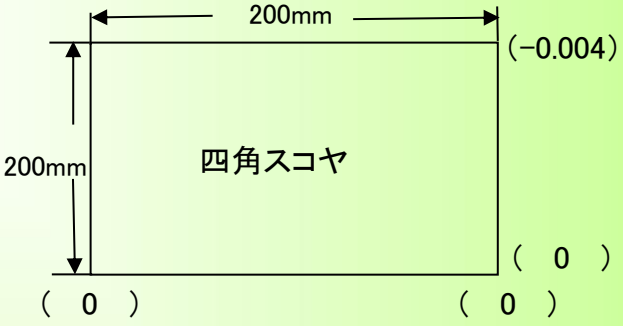

上面精度

※テーブルサイズ 650×400

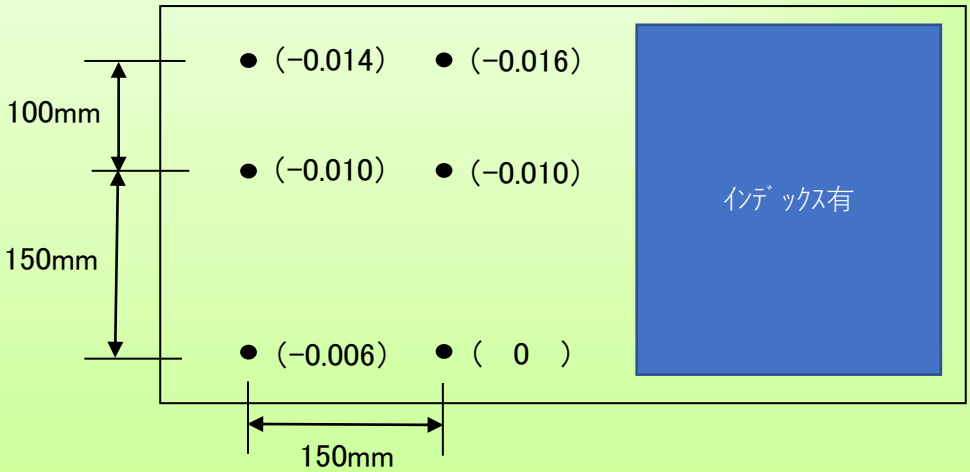

2021/6/30