


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2004年製	管理番号	H015996
型式	MCR-A 25×40-A	測定者	仙田・平野	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

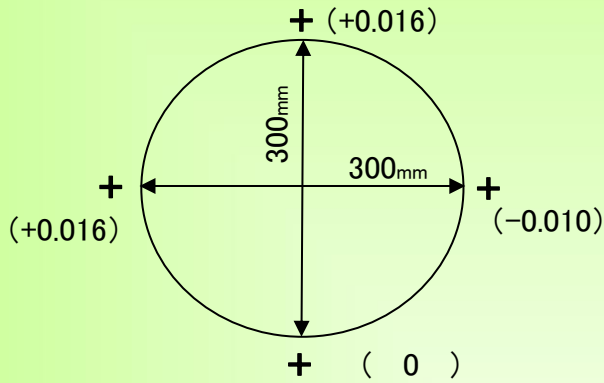

主軸振れ



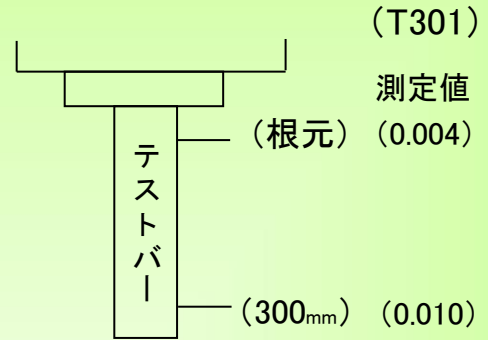


直角度

【YZ】 測定値 (0.014)


【XZ】 測定値 (0.020)

【XY】 測定値 (0.014)

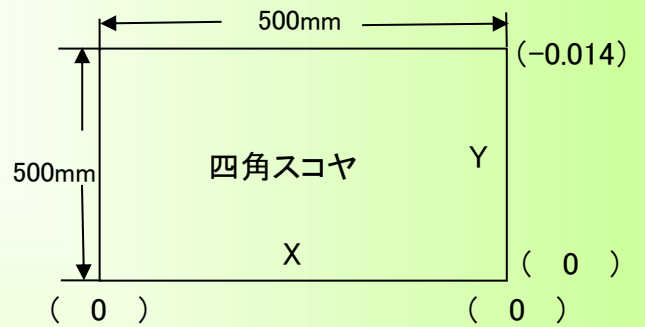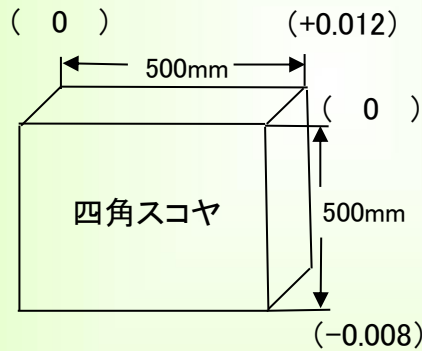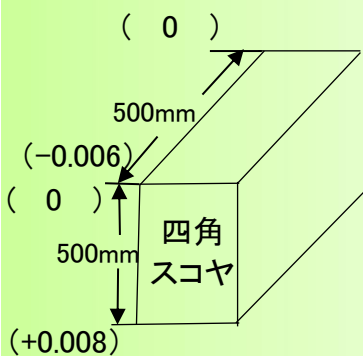

上面精度

※テーブルサイズ 4000×2000

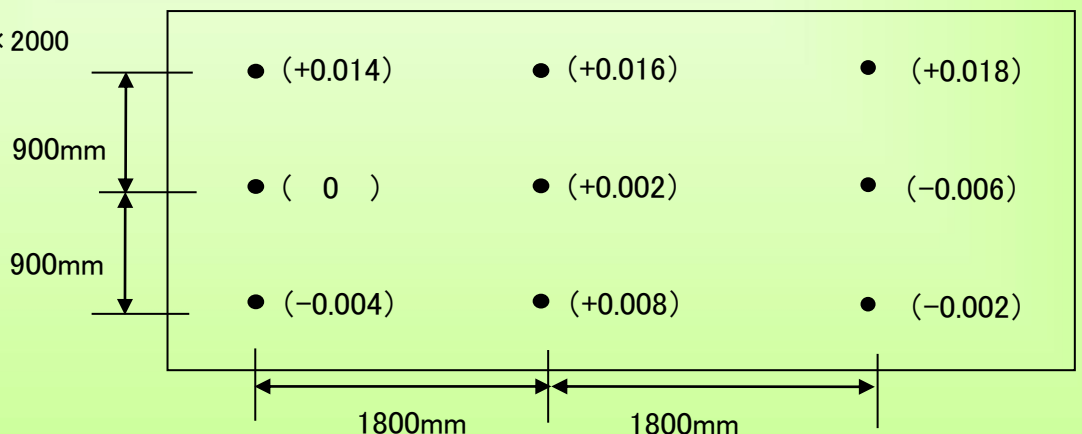

2021/6/30