


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ブラザー	年式	2004年製	管理番号	P007510
型式	TC-22A	測定者	武藤	アシスタント	

## 振り回し(200ピッチ)

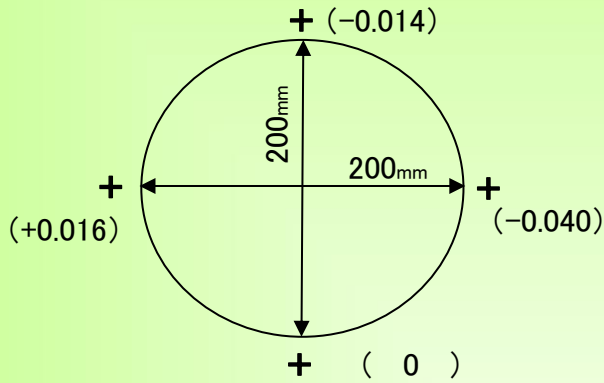

## 主軸振れ



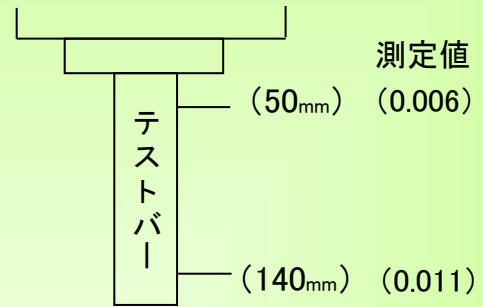


## 直角度

【YZ】測定値 (0.004)

【XZ】測定値 (0.010)

【XY】測定値 (0.040)

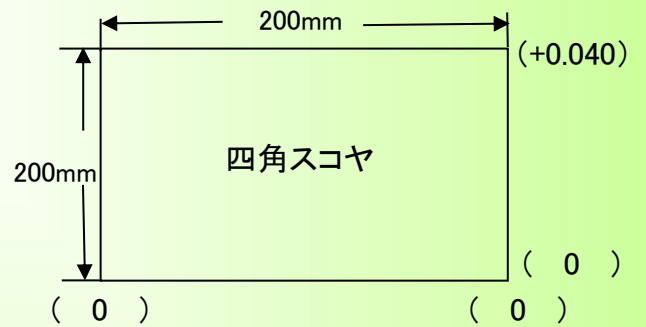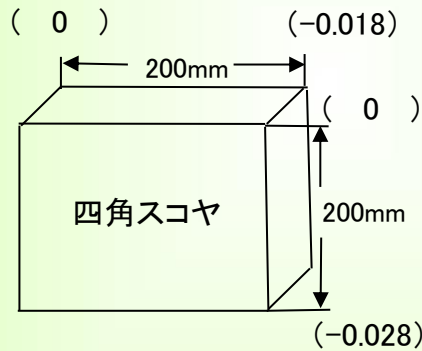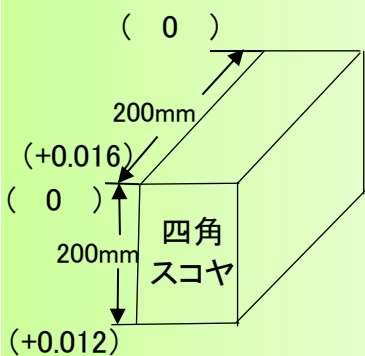


## 上面精度

※テーブルサイズ 650×400

【バックラッシュ】

X軸 0.002  
Y軸 0.002  
Z軸 0.002

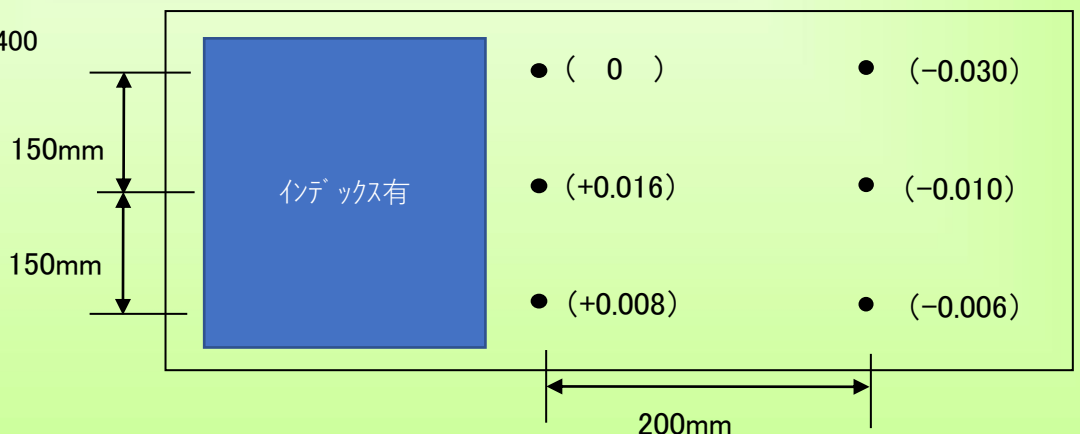

2021/7/19