


精度測定検査表


Examination for precision list

| | | | | | |
|------|----------------|-----|--------|--------|---------|
| メーカー | 森精機 | 年式 | 2006年製 | 管理番号 | P007621 |
| 型式 | NV5000 α 1B/40 | 測定者 | 金子 | アシスタント | |

振り回し(300ピッチ)

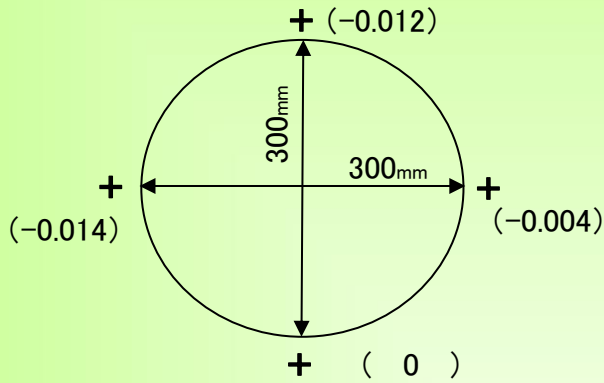

主軸振れ



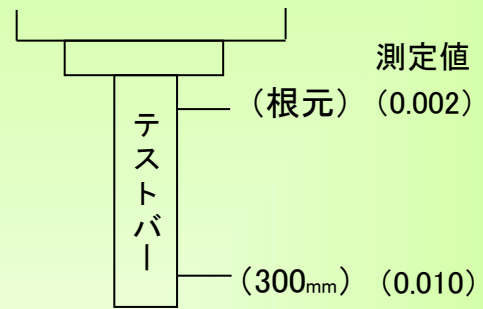


直角度

【YZ】 測定値 (0.016)


【XZ】 測定値 (0.008)

【XY】 測定値 (0.008)

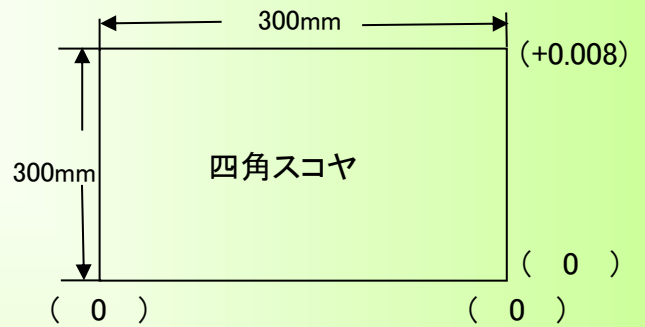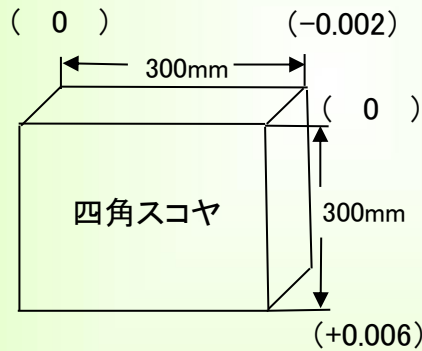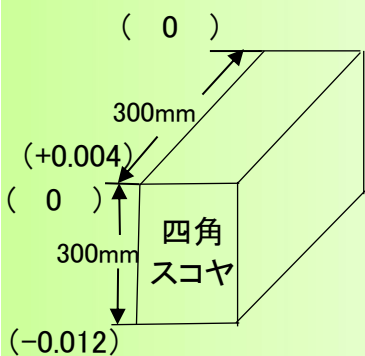

上面精度

※テーブルサイズ 1320×600

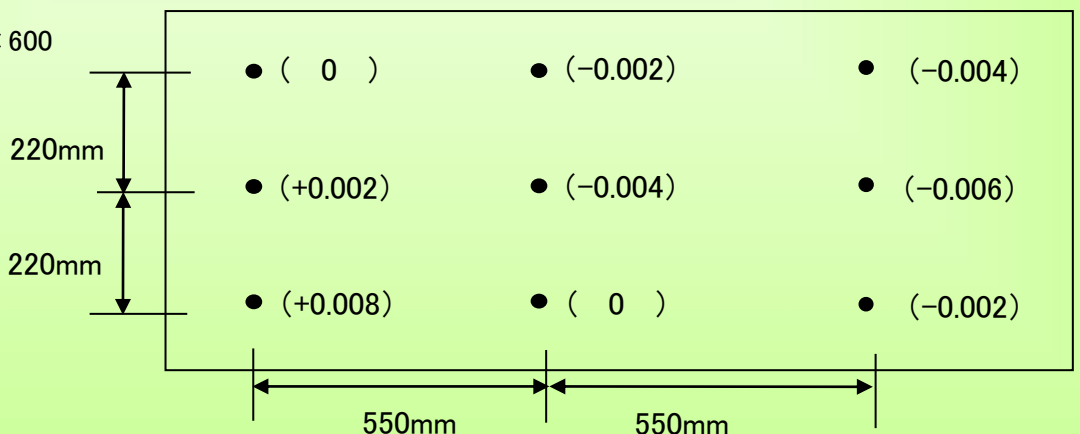

2021/9/10