


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ブラザー	年式	2009年製	管理番号	P007307
型式	TC-S2A-0	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(200ピッチ)

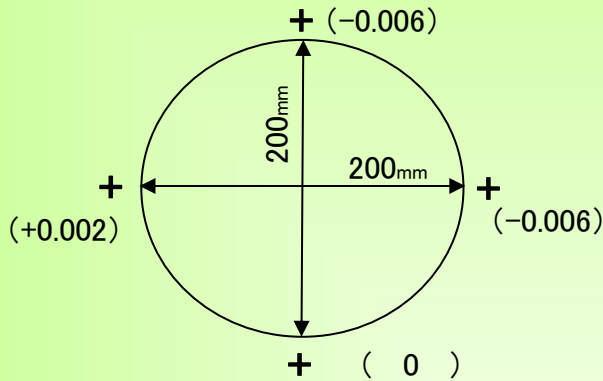

主軸振れ



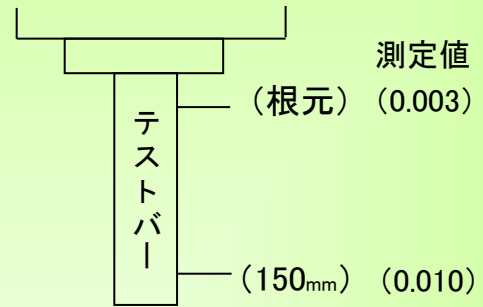


直角度

【YZ】測定値 (0.010)


【XZ】測定値 (0.006)

【XY】測定値 (0.004)

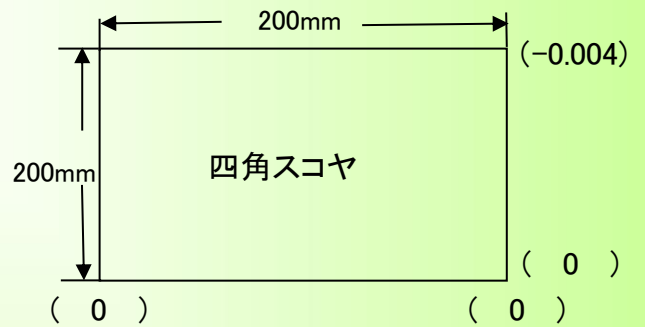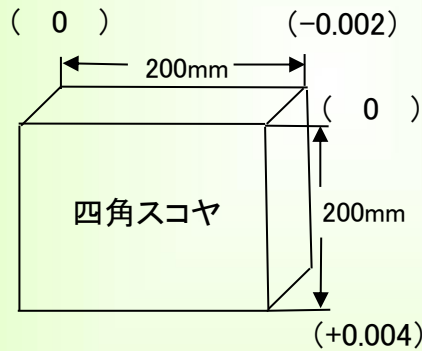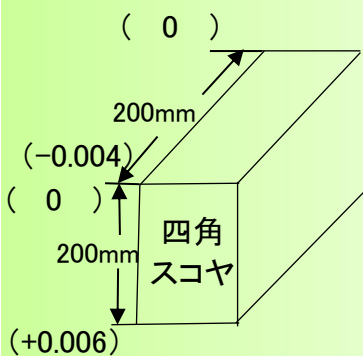

上面精度

※テーブルサイズ 800×320

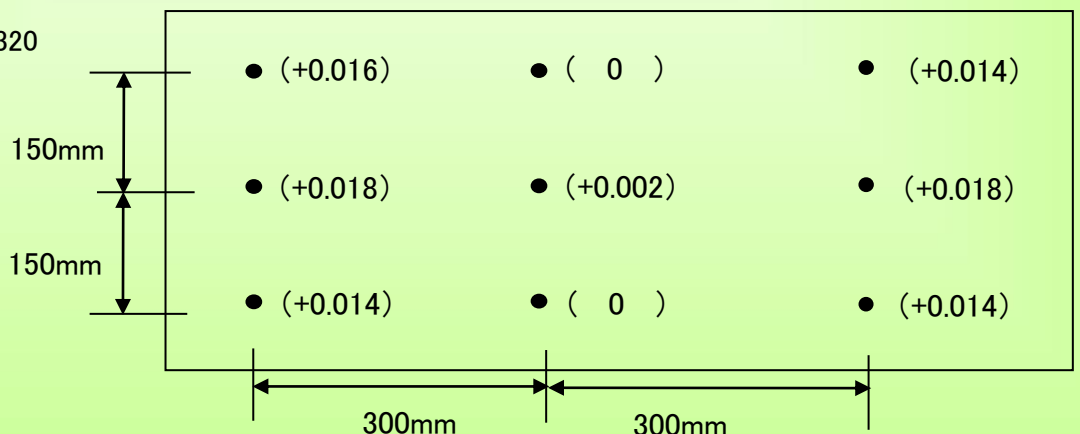

2021/10/23