


# 精度測定検査表


*Examination for precision list*

メーカー	森精機	年式	2003年製	管理番号	P007679
型式	NV5000B/40	測定者	野辺沼	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

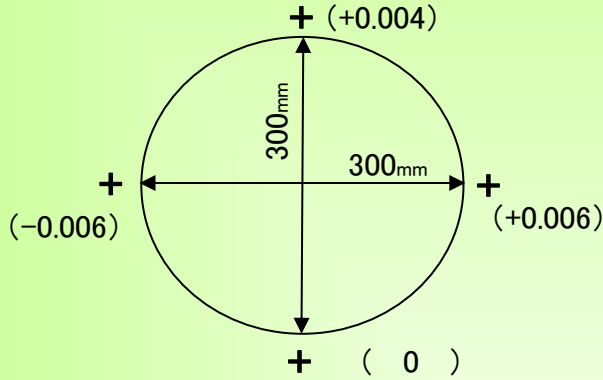

## 主軸振れ



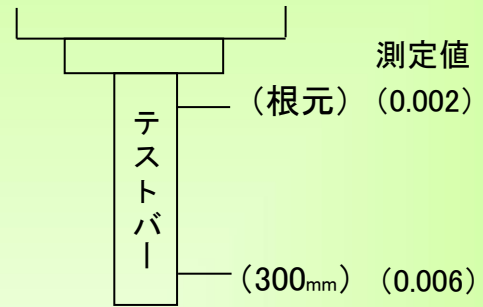


## 直角度

【YZ】 測定値 (0.008)


【XZ】 測定値 (0.012)

【XY】 測定値 (0.008)

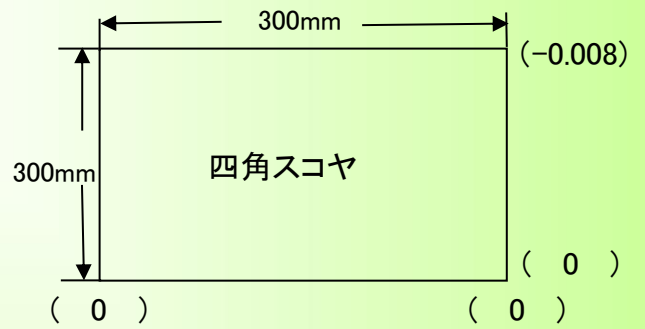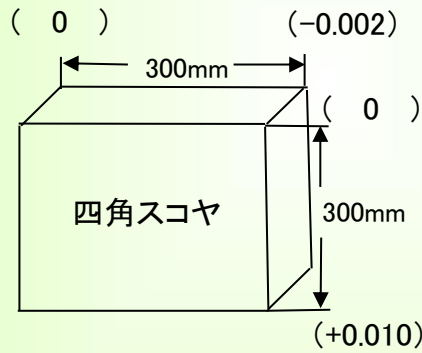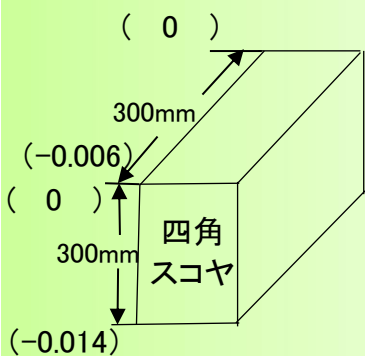

## 上面精度

※テーブルサイズ 1320×600

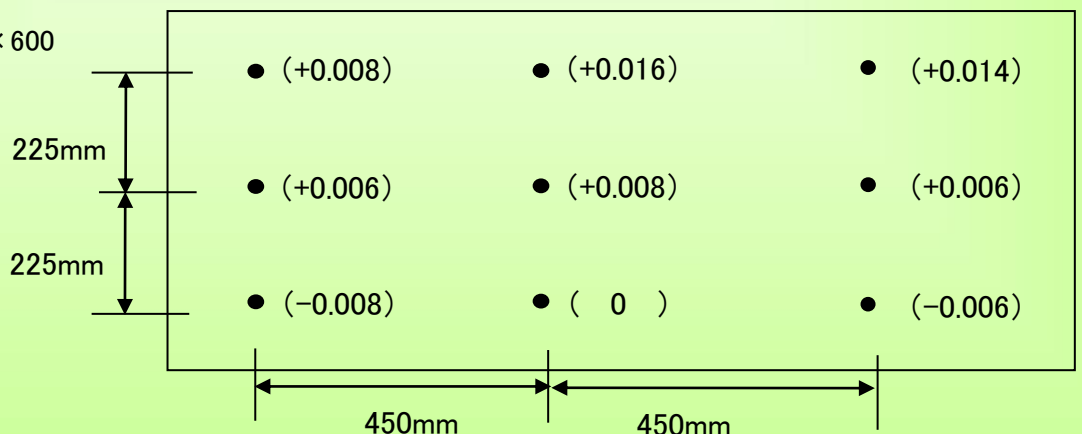

2021/11/2