


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	KIRA	年式	2001年製	管理番号	P007630
型式	KT-30	測定者		アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

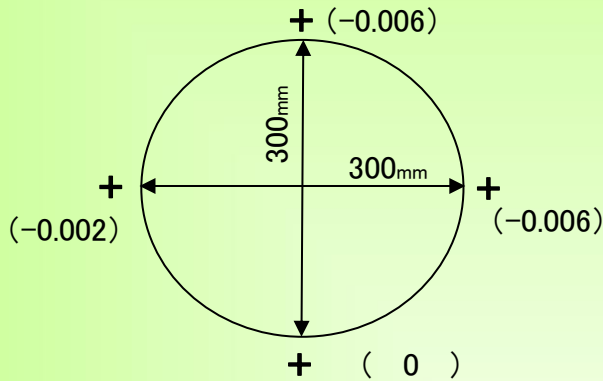

主軸振れ



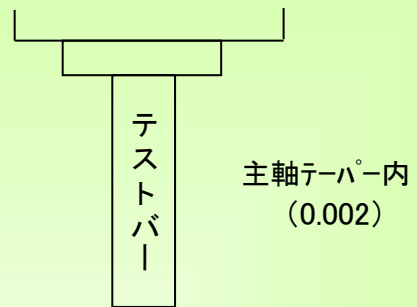


直角度

【YZ】測定値 (0.008)


【XZ】測定値 (0.010)

【XY】測定値 (0.014)

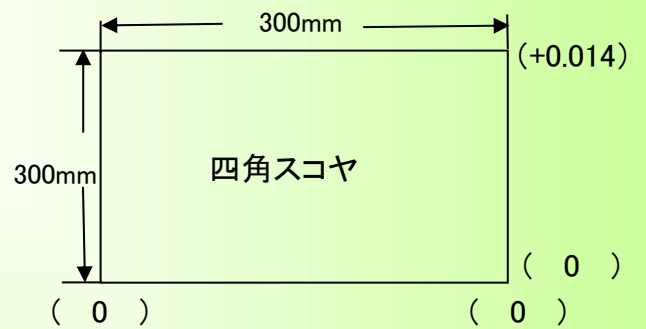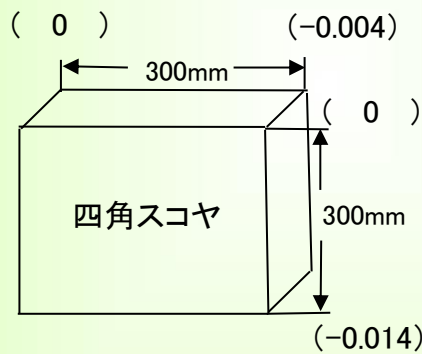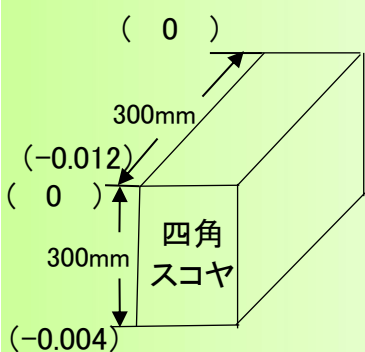

上面精度

※テーブルサイズ 500×320

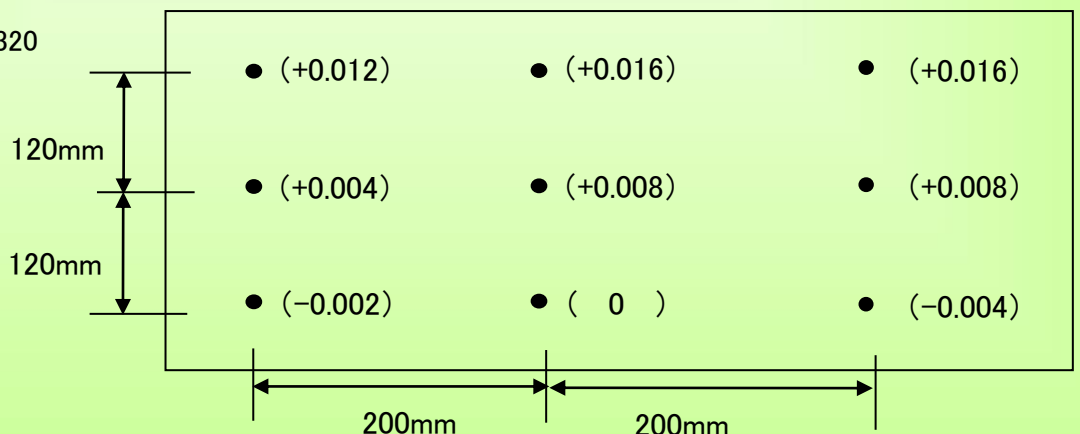

2021/11/16