


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2004年製	管理番号	P007659
型式	α -T21iDL	測定者	奥澤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

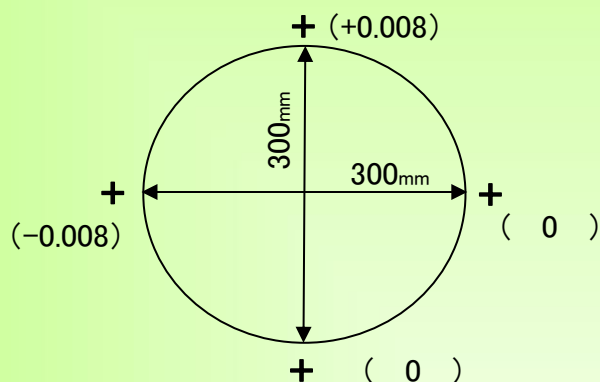

主軸振れ



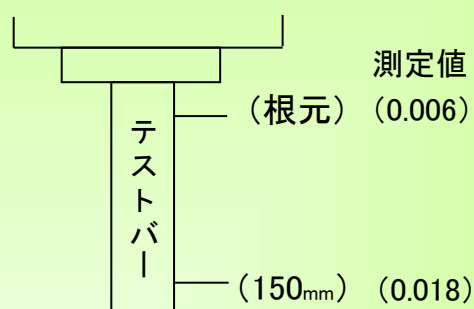


直角度

【YZ】 測定値 (0.008)


【XZ】 測定値 (0.020)

【X Y】 測定値 (0.010)

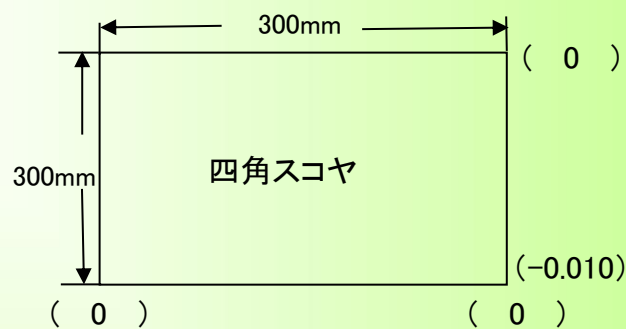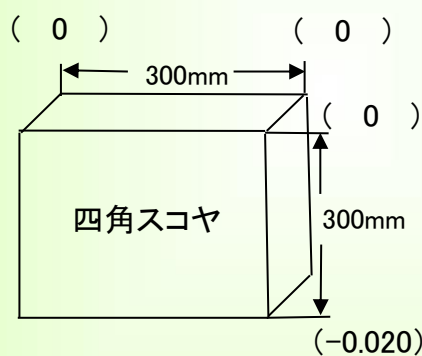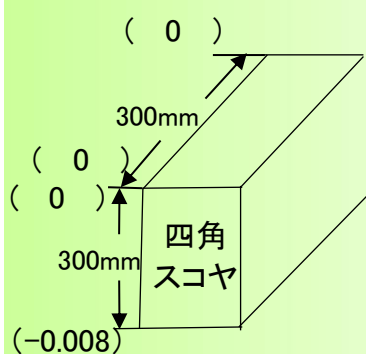

上面精度

※テーブルサイズ 850×410

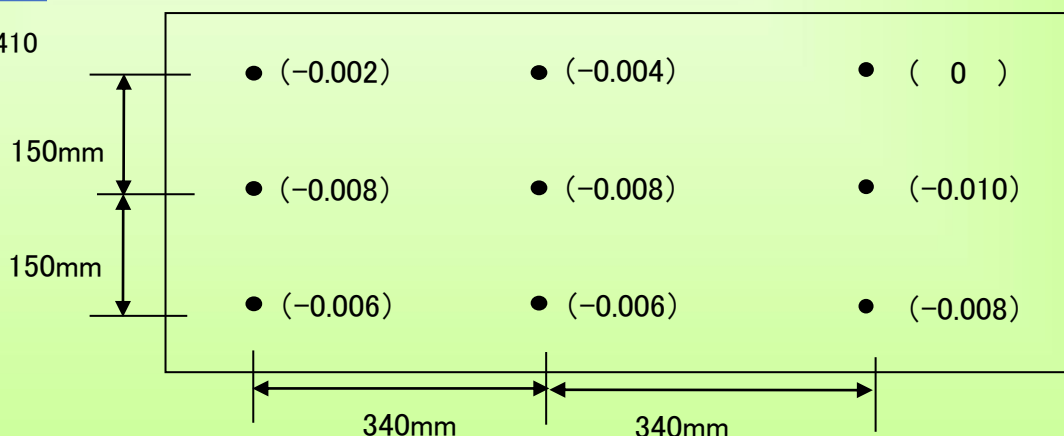

2021/11/30