


精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	オークマ	管理番号	P007682		
型式	HL-20	年式	2007年製	測定者	宮原

2021/12/9


刃物台精度

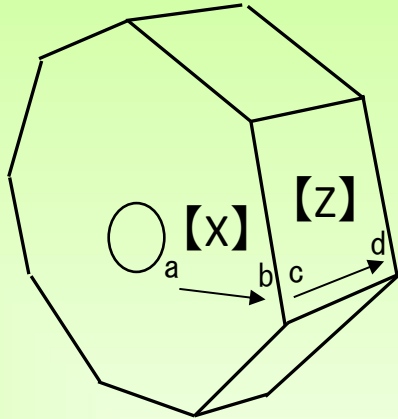

X軸(移動量70mm)
T2(a 0 → b -0.020)
T8(a 0 → b -0.020)

Z軸(移動量70mm)
T2(c 0 → d -0.014)
T8(c 0 → d -0.016)

主軸と刃物台の穴中心精度

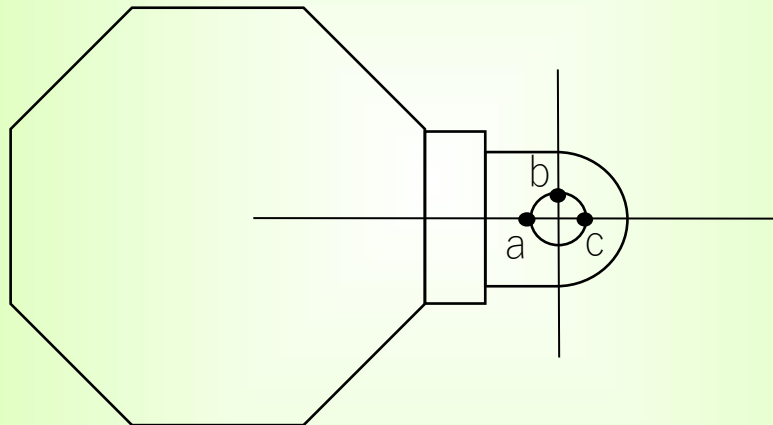

芯ズレ量 T5, T11
a 0
b -0.030
c 0

テスト加工

