


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	牧野フライス	年式	2004年製	管理番号	P007742
型式	a61	測定者	奥澤	アシスタント	

Z軸方向の平行度

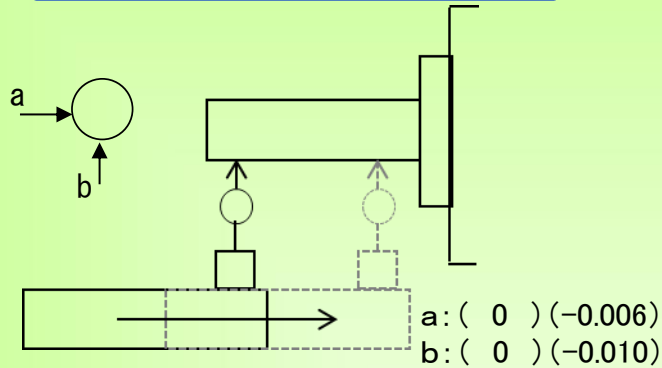

主軸振れ



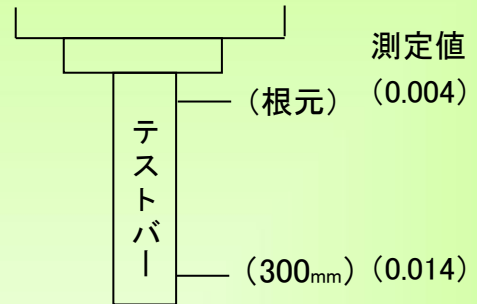


直角度

【XY】測定値 (0.006)

【ZY】測定値 (0.018)


【ZX】測定値 (0.006)

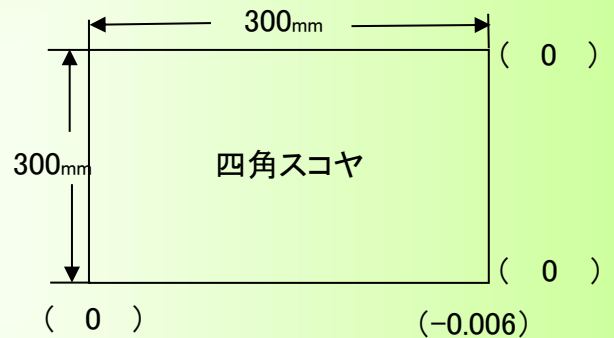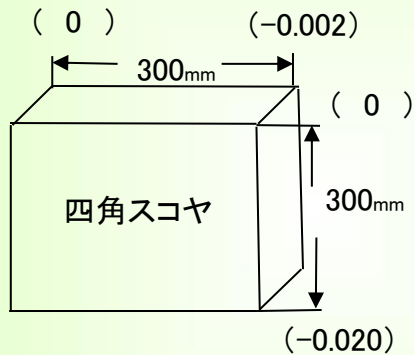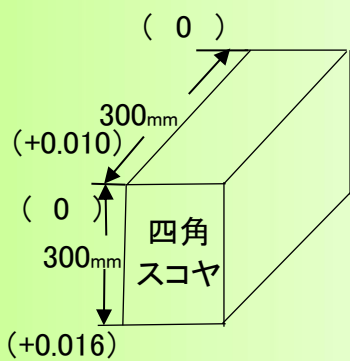

上面精度

テーブルサイズ：500角

()パレット1
[]パレット2

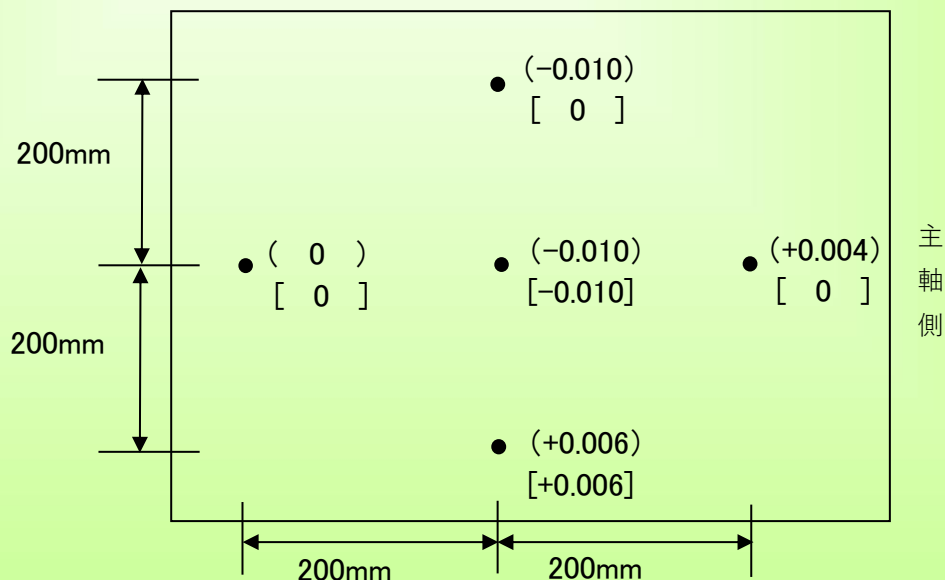

2021/12/18