


# 精度測定検査表


*Examination for precision list*

メーカー	ブラザー	年式	2003年製	管理番号	P007722
型式	TC-S2B-O	測定者	野辺沼	アシスタント	

## 振り回し(200ピッチ)

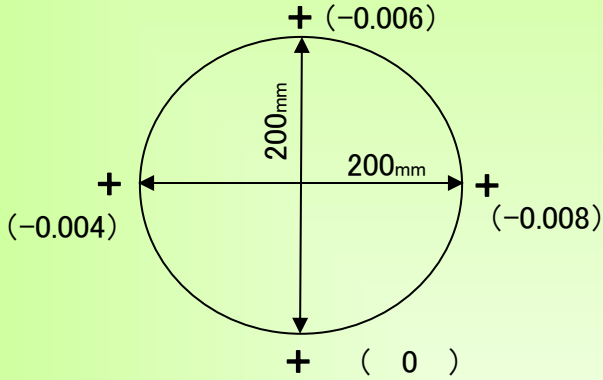

## 主軸振れ



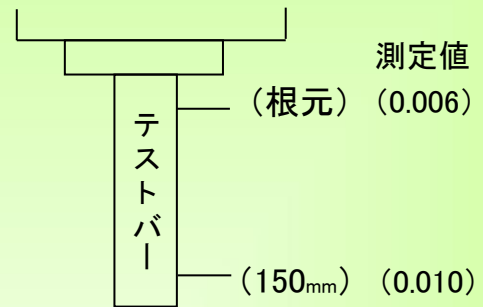


## 直角度

【YZ】測定値 (0.004)


【XZ】測定値 (0.006)

【XY】測定値 (0.004)

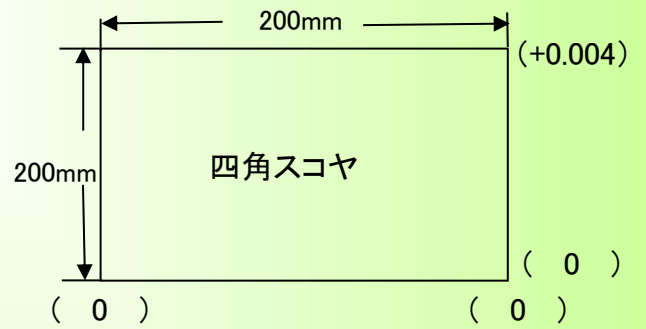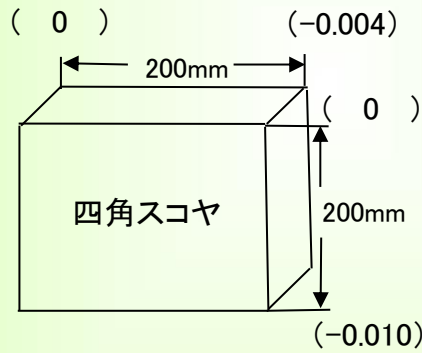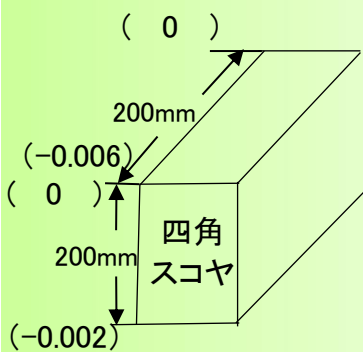

## 上面精度

※テーブルサイズ 800×320

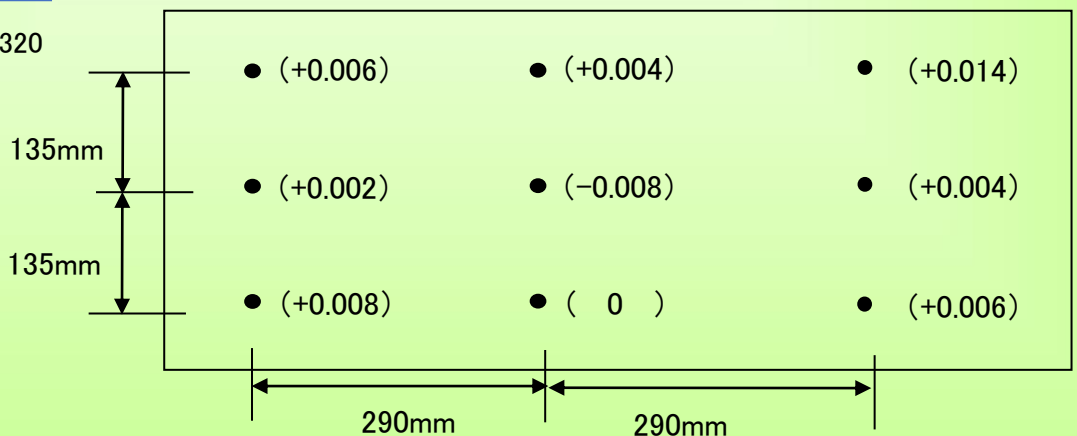

2022/1/17