


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	牧野フライス製作所	年式	2005年製	管理番号	H016480
型式	KGAP-55	測定者	山口	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

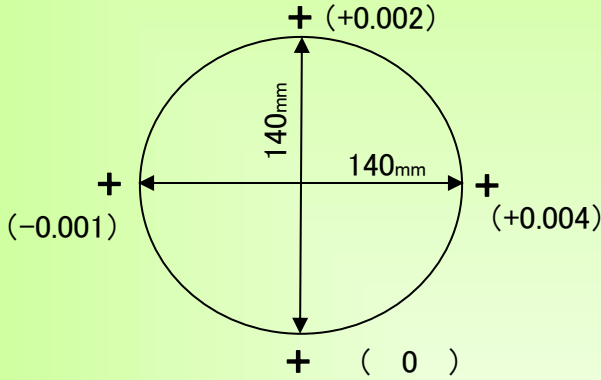

主軸振れ



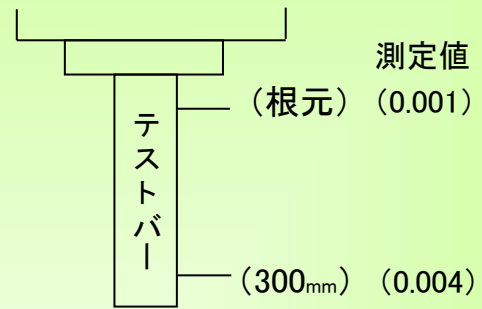


直角度

【YZ】測定値 (0.002)


【XZ】測定値 (0.006)

【XY】測定値 (0.005)

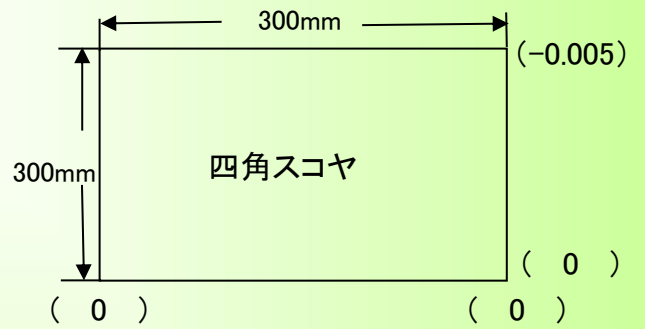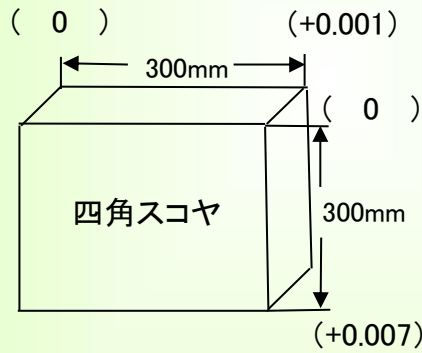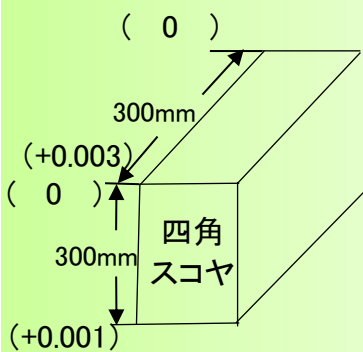

上面精度

※テーブルサイズ 1100×250

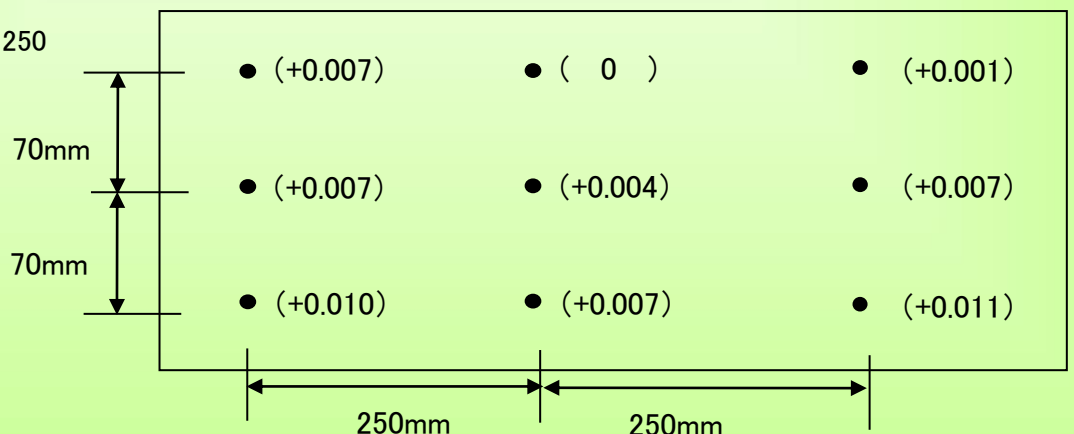

2022/1/20