精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	北村	年式	2005年製	管理番号	P007776
型式	Mycenter-2XiF	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

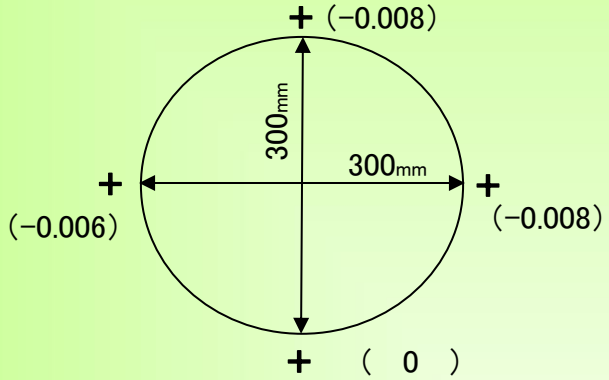

主軸振れ

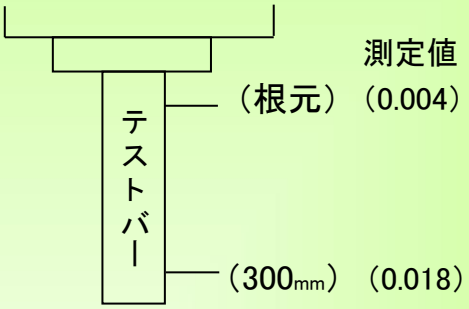

直角度

【YZ】測定値 (0.010)　【XZ】測定値 (0.010)　【X Y】測定値 (0.018)

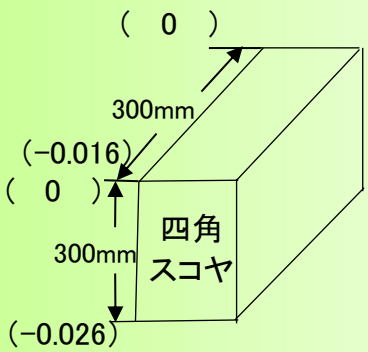

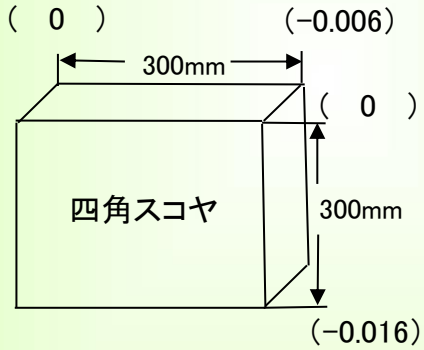

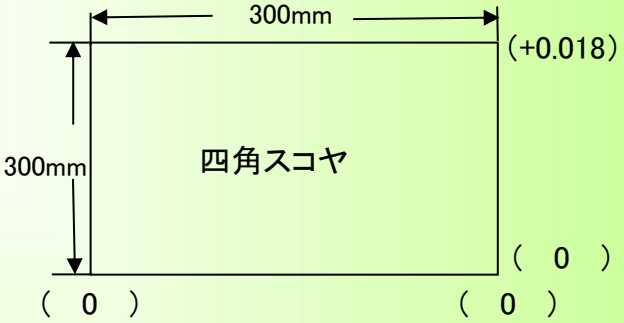

上面精度

※テーブルサイズ　780×350

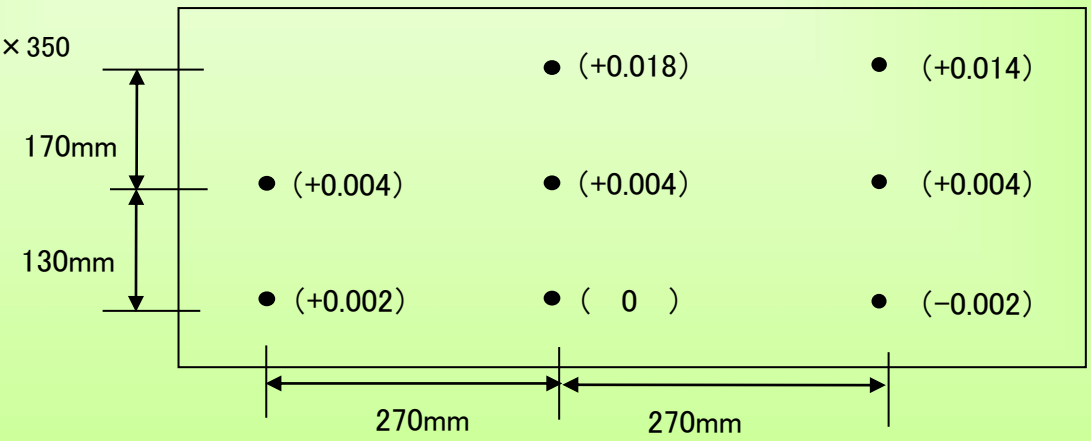

2022/2/5