


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	静岡	年式	2005年製	管理番号	P007784
型式	B-7VHS	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

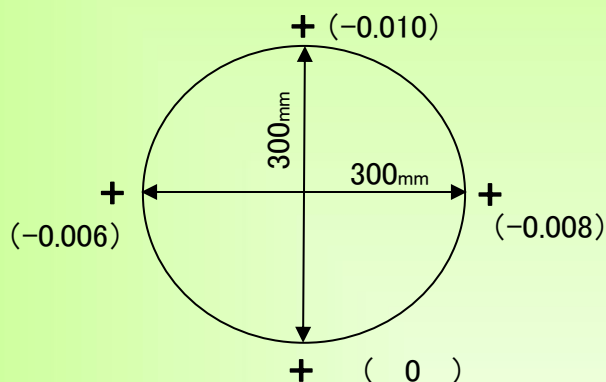

主軸振れ



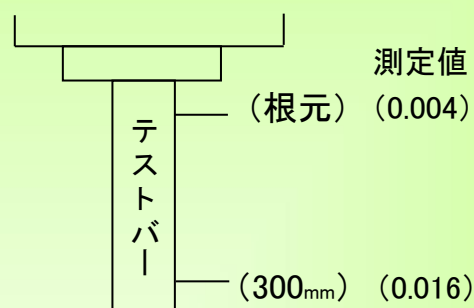


直角度

【YZ】測定値 (0.008)


【XZ】測定値 (0.002)

【X Y】測定値 (0.014)

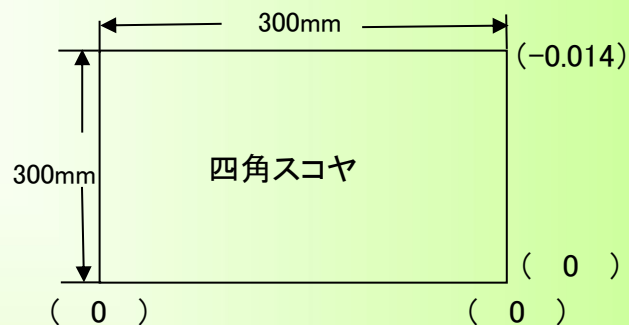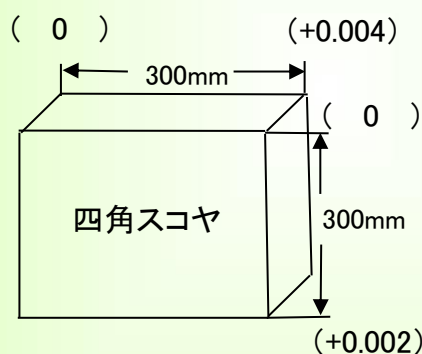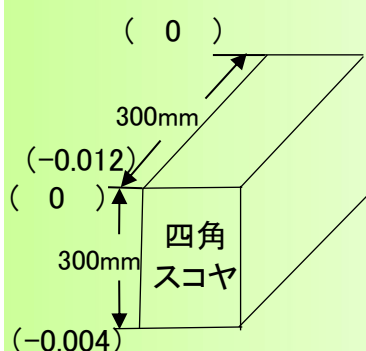

上面精度

※テーブルサイズ 1000×510

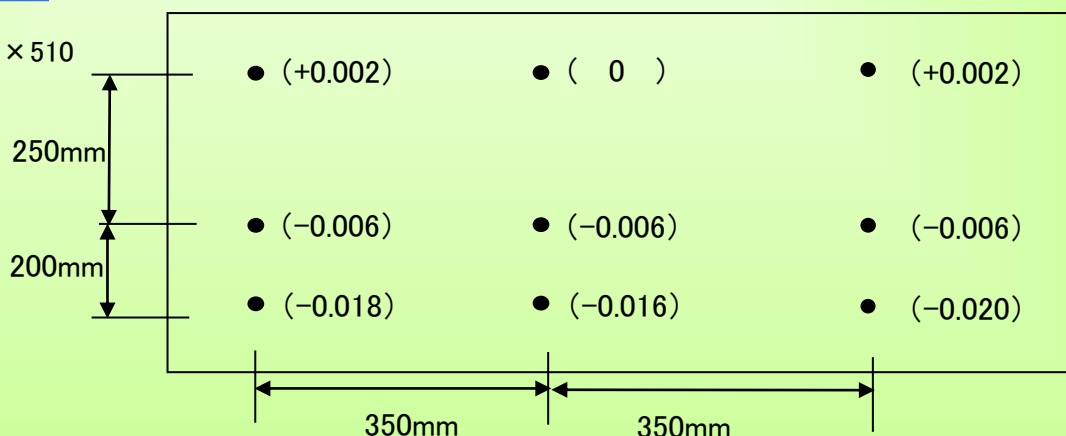

2022/2/17