


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	安田	年式	2005年製	管理番号	P007714
型式	YBM-8120V	測定者	奥澤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

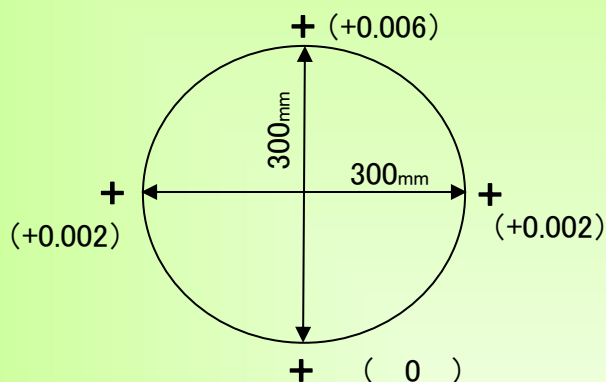

主軸振れ



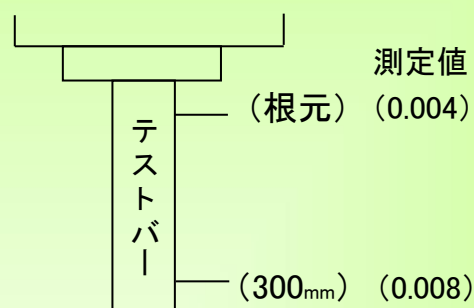


直角度

【YZ】測定値 (0.004)


【XZ】測定値 (0.004)

【X Y】測定値 (0.006)

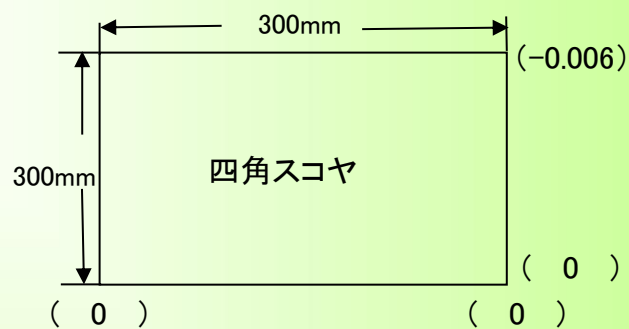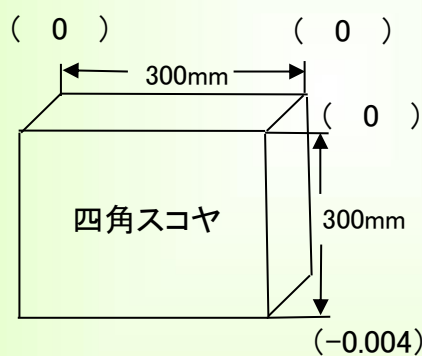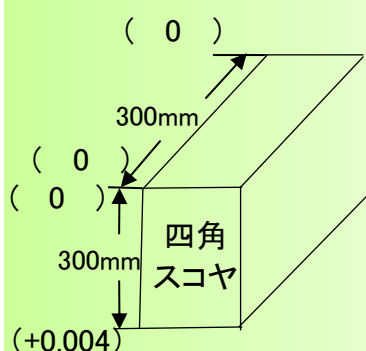

上面精度

※テーブルサイズ 800×1200

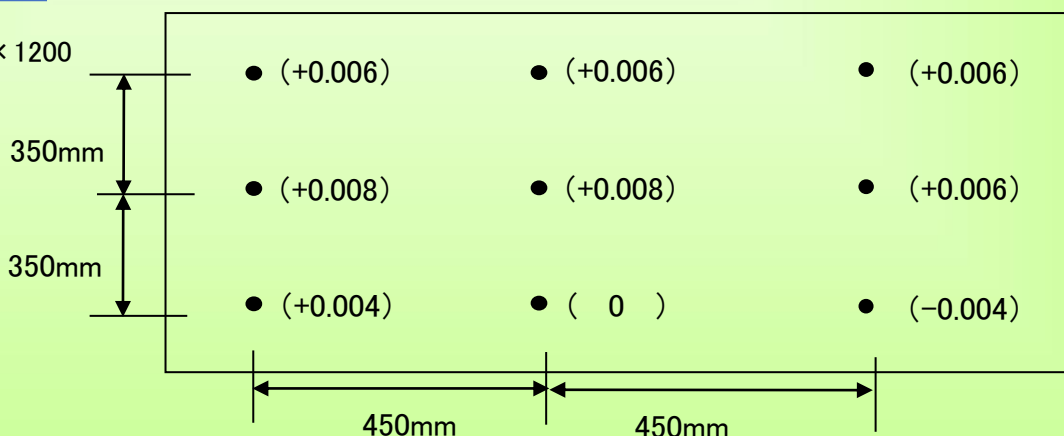

2022/2/22

EAST JAPAN MACHINE PLAZA