


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2001年製	管理番号	H016491
型式	SV-503B/40	測定者	平野	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

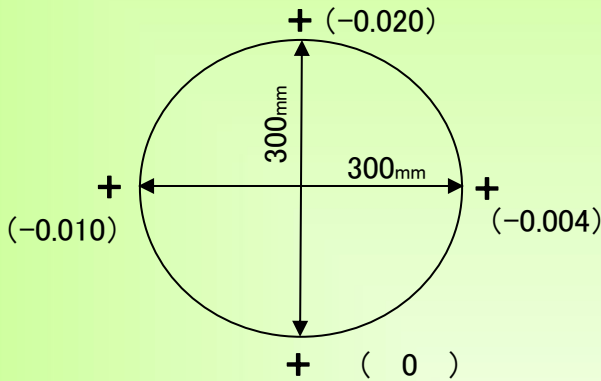

主軸振れ



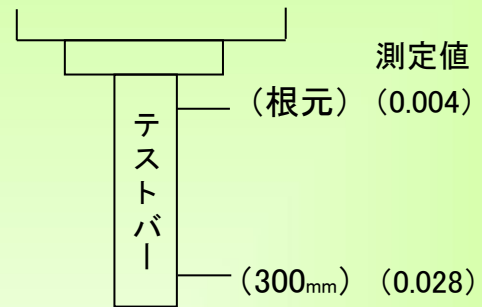


直角度

【YZ】測定値 (0.012)


【XZ】測定値 (0.016)

【XY】測定値 (0.010)

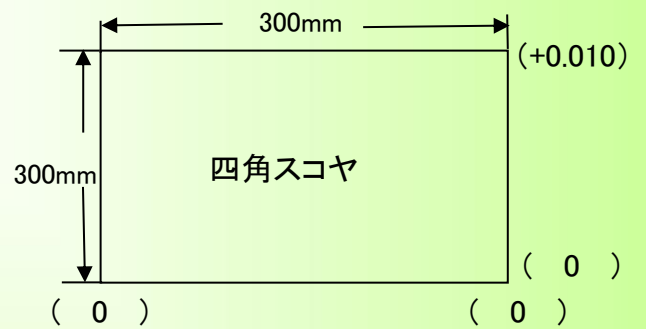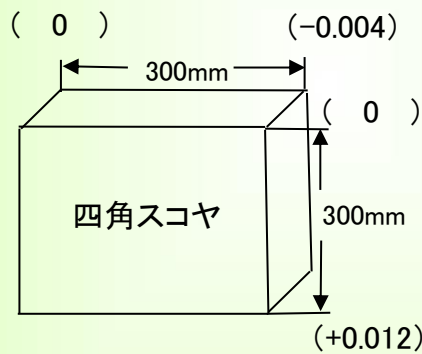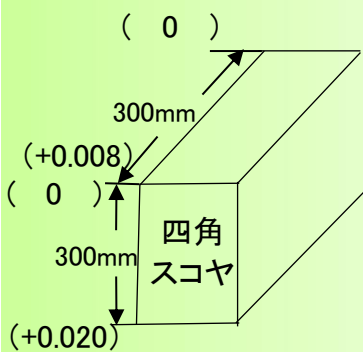

上面精度

※テーブルサイズ 1100×600

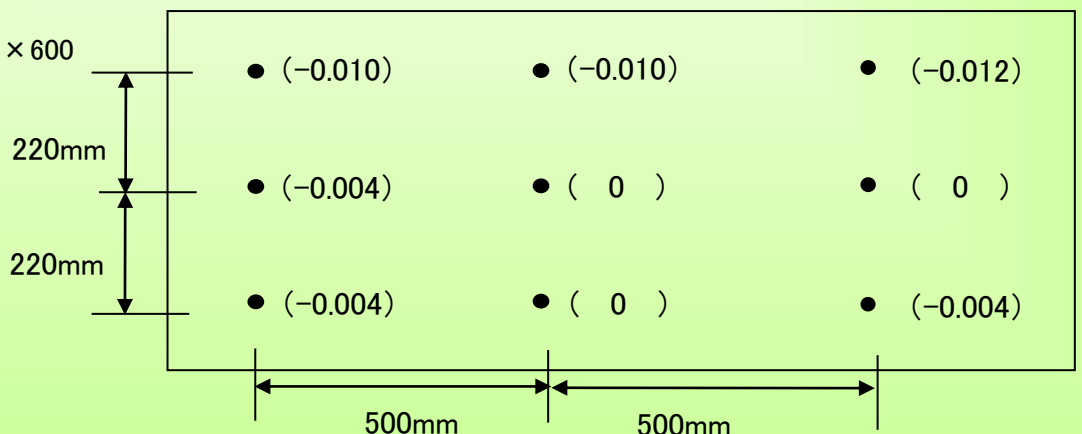

2022/2/21

倉庫内温度8℃