


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	2003年製	管理番号	P007626
型式	MILLAC-468V	測定者	武藤	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

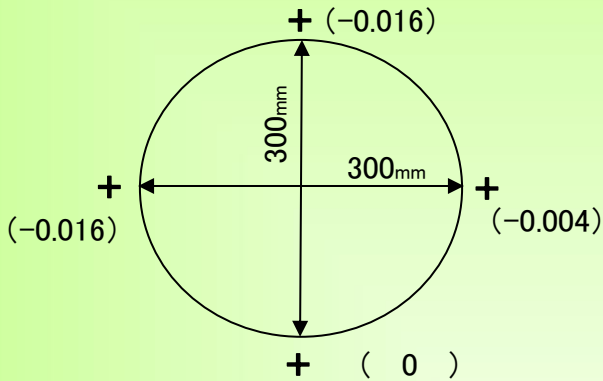

## 主軸振れ



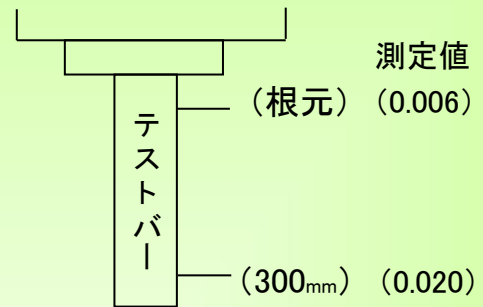


## 直角度

【YZ】測定値 (0.002)


【XZ】測定値 (0.010)

【XY】測定値 (0.004)

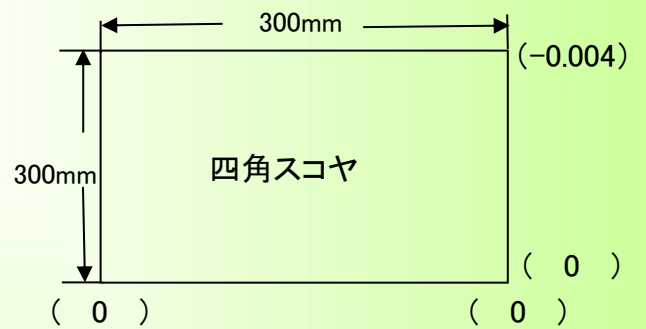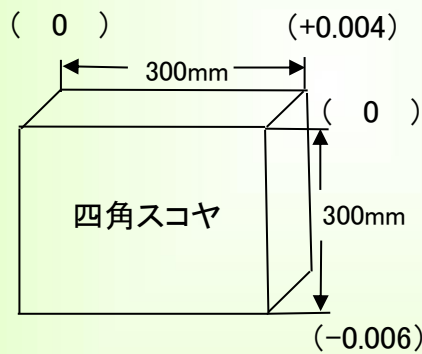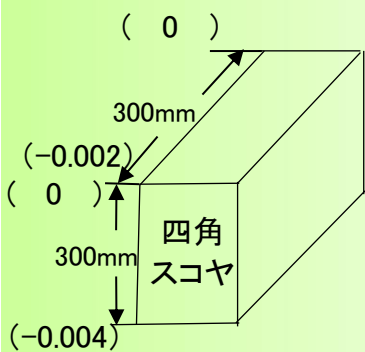

## 上面精度

※テーブルサイズ 1050×460

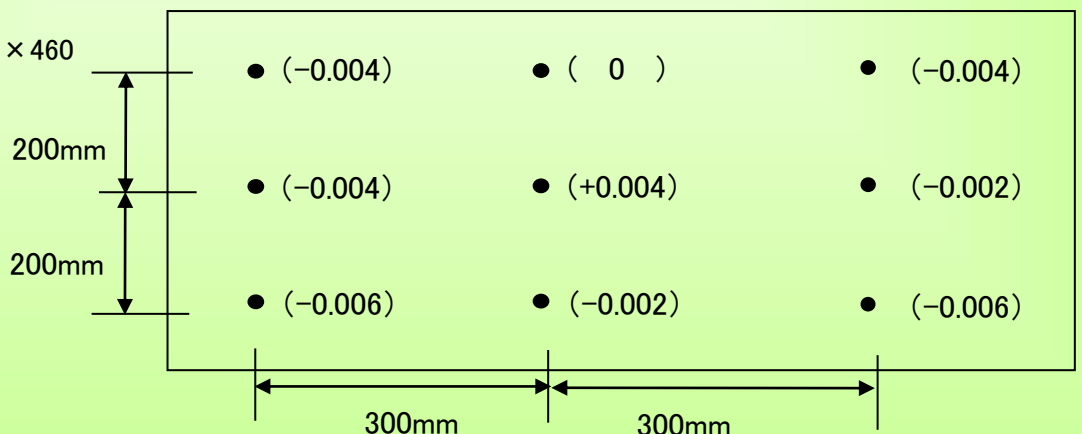

2022/3/1