


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	山崎技研	年式	1983年製	管理番号	H015784
型式	YZB-85	測定者	山口	アシスタント	

Z軸方向の平行度

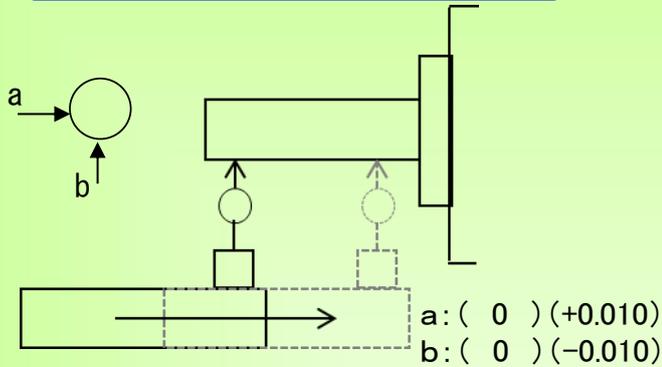

主軸振れ


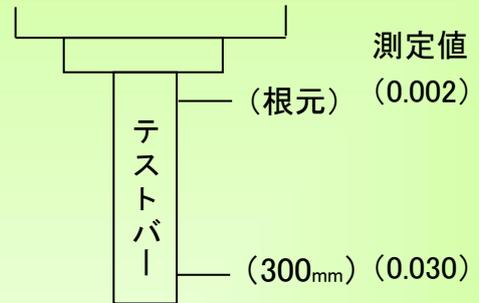


直角度

【XY】測定値 (0.015)


【ZY】測定値 (0.005)

【ZX】測定値 (0.010)

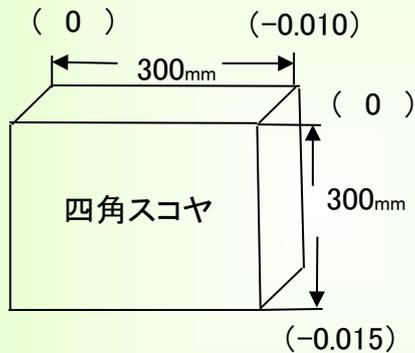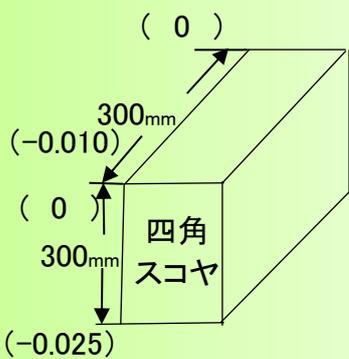

上面精度

テーブルサイズ: 1300 × 600

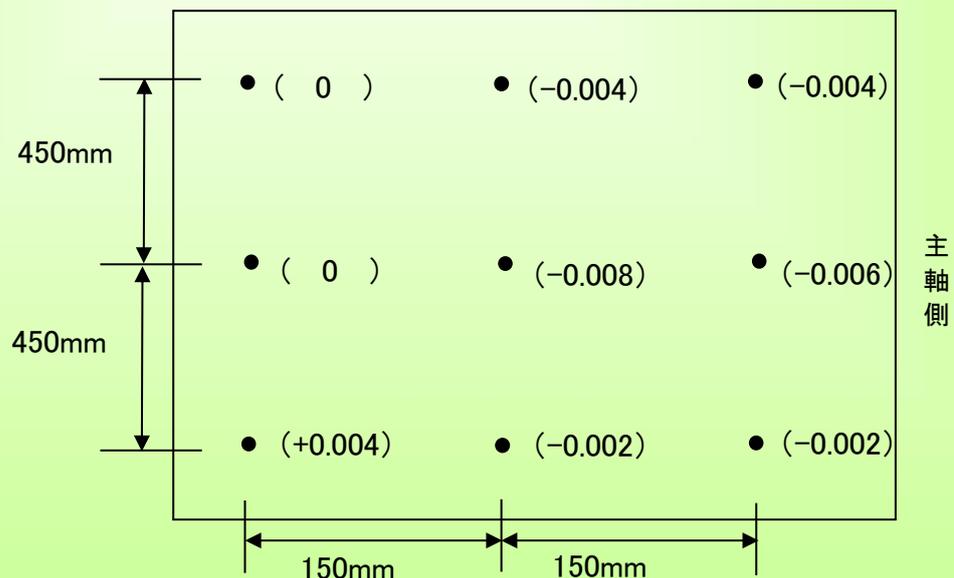

2022/3/15