


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	2014年製	管理番号	P007803
型式	VP400	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

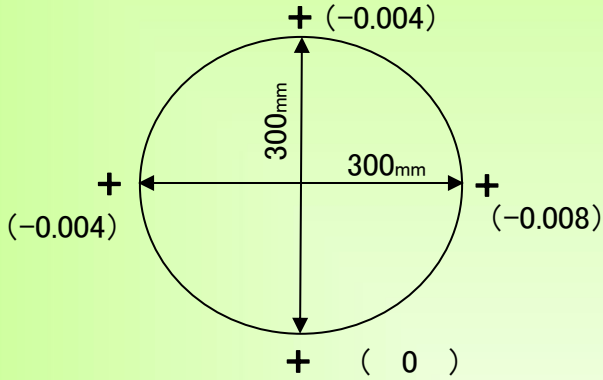

主軸振れ



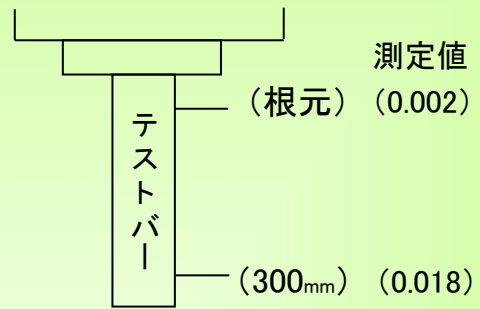


直角度

【YZ】測定値 (0.006)


【XZ】測定値 (0.006)

【XY】測定値 (0.010)

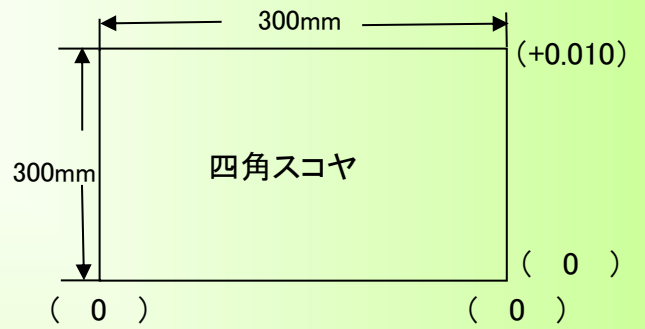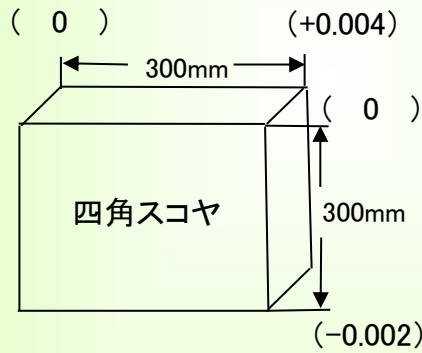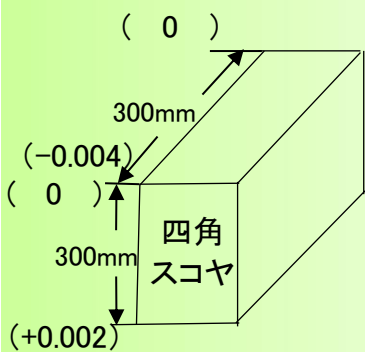

上面精度

※テーブルサイズ 900×410

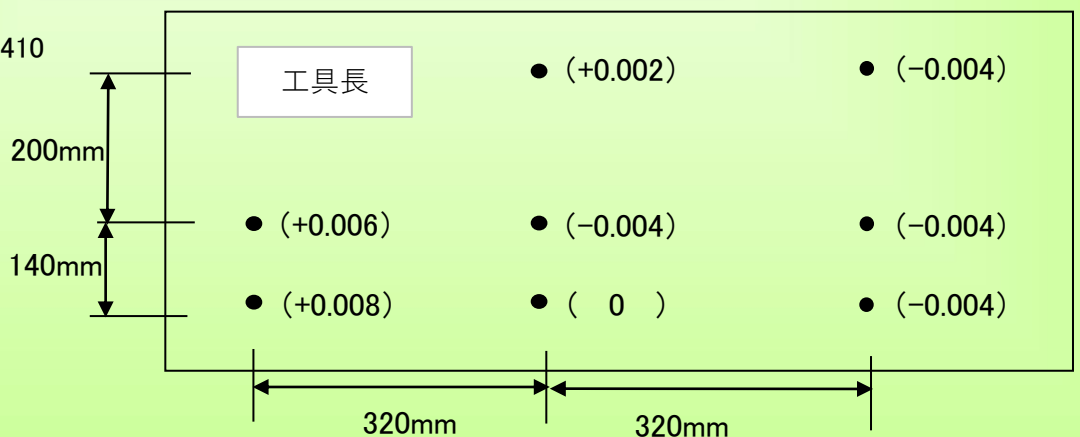

2022/4/13