


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	2004年製	管理番号	P007825
型式	MILLAC-561V	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

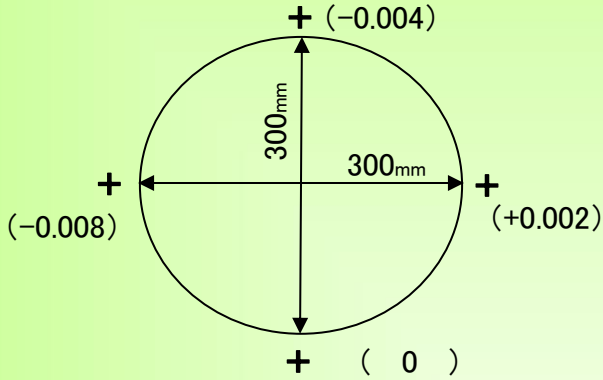

主軸振れ



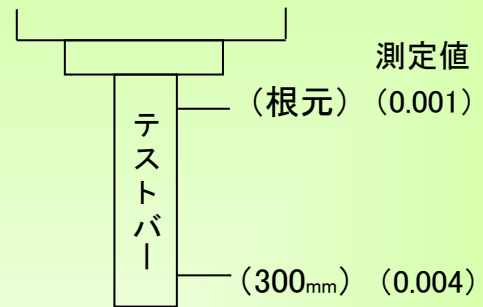


直角度

【YZ】測定値 (0.006)


【XZ】測定値 (0.012)

【XY】測定値 (0.006)

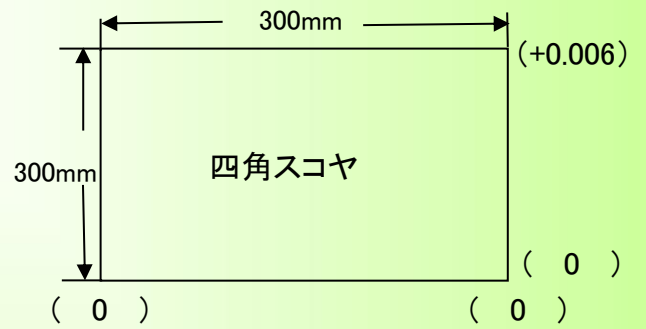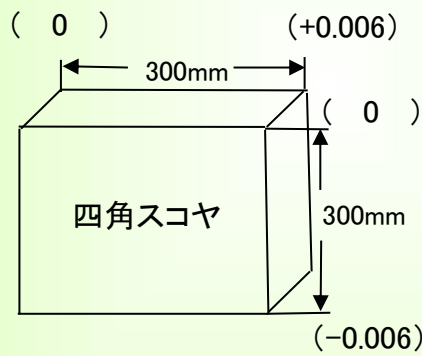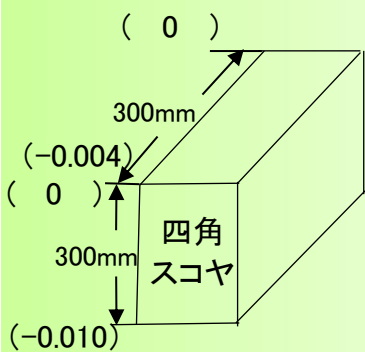

上面精度

※テーブルサイズ 1350×560

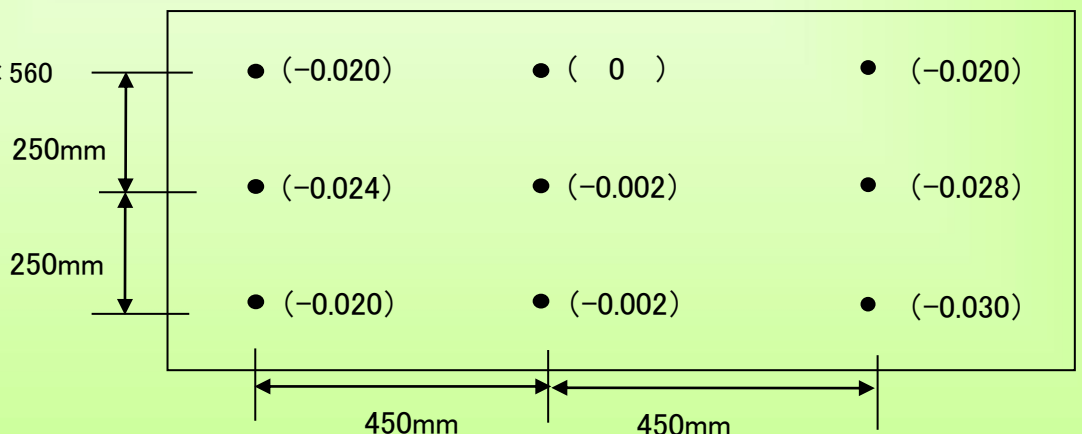

2022/5/13