


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	1997年製	管理番号	P007837
型式	MV-55/50	測定者	奥澤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

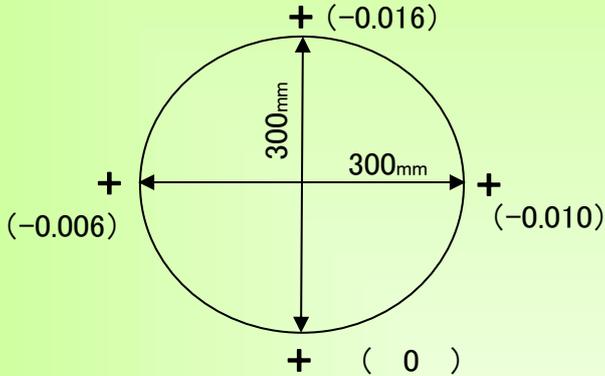

主軸振れ



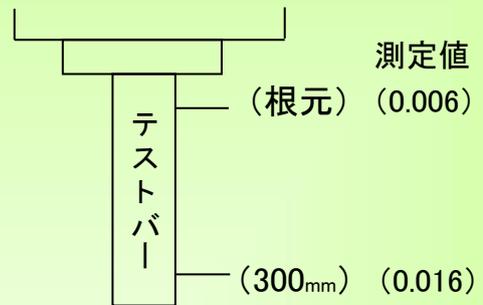


直角度

【YZ】測定値 (0.022)


【XZ】測定値 (0.008)

【XY】測定値 (0.014)

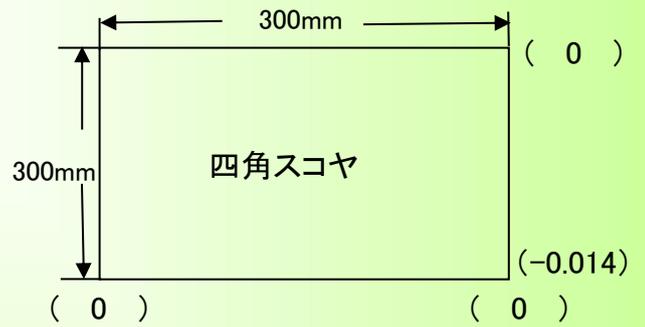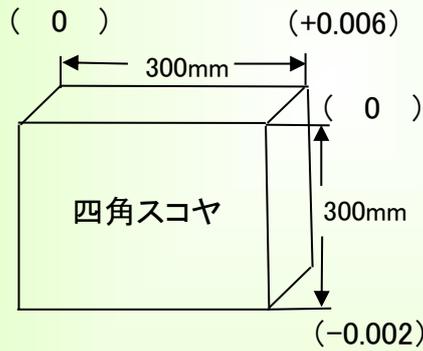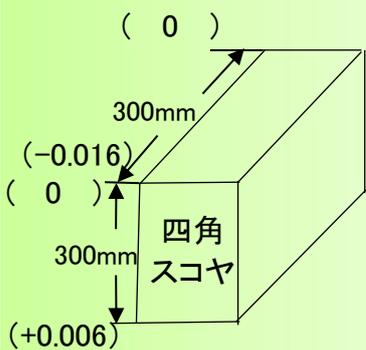

上面精度

※テーブルサイズ 700×400

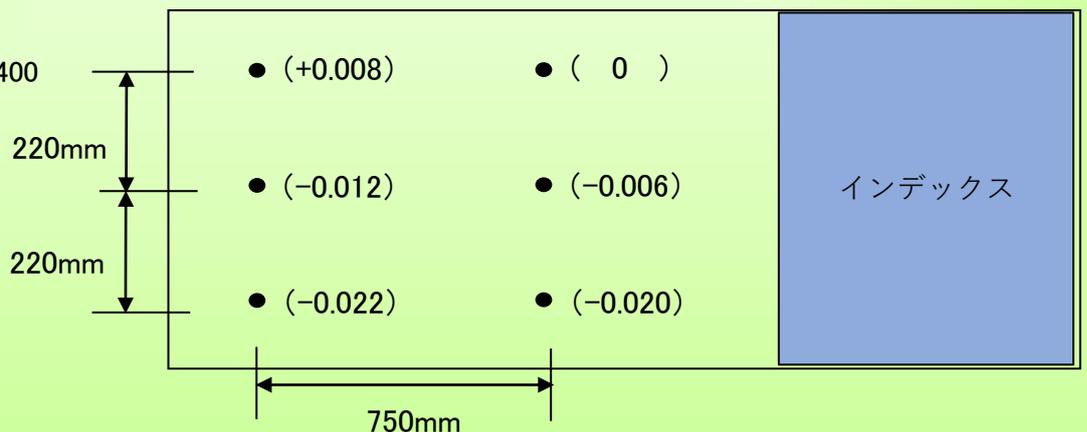

2022/5/24