


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	牧野フライス製作所	年式	2014年製	管理番号	H016737
型式	D500	測定者	平野	アシスタント	仙田

振り回し(300ピッチ)

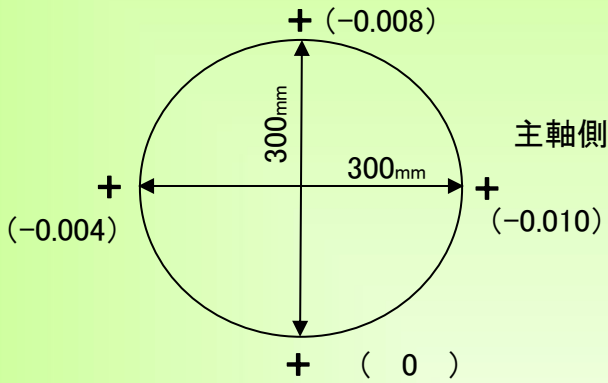

主軸振れ



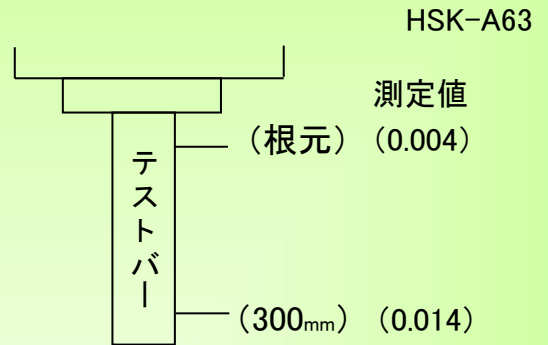


直角度


【YZ】測定値 (0.010)

【XZ】測定値 (0.010)

【XY】測定値 (0.008)

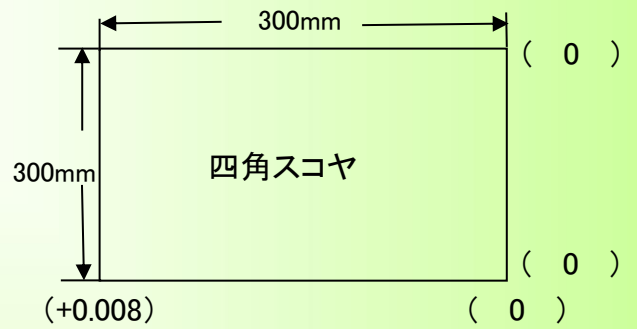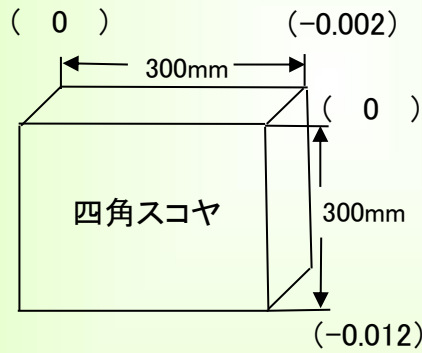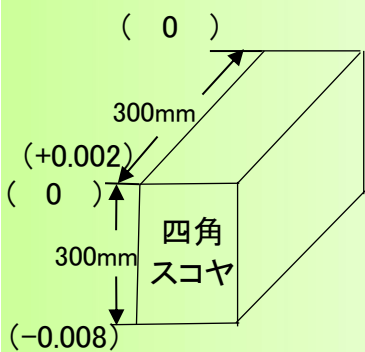

上面精度

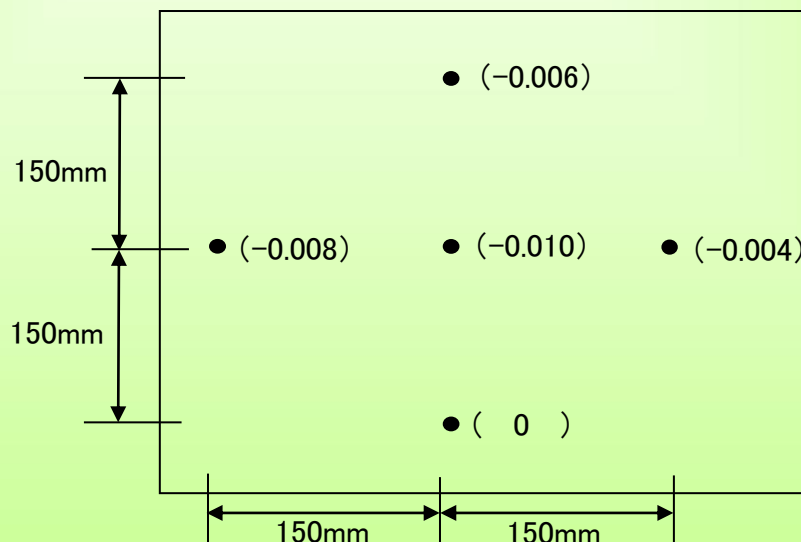

2022/6/8