


精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	豊田	年式	1989年製	バーコード	P007790
型式	GUP32×100	測定者	小林将	アシスタント	


主軸とz軸の平行度

2022/6/9

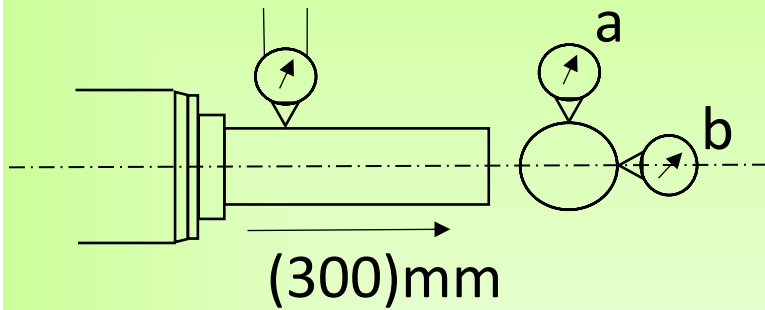


a:0 → (+0.020)
b:0 → (+0.004)

心押しとz軸の平行度

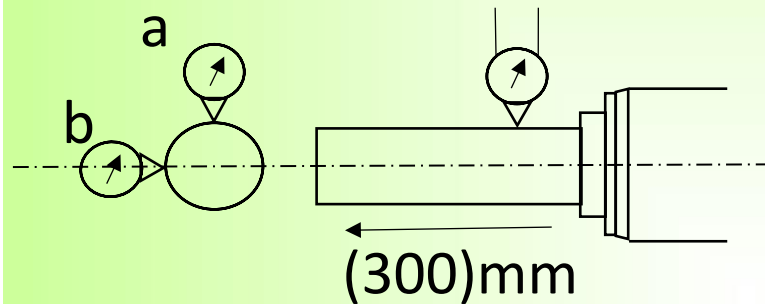


a:0 → (+0.006)
b:0 → (+0.008)

主軸と心押し間のz軸の平行度

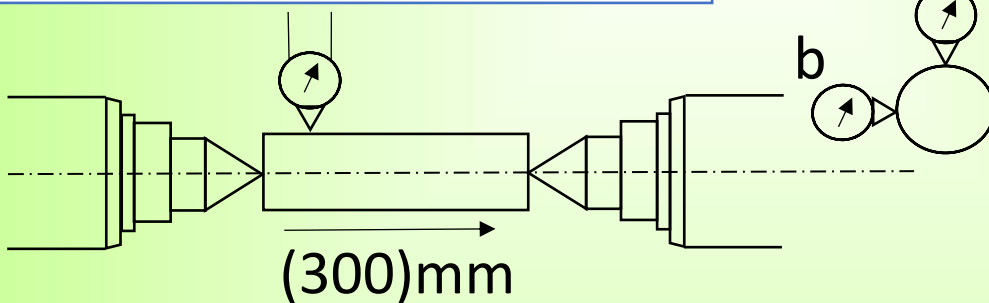

a:0 → (+0.002)
b:0 → (-0.002)

テスト加工

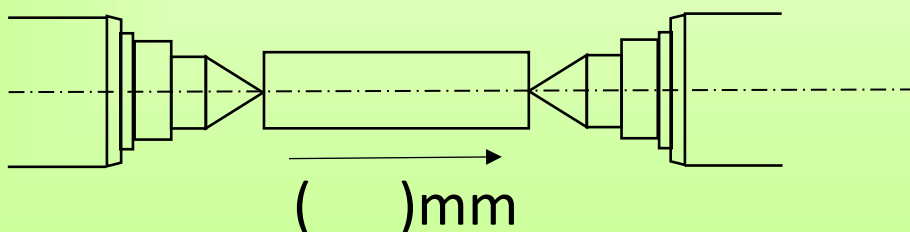

300mm

0 → (+0.002)

450mm

0 → (+0.003)