精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2003年製	管理番号	P007676
型式	NH4000/40	測定者	奥澤	アシスタント	

Z軸方向の平行度

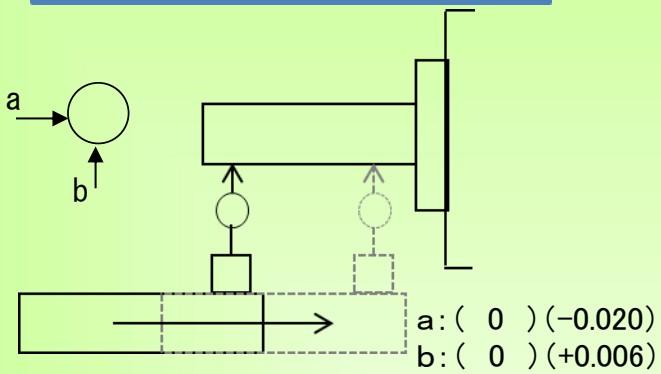

主軸振れ

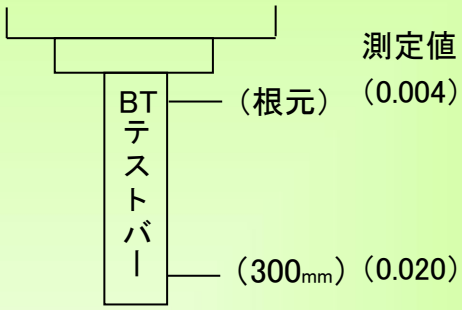

直角度

【ZY】測定値 (0.010)

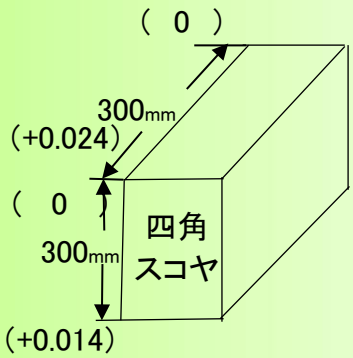

【XY】測定値 (0.020)

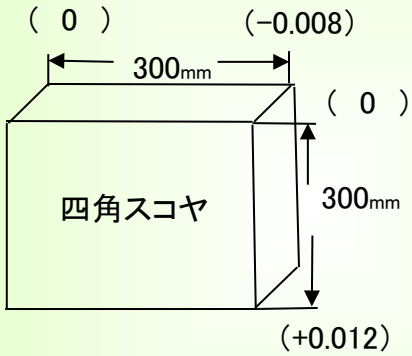

【ZX】測定値 (0.010)

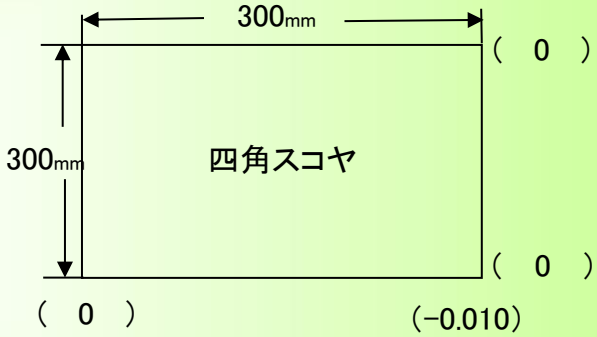

上面精度

テーブルサイズ 400:角

( )パレット1
[ ]パレット2

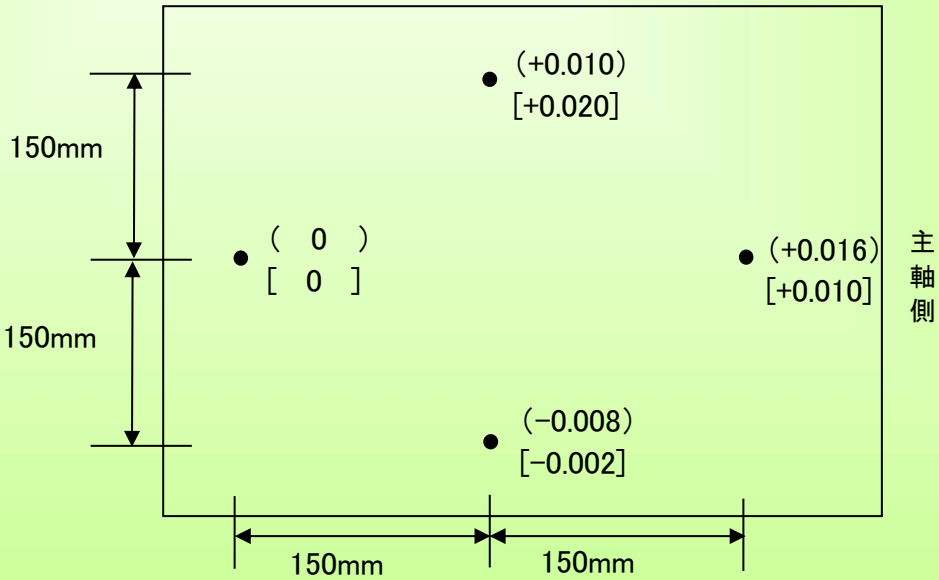

2022/6/9