


# 精度測定検査表


Examination for precision list

|      |                  |     |        |        |         |
|------|------------------|-----|--------|--------|---------|
| メーカー | ファナック            | 年式  | 2004年製 | 管理番号   | P007882 |
| 型式   | $\alpha$ -T21iDL | 測定者 | 武藤     | アシスタント |         |

## 振り回し(300ピッチ)

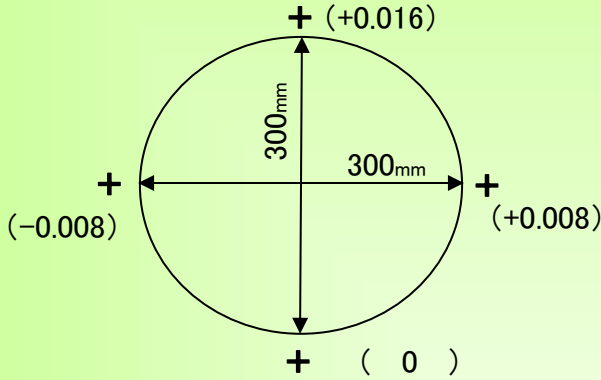

## 主軸振れ



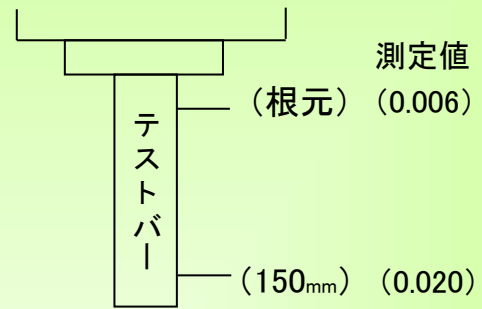


## 直角度

【YZ】測定値 (0.002)


【XZ】測定値 (0.016)

【XY】測定値 (0.010)

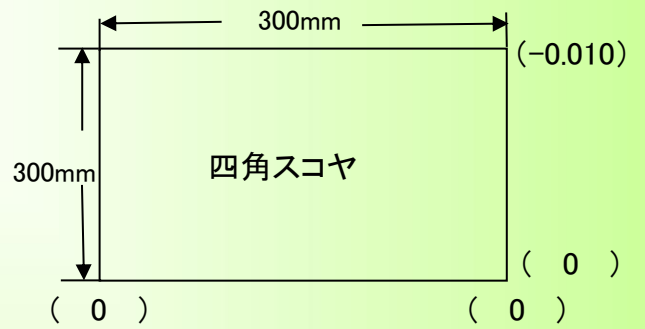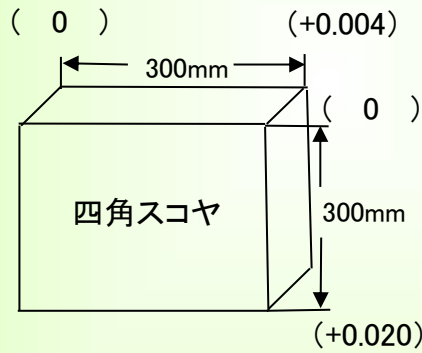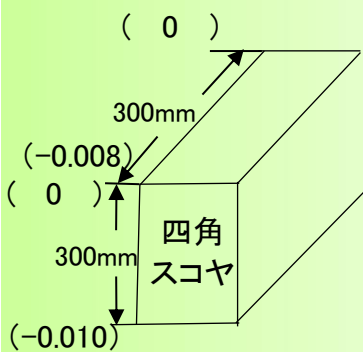

## 上面精度

※テーブルサイズ 850×410

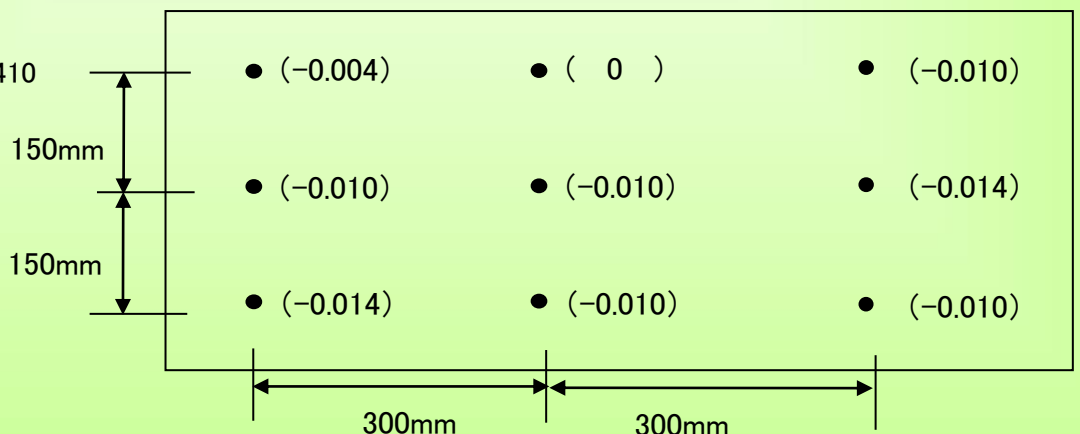

2022/5/26