


精度測定検査表


Examination for precision list

| | | | | | |
|------|--------|-----|--------|--------|---------|
| メーカー | KIRA | 年式 | 2001年製 | 管理番号 | P007793 |
| 型式 | VTC40A | 測定者 | 金子 | アシスタント | |

振り回し(300ピッチ)

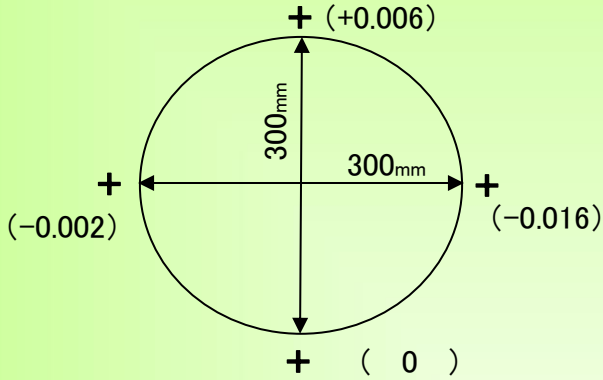

主軸振れ



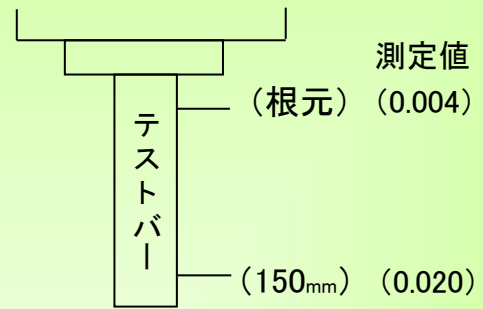


直角度

【YZ】測定値 (0.004)


【XZ】測定値 (0.012)

【XY】測定値 (0.024)

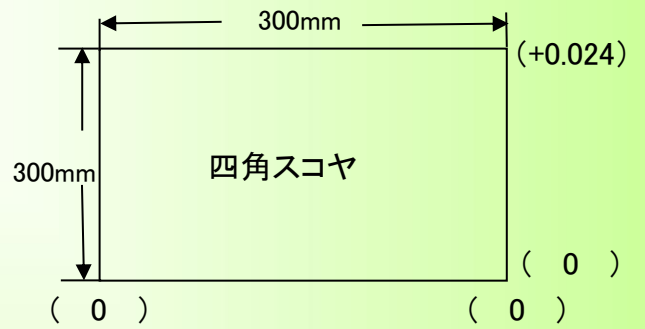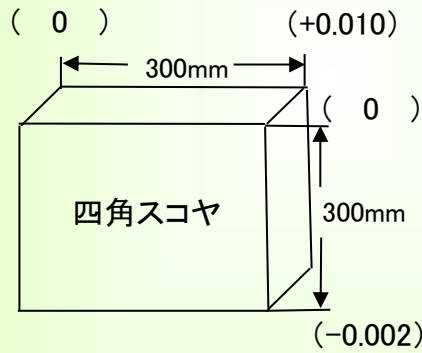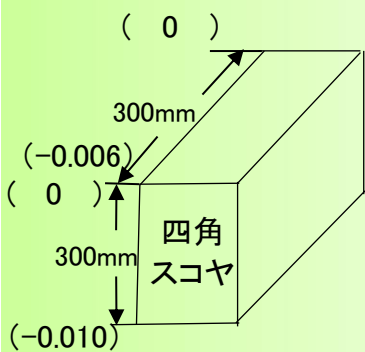

上面精度

※テーブルサイズ 700×400

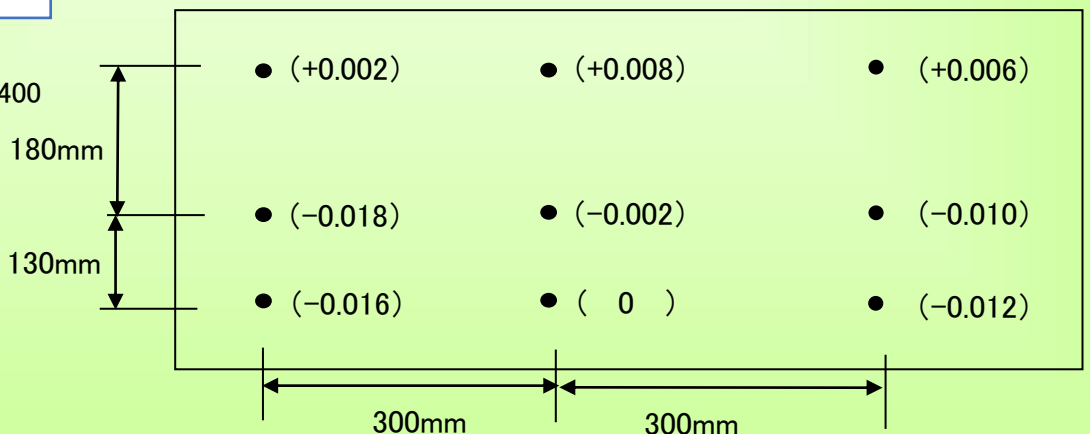

2022/6/16