


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ブラザー	年式	2001年製	管理番号	P007921
型式	TC-22A	測定者	奥澤	アシスタント	

振り回し(250ピッチ)

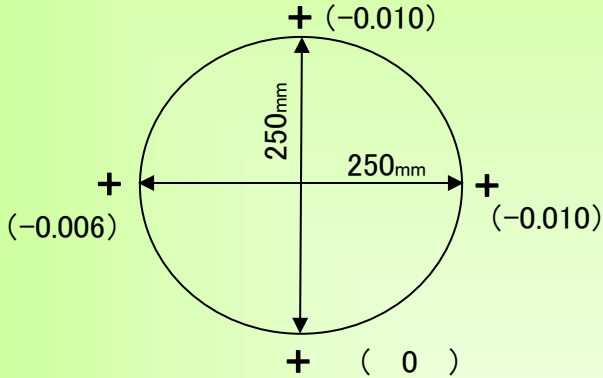

主軸振れ



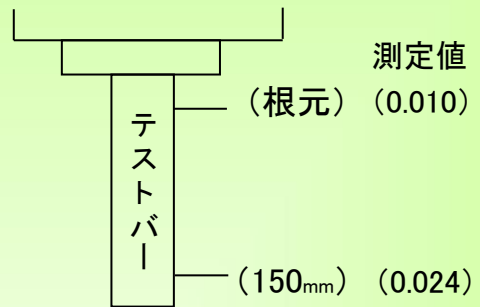


直角度

【YZ】測定値 (0.010)


【XZ】測定値 (0.020)

【XY】測定値 (0.020)

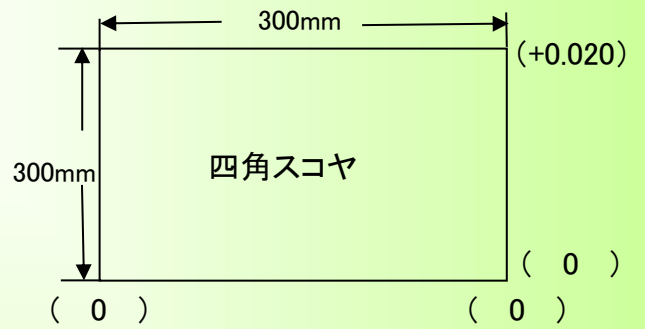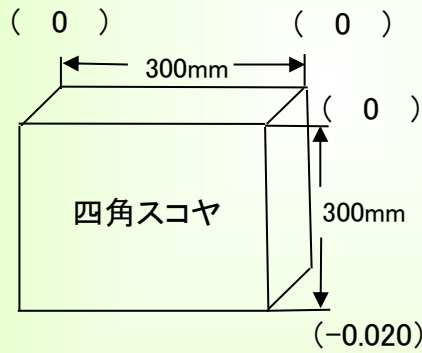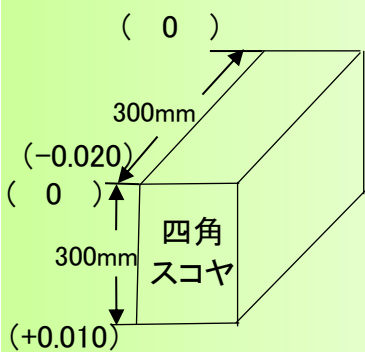

上面精度

※テーブルサイズ 700×400

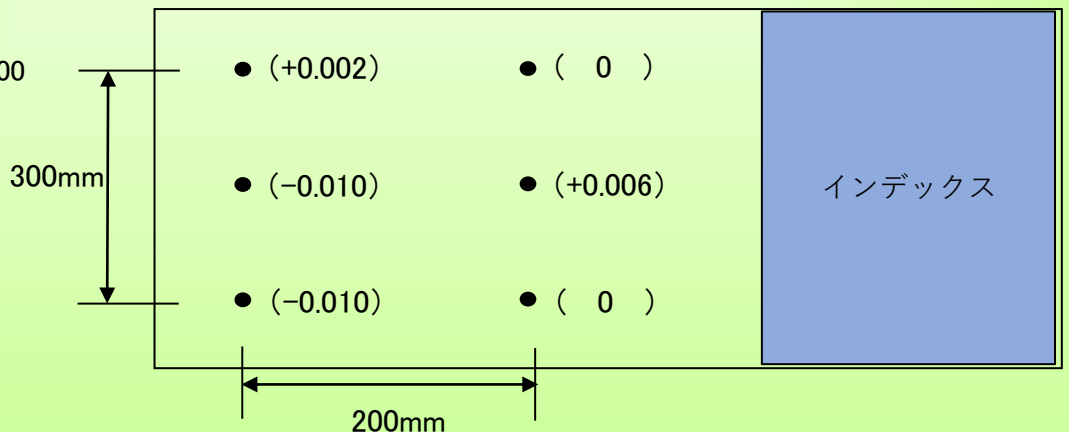

2022/6/18