


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	北村	年式	2002年製	管理番号	P007943
型式	Mycenter-0i	測定者	奥澤	アシスタント	

## 振り回し(250ピッチ)

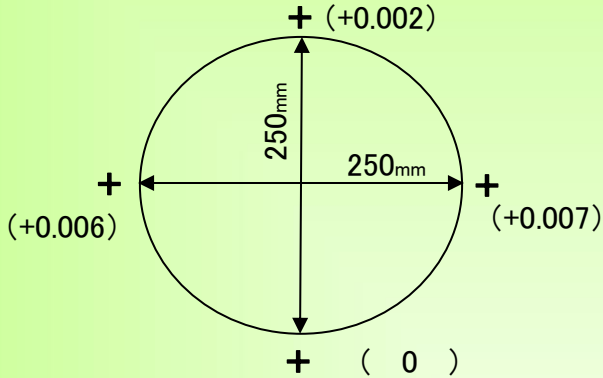

## 主軸振れ



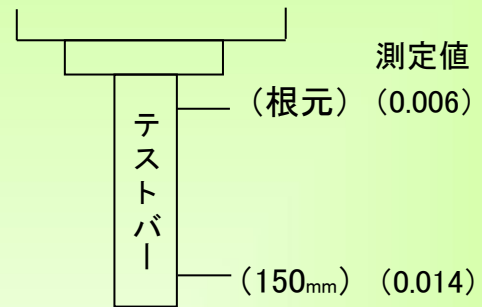


## 直角度

【YZ】測定値 (0.024)


【XZ】測定値 (0.020)

【XY】測定値 (0.002)

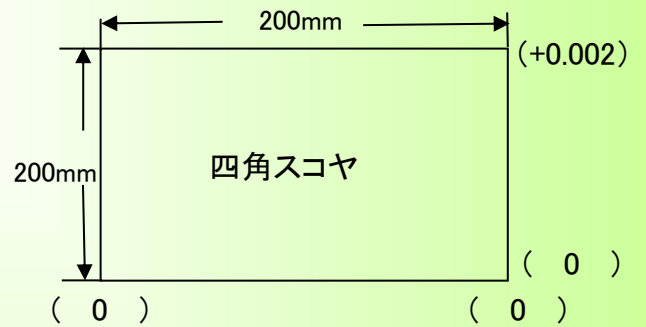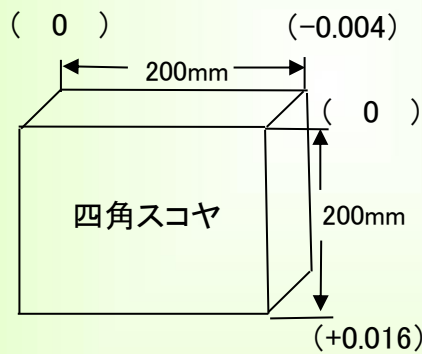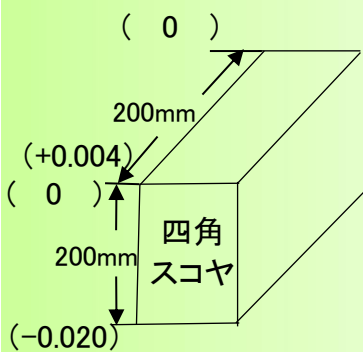

## 上面精度

※テーブルサイズ 610×310

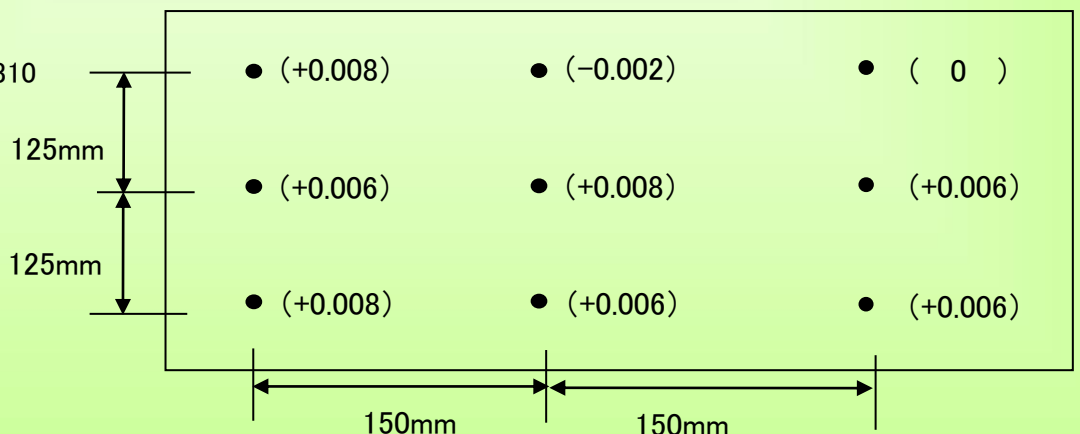

2022/7/5