


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	2015年製	管理番号	H016946
型式	VM940R	測定者	仙田	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

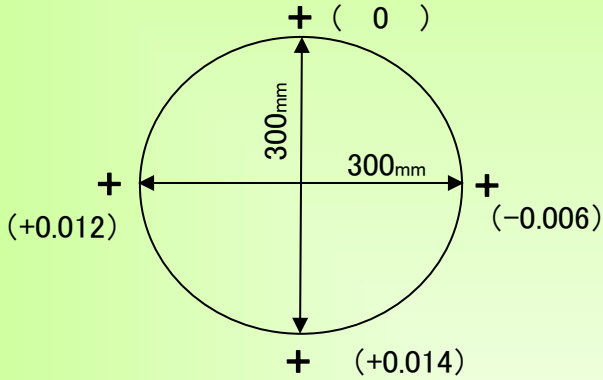

## 主軸振れ



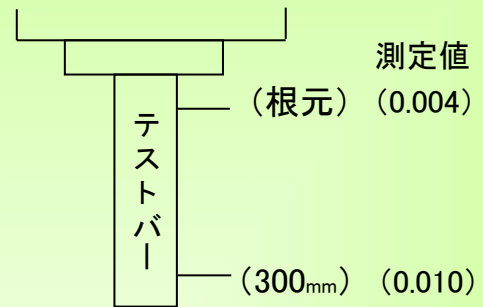


## 直角度

【YZ】測定値 (0.008)


【XZ】測定値 (0.010)

【XY】測定値 (0.008)

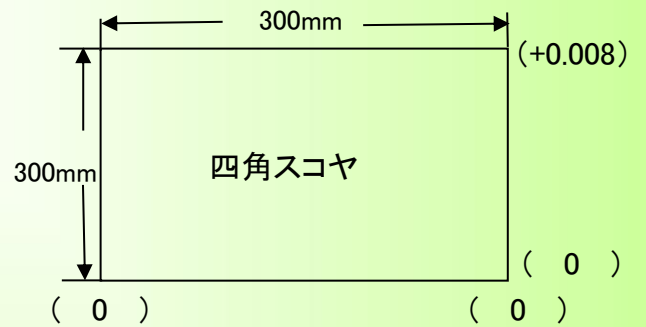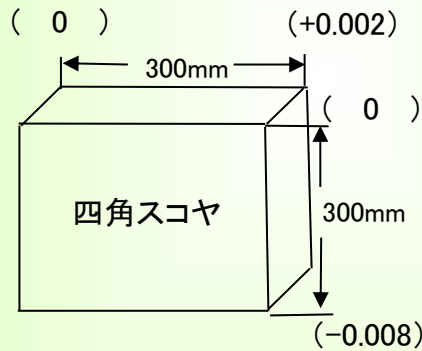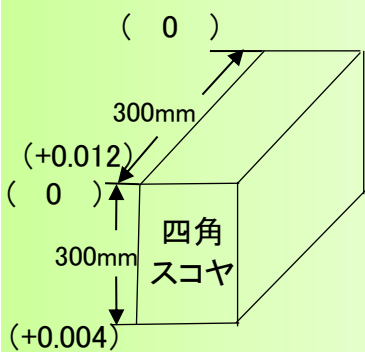

## 上面精度

※テーブルサイズ 2300×940

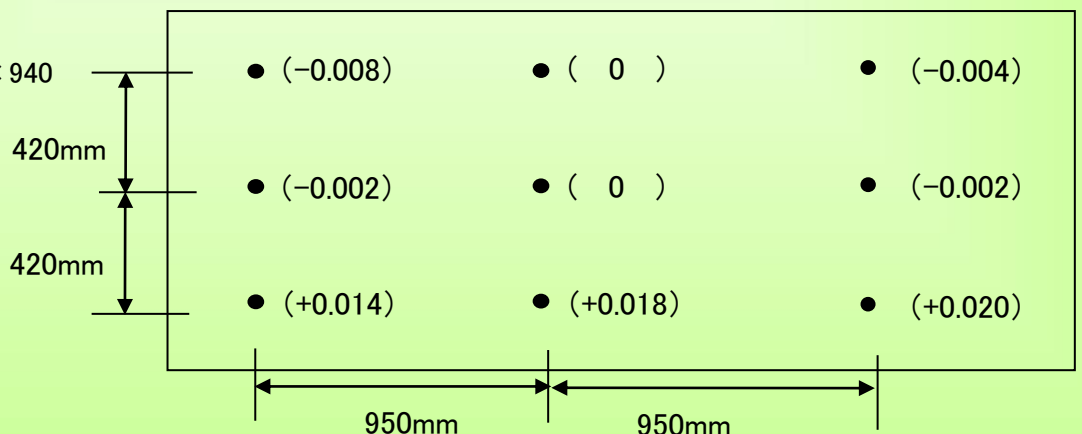

2022/7/11