


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2003年製	管理番号	P007952
型式	MB-56VA	測定者	奥澤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

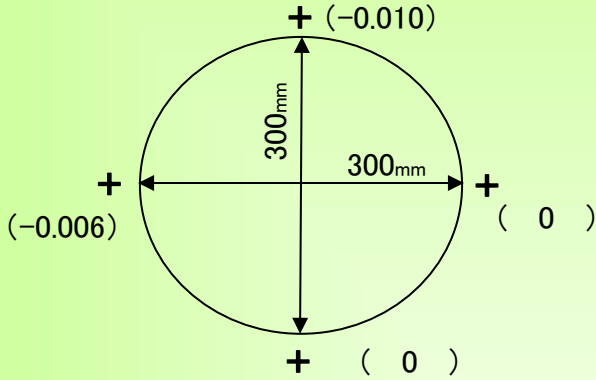

主軸振れ



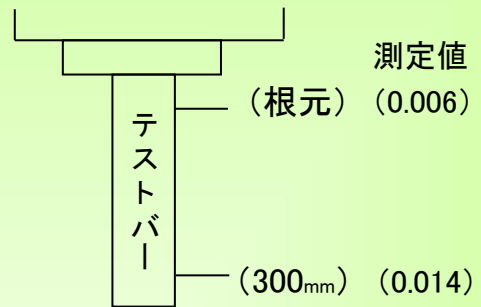


直角度

【YZ】測定値 (0.010)


【XZ】測定値 (0.006)

【XY】測定値 (0.004)

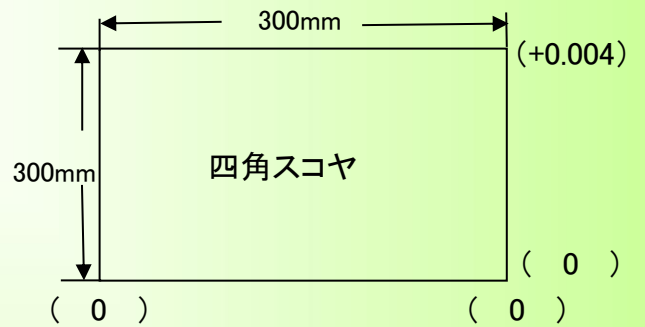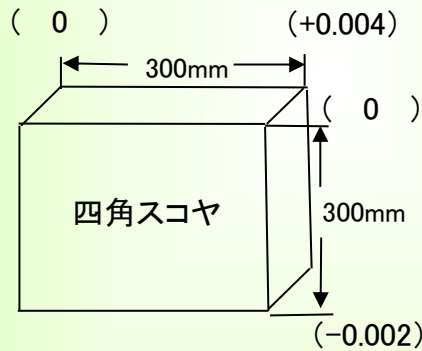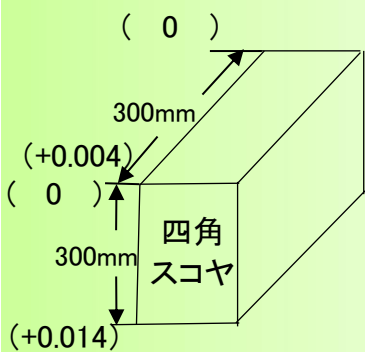

上面精度

※テーブルサイズ 1300×560

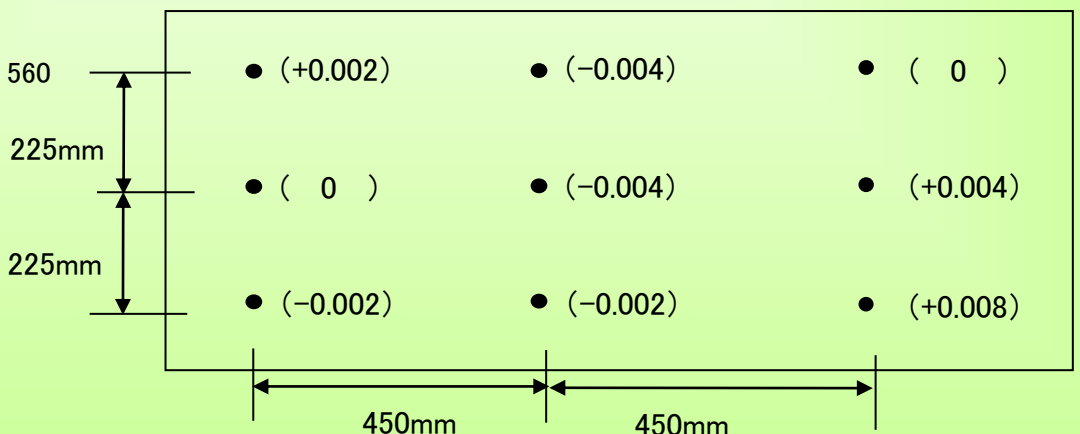

2022/7/19