


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2003年製	管理番号	P007946
型式	$\alpha$ -T14iDL	測定者	奥澤	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

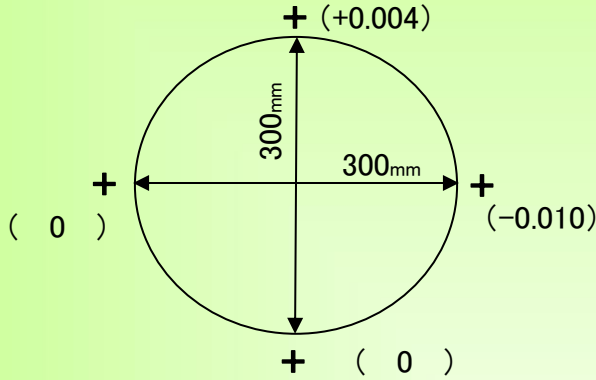

## 主軸振れ



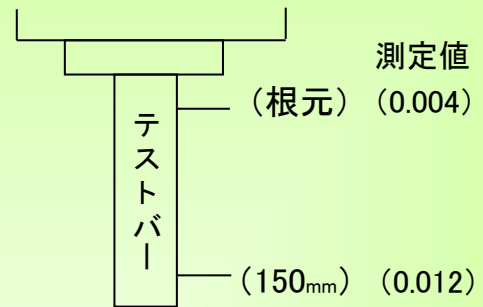


## 直角度

【YZ】測定値 (0.008)


【XZ】測定値 (0.020)

【XY】測定値 (0.010)

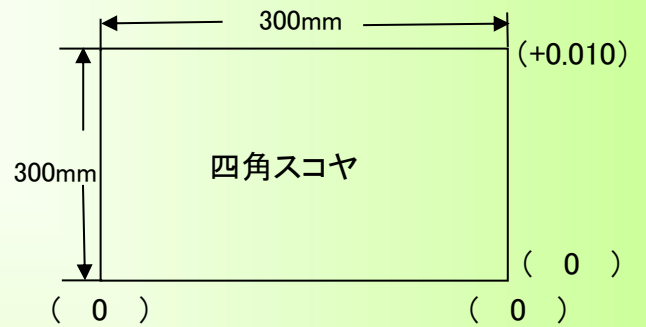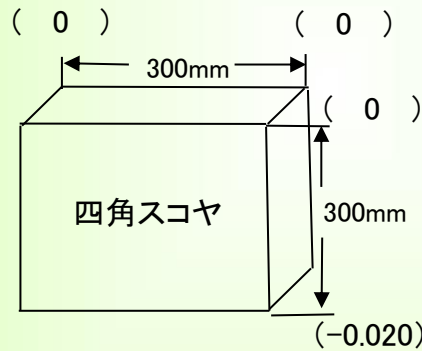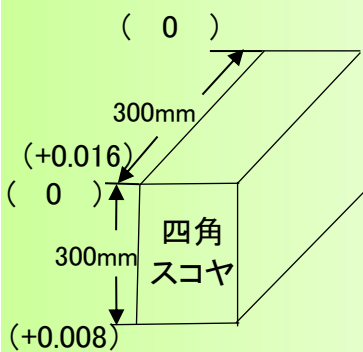

## 上面精度

※テーブルサイズ 850×410

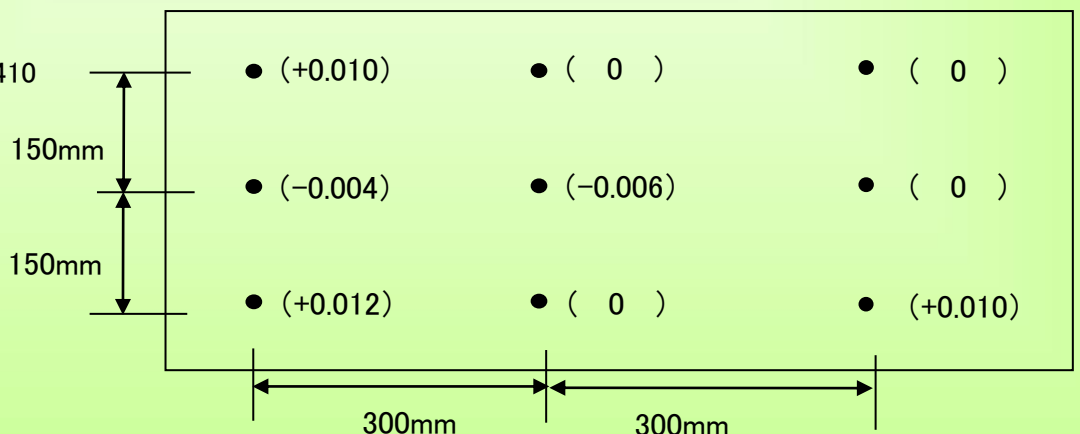

2022/7/23