

精度測定検査表



Examination for precision list

メーカー	オークマ	管理番号	H017048		
型式	LB-250T	年式	2003年製	測定者	平野

主軸振れ

刃物台精度

2022/8/1
室温36°C

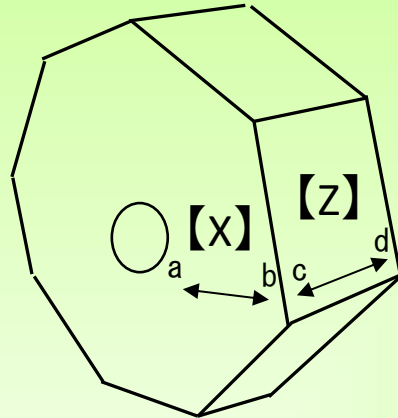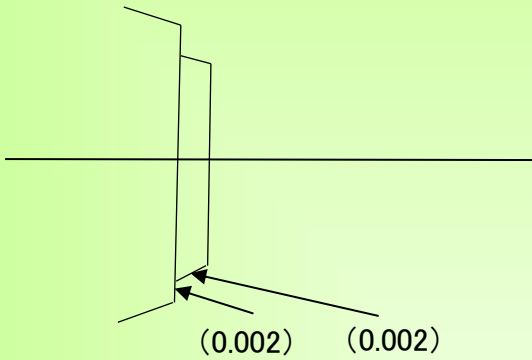

X軸(移動量70mm)
(a 0 → b +0.010)

Z軸(移動量70mm)
(c 0 → d -0.010)

主軸と刃物台の穴中心精度

【バックラッシュ】

X:0.002


Z:0.004

【パラメーター補正】

システムパラメーター

X:0.014

Z:0.065

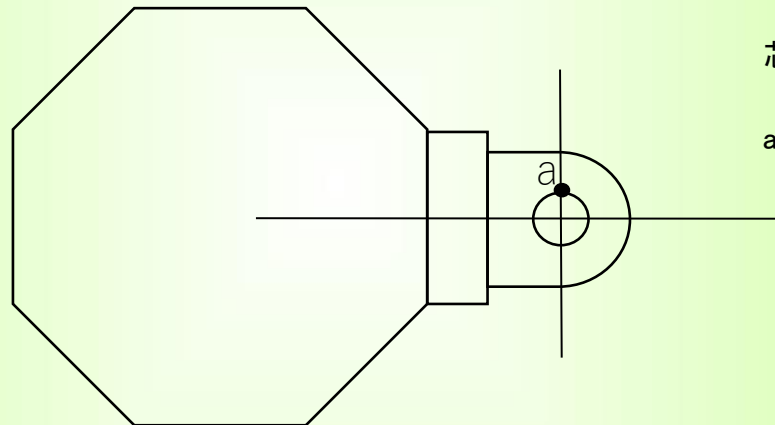

芯ズレ量

a +0.030

テスト加工

