


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	1997年製	管理番号	H017070
型式	FMR-30	測定者	仙田	アシスタント	

振り回し(200ピッチ)

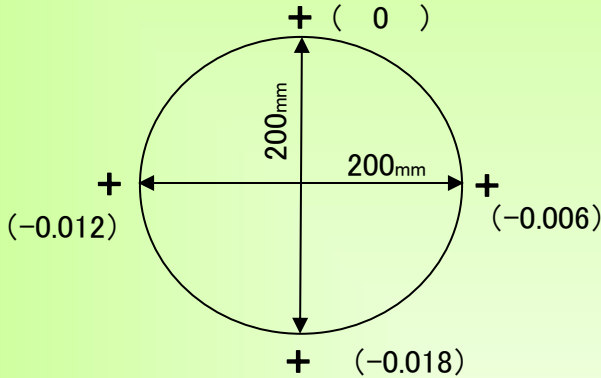

主軸振れ



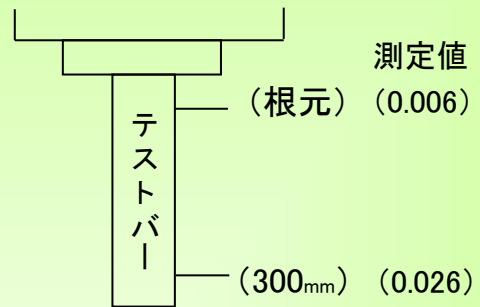


直角度

【YZ】測定値 (0.012)


【XZ】測定値 (0.004)

【XY】測定値 (0.010)

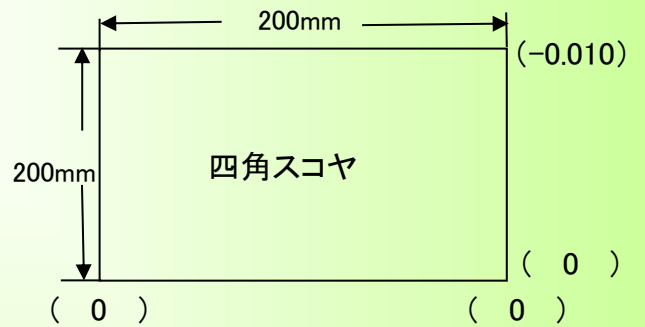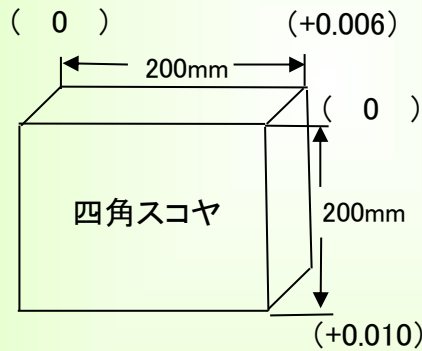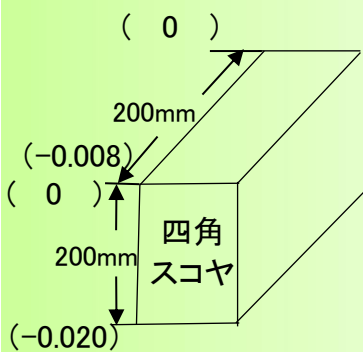

上面精度

※テーブルサイズ 1400×350

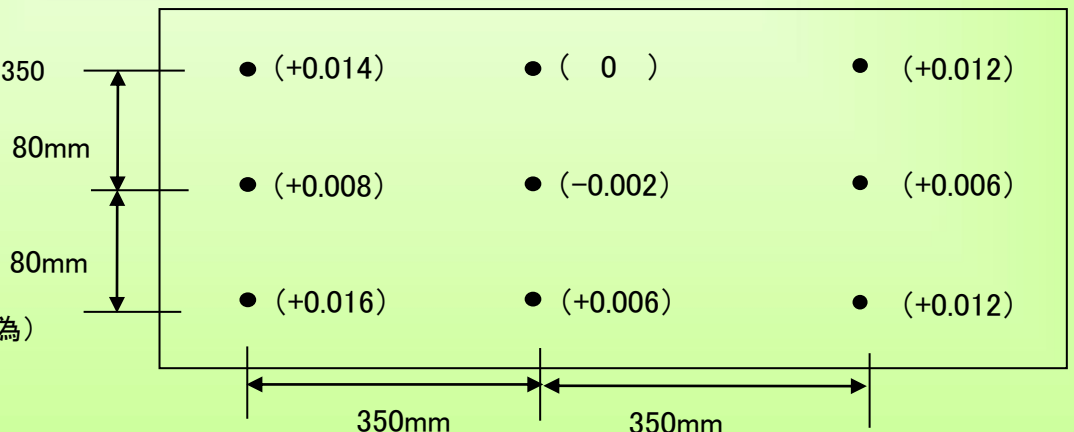

※振り回し直角200で計測
(テーブル奥行き200しかない為)

2022/8/5