


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	1998年製	管理番号	P007989
型式	α -T14iA	測定者	奥澤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

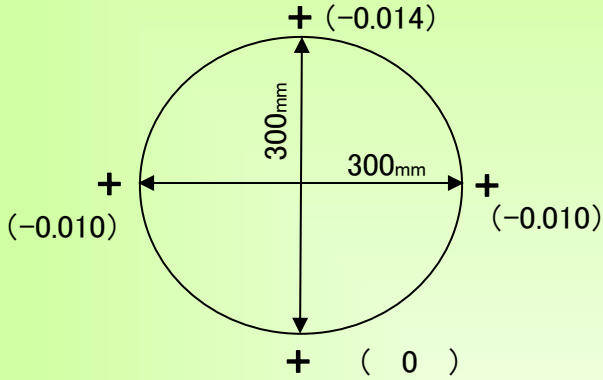

主軸振れ



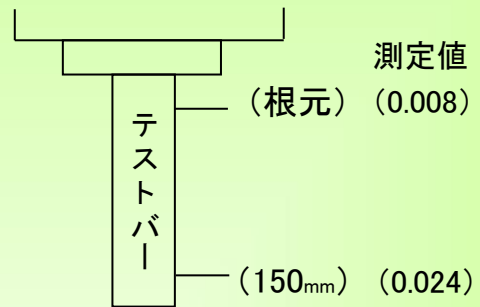


直角度

【YZ】測定値 (0.004)


【XZ】測定値 (0.012)

【XY】測定値 (0.006)

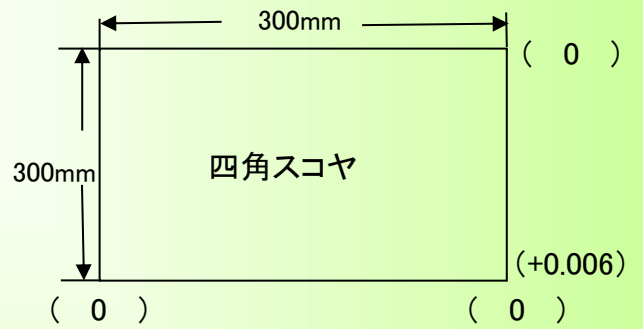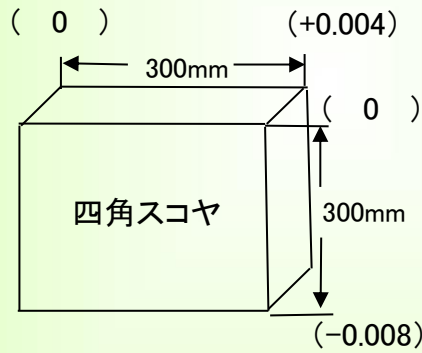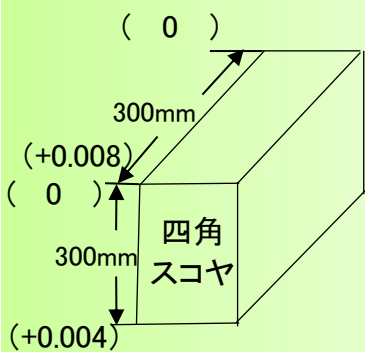

上面精度

※テーブルサイズ 650×380

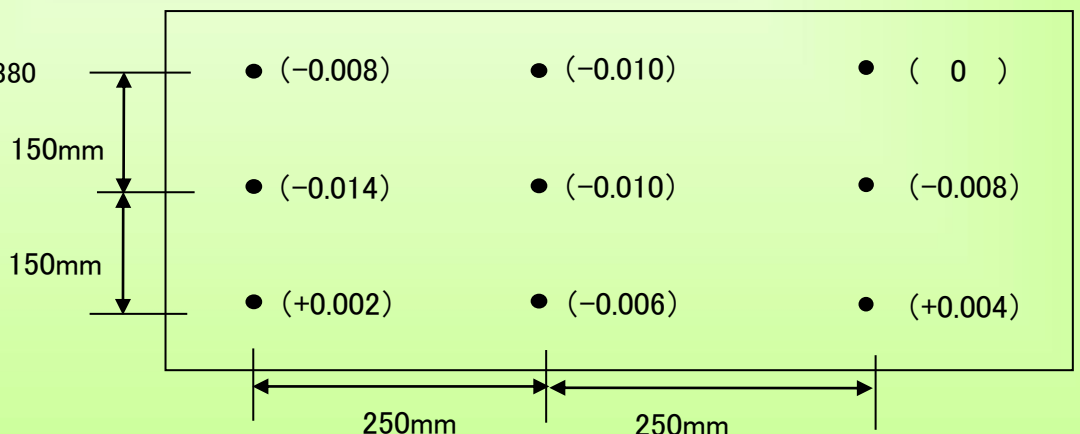

2022/8/24