


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2003年製	管理番号	P007945
型式	α -T14iDL	測定者	武藤・柴田	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

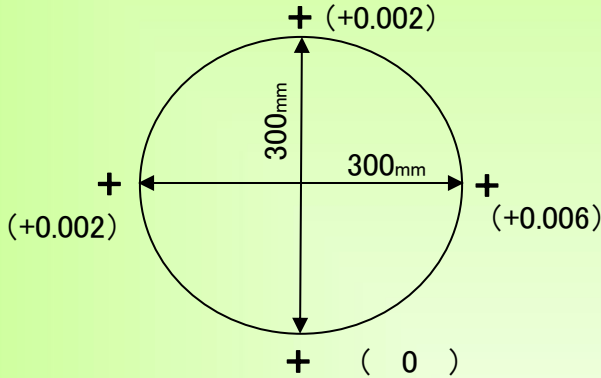

主軸振れ



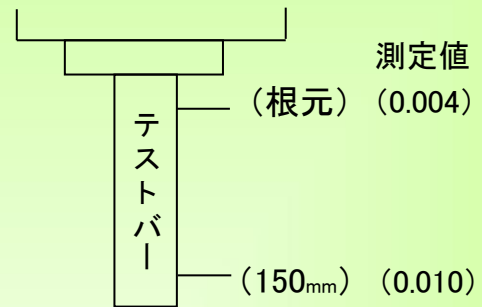


直角度

【YZ】測定値 (0.010)


【XZ】測定値 (0.014)

【XY】測定値 (0.004)

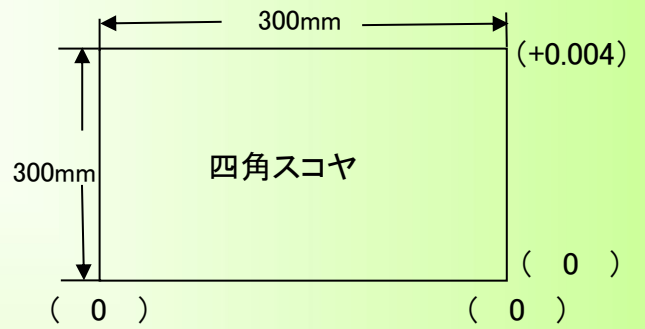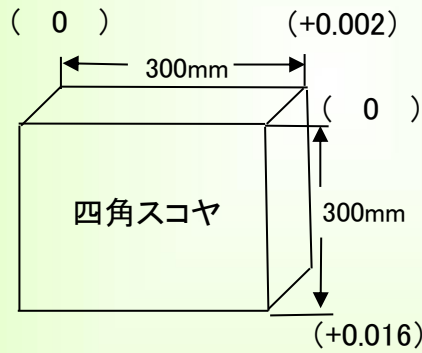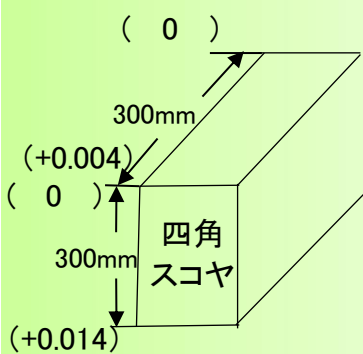

上面精度

※テーブルサイズ 850×410

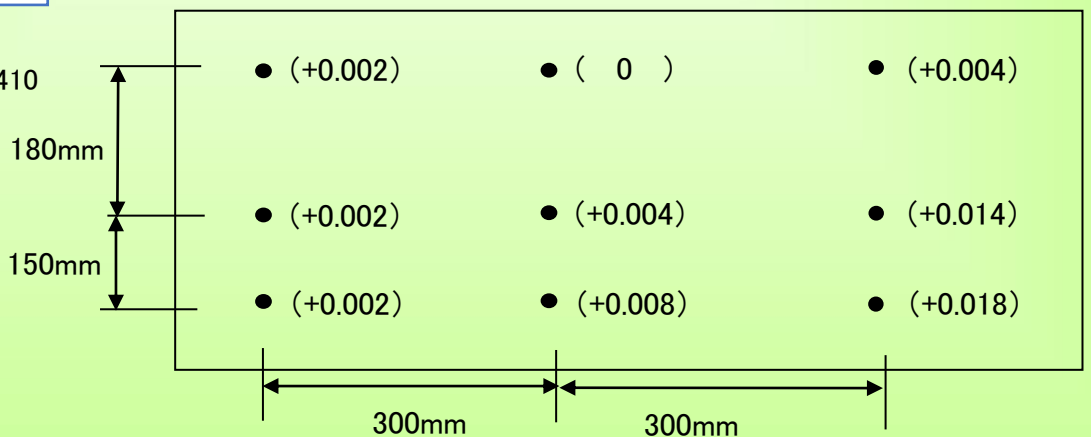

2022/8/30