


# 精度測定検査表


*Examination for precision list*

メーカー	OKK	年式	1998年製	管理番号	P007937
型式	MCV-560	測定者	金子	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

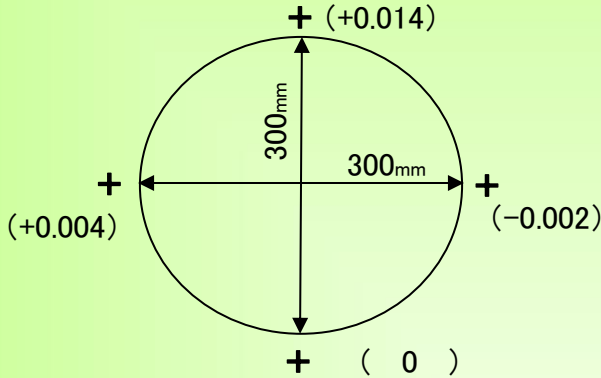

## 主軸振れ



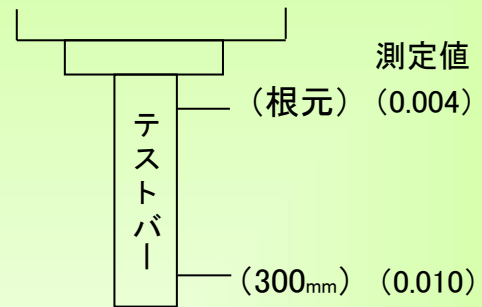


## 直角度

【YZ】測定値 (0.004)


【XZ】測定値 (0.004)

【XY】測定値 (0.012)

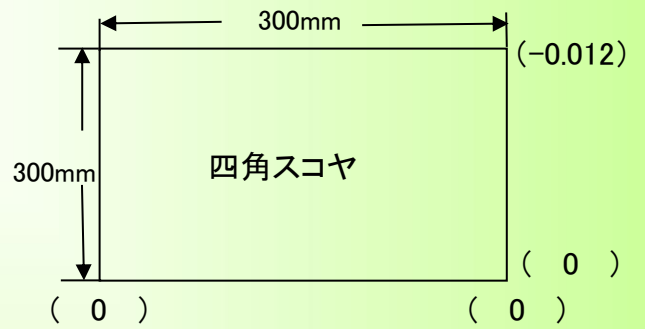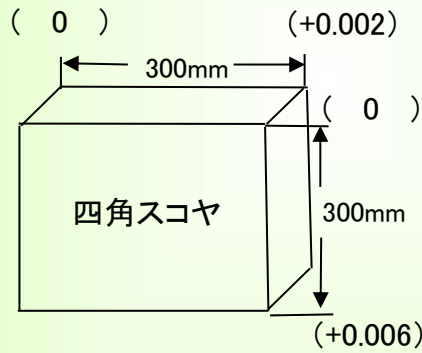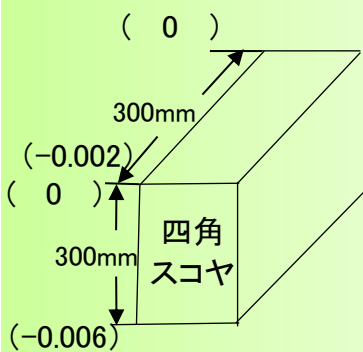

## 上面精度

※テーブルサイズ 1300×570

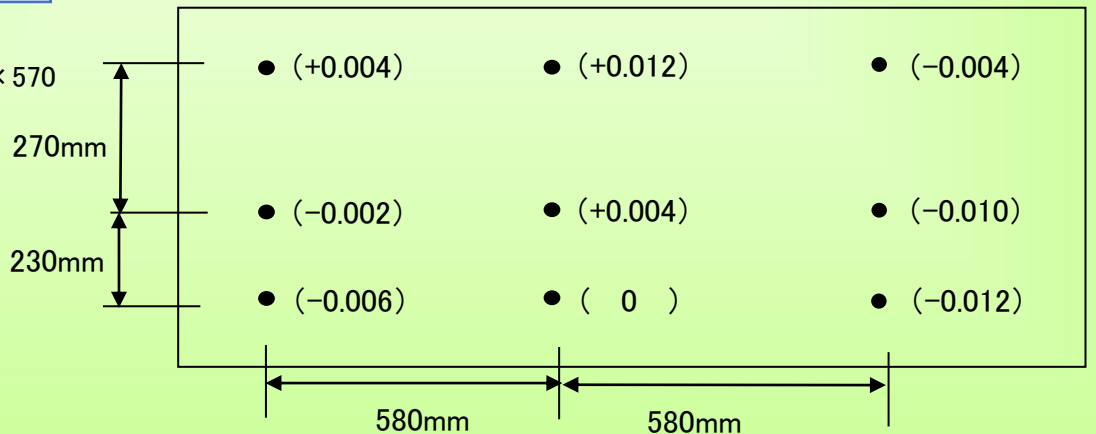

2022/9/6